

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Rámcová smlouva k provedení analýzy acidobazické rovnováhy s výpůjčkou analyzátorů“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 03.12.2024 v 12:59:51, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 3 Technické podmínky je uvedeno:

Pro kontrolu kvality musí být dodáván certifikovaný kontrolní materiál, multiparametrový na více kontrolních hladinách (min 3). Frekvence provádění kontrolních měření dle specifikace výrobce, nejméně však 3x denně na různých hladinách kontrolních materiálů. V případě nevyhovujících výsledků na všech hladinách 1x denně. Tyto náklady musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

Dotaz:

Vzhledem k robustnosti nabízeného systému a standardnímu provozu analyzátorů nabízeného typu (napříč nemocnicemi v ČR včetně fakultních nemocnic) je obvyklé provádět 1 QC/ den.

Bude zadavatel akceptovat pozměněné znění technického požadavku?:

Pro kontrolu kvality musí být dodáván certifikovaný kontrolní materiál, multiparametrový na více kontrolních hladinách (min 3). Frekvence provádění kontrolních měření dle specifikace výrobce, nejméně však 1x denně na různých hladinách kontrolních materiálů. V případě nevyhovujících výsledků na všech hladinách 1x denně. Tyto náklady musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel trvá na frekvenci provádění kontrolních měření dle specifikace výrobce, nejméně však 3x denně na různých hladinách kontrolních materiálů.

Zadavatel požaduje provádění kontrol v uvedené frekvenci s ohledem na Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP o vnitřní kontrole, jež uvádí pro parametry ABR toto: „Všechny hladiny (obvykle tři) jednou denně. lze střídát jednotlivé hladiny v časovém intervalu (při třech hladinách vždy pro osmi hodinách jedné hladiny“.


Veřejná zakázka je vypsána s předpokládaným plněním v délce osmi let a vzhledem k již uvedenému


Doporučení se zadavatel hodlá řídit striktním výkladem, tak aby minimalizoval případné neshody při přezkoumání systému Interní kontroly kvality auditory, a to po celou dobu případného plnění smlouvy uzavřené na základě výsledku této veřejné zakázky.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě dne 6.12.2024

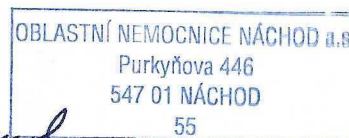


RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.