

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Dodávka myček podložních mís pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou

Ev. č. VVZ: Z2025-038789

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.


Dotaz č. 1

V technické specifikaci – minimální technické požadavky zadavatel požaduje

1. Celonerezová komora beze spár a svárů, objem min. 64 l
 - Bude zadavatel akceptovat celonerezovou komoru beze spár a svárů o objemu 57 l?

Velikost komory nemá žádný vliv na kvalitu mycího procesu, splnění hygienických požadavků a ani na zadavatelem požadované množství ukládaných předmětů. U menší komory je nižší spotřeba vody což má naopak vliv na ekonomiku provozu

2. Nerezové trysky – delší životnost a precizní mytí
 - Bude zadavatel akceptovat kombinaci nerezových a plastových trysek, které mají vždy nerezové uchycení? Naše řešení nemá žádný vliv na kvalitu mytí a nikde není prokázáno, že nerezové trysky zaručují delší životnost. Naše myčky využívají toto řešení více než 20 let ke spokojenosti uživatelů v nemocnicích i zařízeních domovů pro seniory
3. Velikost přístroje: šířka max. 500 mm x hloubka max 450 mm x výška minimálně 1 700 mm
 - Bude zadavatel akceptovat velikost přístroje o šířce 450 mm x hloubka základny dolní části 500 mm a horní části 580 mm a výšce 1 320 mm – viz. Obrázek

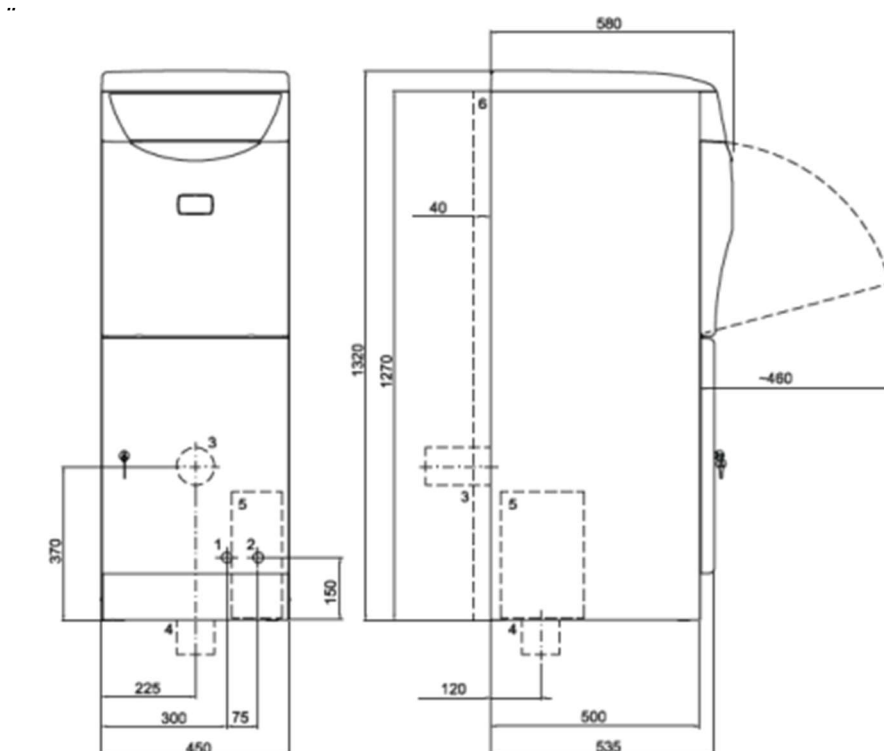

Naše produkty splňují Evropskou normou EN ISO 15883 a požadavky ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení. Akceptací výše uvedených dotazů zadavatel prokazatelně rozšíří počet možných uchazečů o veřejnou zakázku, což je základním principem veřejných soutěží při hospodaření s veřejnými (dotačními) prostředky.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad bod 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat celonerezovou komoru beze spár a svárů o objemu 57 l.

Ad bod 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat kombinaci nerezových a plastových trysek, který mají nerezové uchycení.

Ad bod 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat velikost přístroje o šířce 450 mm x hloubka základny dolní části 500 mm a horní části 580 mm a výšce 1 320 mm.

S ohledem na výše uvedené zadavatel upravuje přílohu č. 2 – technickou specifikaci. Upravená příloha dle věty předchozí tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **26. 8. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha

p02_tecnicka_specifikace_Myčka podložních mís_NRK_VZD_01

Za zástupce zadavatele na základě pověření