

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 06. 06. 2018, v Hradci Králové

| | |
|---|--|
| Zadavatel | Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202 |
| Veřejná zakázka s názvem: | Pořízení rentgenových přístrojů |
| Vysvětlení zadávací dokumentace číslo: | <p><i>Zadavatel pro přehlednost níže uvádí pořadové číslo tohoto vysvětlení zadávací dokumentace v jednotlivých částech veřejné zakázky.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro části 1, 2 a 3 veřejné zakázky se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2; • Pro část 4 veřejné zakázky se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. |
| Platí pro <u>části</u> veřejné zakázky s názvem: | <p>část 1: Pořízení rentgenových přístrojů – 2x skiagrafický RTG se stropním závěsem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.</p> <p>část 2: Pořízení rentgenových přístrojů 2x skiagrafický RTG se sloupovým držákem RTG zářiče pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.</p> <p>část 3: Pořízení rentgenových přístrojů – 2x mobilní skiagrafický RTG pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.</p> <p>část 4: Pořízení rentgenových přístrojů – 1x mobilní RTG s C-ramenem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.</p> |

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedeným částem veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že v předchozím vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – platné pro části 1, 2 a 3 ze dne 23. 05. 2018 byl formálním pochybením chybně uveden název veřejné zakázky na první straně, názvy jednotlivých částí veřejné zakázky již byly uvedeny správně.

1) Dotazy uchazeče:


„Vážená paní doktorko,

V příloze posílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Pořízení rentgenových přístrojů“.

Předem děkuji za vyřízení a přeji příjemný zbytek dne,

S pozdravem“

Následuje PrintScreen jednotlivých dotazů ze souboru .pdf, který byl přílohu emailu:

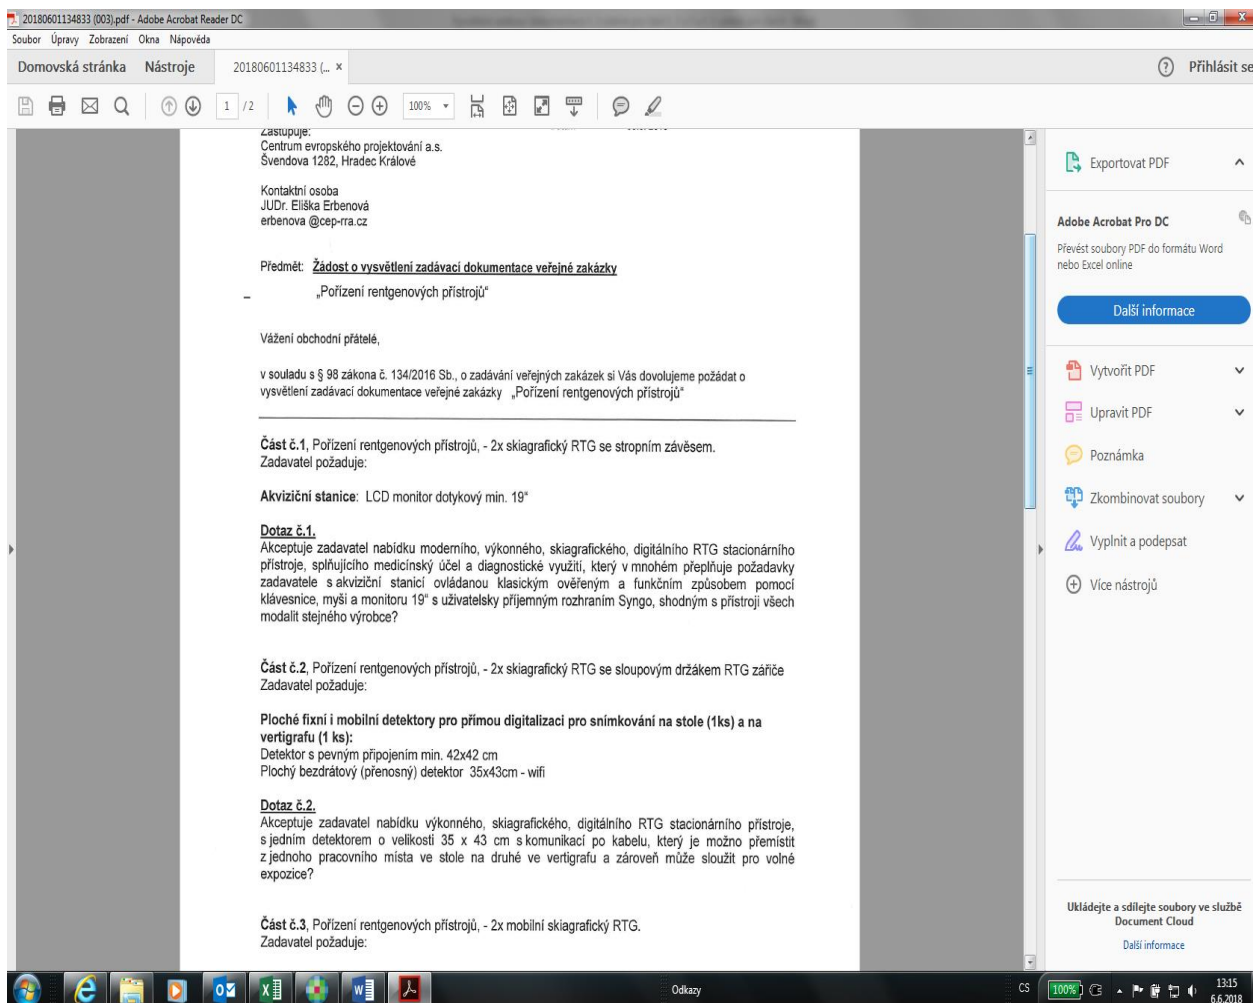

20180601134833 (003).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Soubor Úpravy Zobrazení Okna Nápověda

Domovská stránka Nástroje 20180601134833 (... x) Přihlásit se

Zastupuje:
Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282, Hradec Králové

Kontaktní osoba
JUDr. Eliška Erbenová
erbenova@cep-rra.cz

Předmět: **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky**
„Pořízení rentgenových přístrojů“

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Pořízení rentgenových přístrojů“

Část č.1. Pořízení rentgenových přístrojů, - 2x skiografický RTG se stropním závěsem.
Zadavatel požaduje:

Akviziční stanice: LCD monitor dotykový min. 19"

Dotaz č.1.
Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného, skiografického, digitálního RTG stacionárního přístroje, splňujícího medicínský účel a diagnostické využití, který v mnohém přepřlňuje požadavky zadavatele s akviziční stanicí ovládanou klasickým ověřeným a funkčním způsobem pomocí klávesnice, myši a monitoru 19" s uživatelsky příjemným rozhraním Syngo, shodným s přístroji všech modalit stejného výrobce?

Část č.2. Pořízení rentgenových přístrojů, - 2x skiografický RTG se sloupovým držákem RTG zářiče
Zadavatel požaduje:

Ploché fixní i mobilní detektory pro přímou digitalizaci pro snímkování na stole (1ks) a na vertigrafu (1 ks):
Detektor s pevným připojením min. 42x42 cm
Ploché bezdrátový (přenosný) detektor 35x43cm - wifi

Dotaz č.2.
Akceptuje zadavatel nabídku výkonného, skiografického, digitálního RTG stacionárního přístroje, s jedním detektorem o velikosti 35 x 43 cm s komunikací po kabelu, který je možno přemístit z jednoho pracovního místa ve stole na druhé ve vertigrafu a zároveň může sloužit pro volné expozice?

Část č.3. Pořízení rentgenových přístrojů, - 2x mobilní skiografický RTG.
Zadavatel požaduje:

Exportovat PDF

Adobe Acrobat Pro DC
Převést soubory PDF do formátu Word nebo Excel online

Další informace

Vytvořit PDF

Upravit PDF

Poznámka

Zkombinovat soubory


Vyplnit a podepsat

Více nástrojů

Ukládejte a sdílejte soubory ve službě Document Cloud

Další informace

13:15 6.6.2018

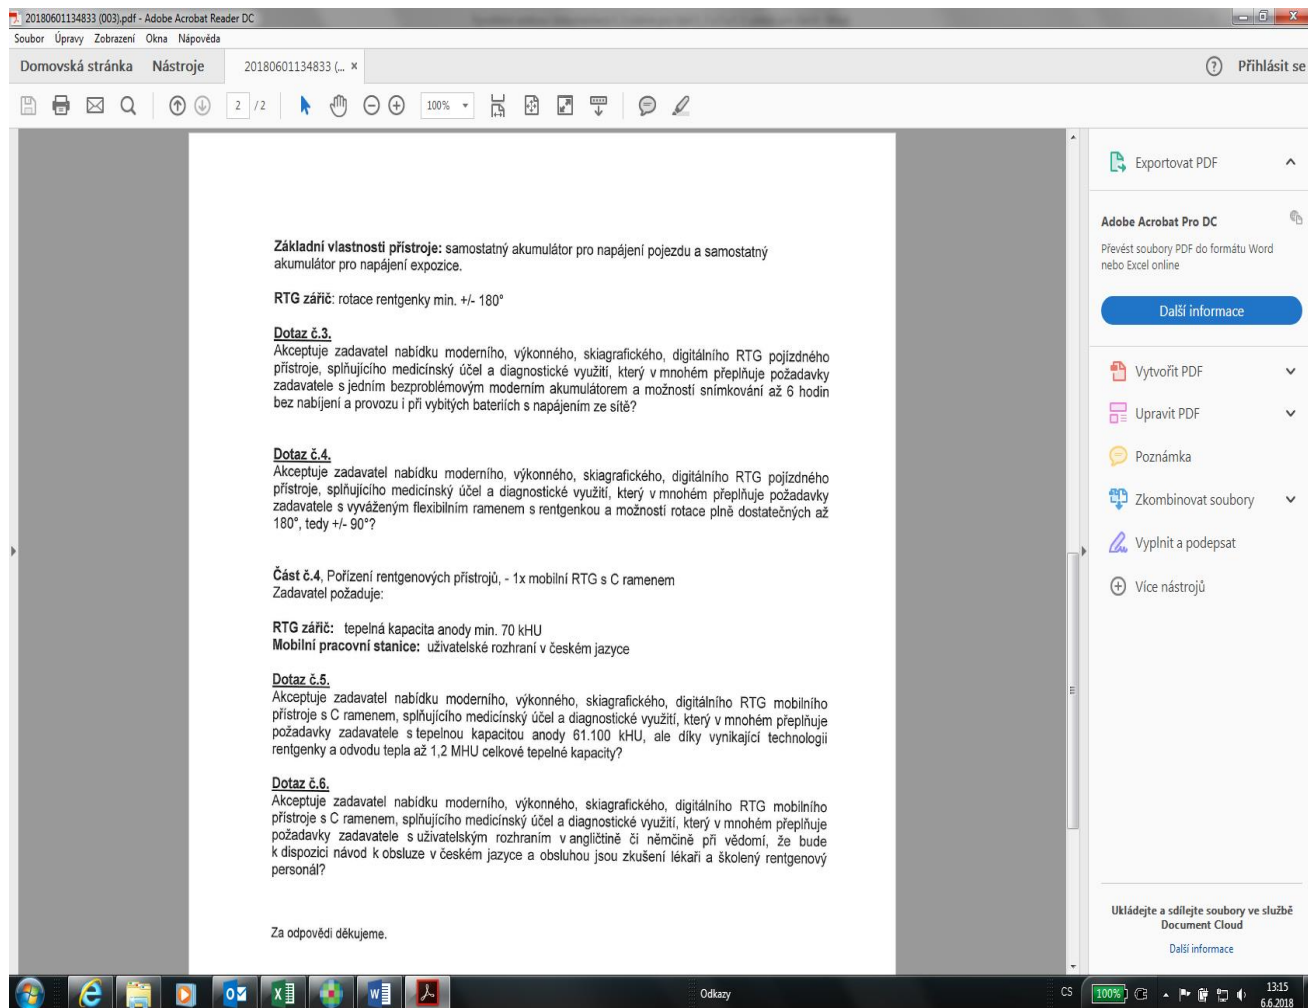

2) Odpovědi zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele dne 01.06.2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel tímto podává odpovědi na dotazy uchazeče takto:

- (i) část 1 (Pořízení rentgenových přístrojů – 2x skiagrafický RTG se stropním závěsem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.)

Akviziční stanice: LCD monitor dotykový min. 19“

Dotaz č. 1.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného, skiagrafického, digitálního RTG stacionárního přístroje, splňujícího medicínský účel a diagnostické využití, který v mnohém přepřňuje požadavky zadavatele s akviziční stanicí ovládanou klasickým ověřeným a funkčním

www.cep-rra.cz

způsobem pomocí klávesnice, myši a monitoru 19“ s uživatelsky příjemným rozhraním Syngo, shodným s přístroji všech modalit stejného výrobce?

Odpověď: Ano, zadavatel akceptuje ovládání akviziční stanice klasickým ověřeným a funkčním způsobem pomocí klávesnice, myši a monitoru 19“. Zadavatel upravuje tento stanovený parametr v příloze č. 2_1 ZD.

- (ii) část 2 (Pořízení rentgenových přístrojů – 2x skiografický RTG se sloupovým držákem RTG zářiče pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.)

Ploché fixní i mobilní detektory pro přímou digitalizaci pro snímkování na stole (1ks) a na vertigrafu (1 ks):

Detektor s pevným připojením min. 42x42 cm

Plochý bezdrátový (přenosný) detektor 35x43cm - wifi

Dotaz č. 2.

Akceptuje zadavatel nabídku výkonného, skiografického, digitálního RTG stacionárního přístroje, s jedním detektorem o velikosti 35 x 43 cm s komunikací po kabelu, který je možno přemístit z jednoho pracovního místa ve stole na druhé ve vertigrafu a zároveň může sloužit pro volné expozice?

Odpověď: Zadavatel trvá na požadovaném počtu detektorů a zadaných technických parametrech.

- (iii) část 3 (Pořízení rentgenových přístrojů – 2x mobilní RTG pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.)

Zadavatel požaduje:

Základní vlastnosti přístroje: samostatný akumulátor pro napájení pojezdu a samostatný akumulátor pro napájení expozice.

RTG zářič: rotace rentgenky min. +/- 180°

Dotaz č. 3.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného, skiografického, digitálního RTG pojízdného přístroje splňujícího medicínský účel a diagnostické využití, který v mnohém přepřplňuje požadavky zadavatele s jedním bezproblémovým moderním akumulátorem a možností snímkování až 6 hodin bez nabíjení a provozu i při vybitých bateriích s napájením ze sítě?

Odpověď: Ano, zadavatel akceptuje nabídku digitálního RTG pojízdného přístroje s jedním bezproblémovým akumulátorem a možností až 6 hodin bez nabíjení a provozu i při vybitých bateriích s napájením ze sítě, při zachování splnění medicínského účelu a diagnostického využití.

Dotaz č. 4

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného, skiografického, digitálního RTG pojízdného přístroje splňujícího medicínský účel a diagnostické využití, který v mnohém přepřplňuje požadavky zadavatele s vyváženým flexibilním ramenem s rentgenkou a možností rotace plně dostatečných až 180°, tedy +/- 90°?

Odpověď: Ne, zadavatel trvá na svém požadavku na rotaci rentgenky min. +/-180°.

- (iv) část 4 (Pořízení rentgenových přístrojů – 1x mobilní RTG s C-ramenem)

Zadavatel požaduje:

RTG zářič: tepelná kapacita anody min. 70 kWh

Mobilní pracovní stanice: uživatelské rozhraní v českém jazyce

Dotaz č. 5.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného, skiagrafického, digitálního RTG mobilního přístroje s C-ramenem, splňujícího medicínský účel a diagnostické využití, který v mnohém přepřňuje požadavky zadavatele s tepelnou kapacitou anody 61.100 kWh ale díky vynikající technologii rentgenky a odvodu tepla až 1,2 MHz celkové tepelné kapacity?

Odpověď: Ne, zadavatel trvá na svém požadavku tepelné kapacity anody min. 70 kWh. Z pohledu zadavatele je jím požadovaná hodnota tepelné kapacity anody min. 70 kWh již požadavkem standardním, a to nejen ve vztahu k zadavatelem plánovanému využití C-ramena.

Dotaz č. 6.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného, skiagrafického, digitálního RTG mobilního přístroje s C-ramenem, splňujícího medicínský účel a diagnostické využití, který v mnohém přepřňuje požadavky zadavatele s uživatelským rozhraním v angličtině či němčině při vědomí, že bude k dispozici návod k obsluze v českém jazyce a obsluhou jsou zkušení lékaři a školený rentgenový personál?

Odpověď: Ano, zadavatel bude akceptovat digitální RTG mobilní přístroj s C ramenem, splňující medicínský účel a diagnostické využití s uživatelským rozhraním **v angličtině** při vědomí, že bude k dispozici návod k obsluze v českém jazyce. Uživatelské rozhraní v němčině zadavatel nepřipouští.

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změn, **zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:**

- neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v části 2 veřejné zakázky;**
- přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2_1, č. 2_3 a č. 2_4 Technické podmínky;**
- dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodluhuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky v částech 1, 3 a 4 veřejné zakázky o celou původní délku.** Zadavatel pro tyto části veřejné zakázky ruší znění článku „19. Místo a doba pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

„19. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 07. 2018, v 10,00 hod.

Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a. s., Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 (Evropský dům), 3. patro, kancelář č. 421.

Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 do 15,00 hodin

Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.“

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová