

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 21. 06. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202
Veřejná zakázka s názvem:	Pořízení rentgenových přístrojů
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	<i>Zadavatel pro přehlednost níže uvádí pořadové číslo tohoto vysvětlení zadávací dokumentace v této části veřejné zakázky:</i> <ul style="list-style-type: none">• pro část 1 veřejné zakázky se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.
Platí pro část veřejné zakázky s názvem:	část 1: Pořízení rentgenových přístrojů – 2x skiografický RTG se stropním závěsem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedeným částem veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

1) Dotazy uchazeče č. 1:


„Dobrý den paní doktoro,

V příloze Vám zasílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce“ Pořízení rentgenových přístrojů“ pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Děkuji za odpověď

S pozdravem“

Následuje PrintScreen jednotlivých dotazů ze souboru .pdf, který byl přílohou emailu:

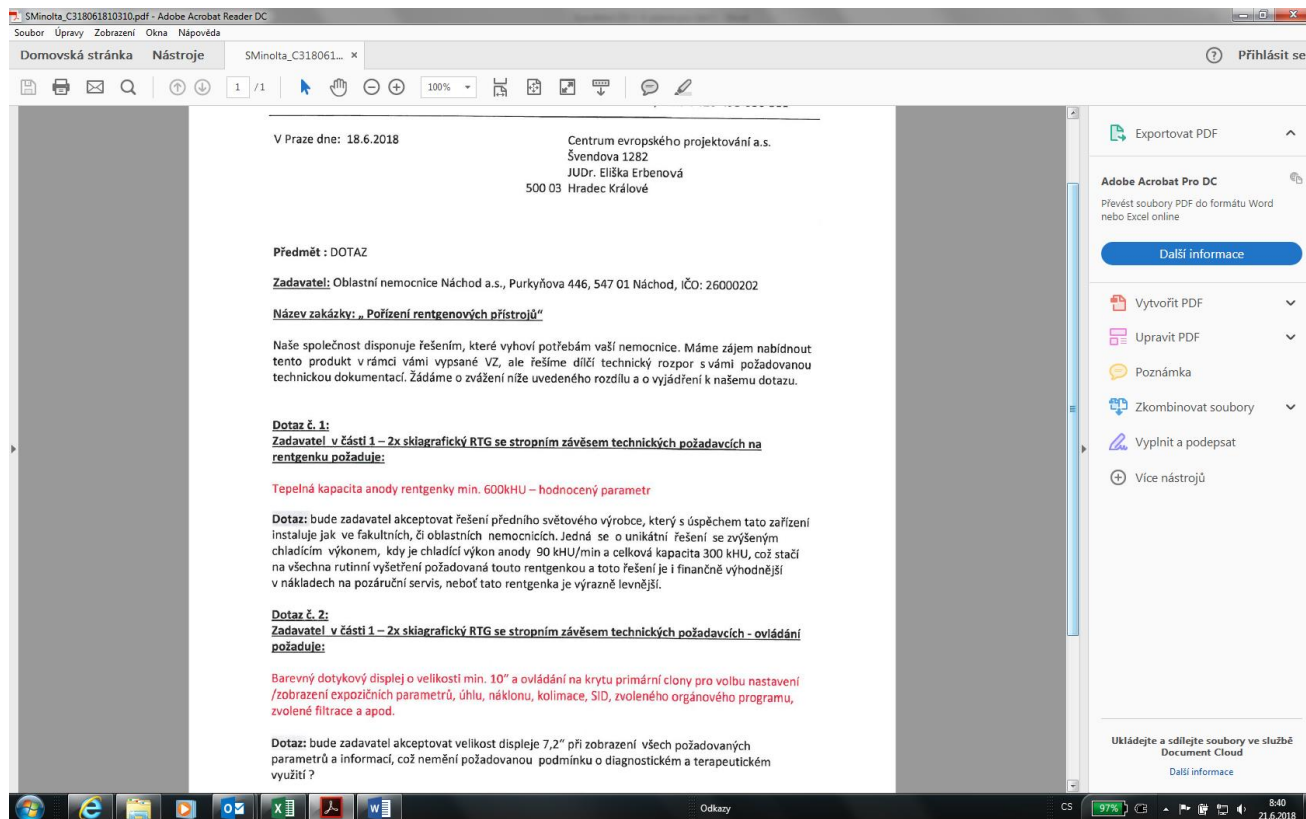

2) Odpovědi zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele dne 18.06.2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. **Zadavatel tímto podává barevně odlišené odpovědi na dotazy uchazeče takto:**

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části 1 – 2x skiagrafický RTG se stropním závěsem technických požadavcích na rentgenku požaduje:

Tepelná kapacita anody rentgenky min. 600kHU – hodnocený parametr

Dotaz: bude zadavatel akceptovat řešení předního světového výrobce, který s úspěchem tato zařízení instaluje ve fakulních, či oblastních nemocnicích. Jedná se o unikátní řešení se zvýšením chladicím výkonem, kdy je

chladicí výkon anody 90 kHU/min a celková kapacita 300 kHU, což stačí na všechna rutinní vyšetření požadovaná touto rentgenkou a toto řešení je i finančně výhodnější v nákladech na pozáruční servis, neboť tato rentgenka je výrazně levnější.

ODPOVĚĎ: Zadavatel trvá na definovaném parametru. Požadovaná hodnota tohoto parametru je běžná a přímo odpovídá zamýšlenému použití a vytížení přístroje s potřebnou rezervou. Splňuje ji většina dodavatelů RTG přístrojů na trhu.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části 1 – 2x skiagrafický RTG se stropním závěsem technických požadavcích - ovládání požaduje:

Barevný dotykový displej o velikosti min. 10" a ovládání na krytu primární clony pro volbu nastavení / zobrazení expozičních parametrů, úhlu, náklonu, kolimace, SID, zvoleného orgánového programu, zvolené filtrace a apod.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat velikost displeje 7,2" při zobrazení všech požadovaných parametrů a informací, což nemění požadovanou podmínku o diagnostickém a terapeutickém využití?

ODPOVĚĎ: Zadavatel trvá na definovaném parametru. Hodnota displeje 7,2" je nepoměrná k požadovanému displeji s uhlopříčkou min. 10" a informacím, které mají být zobrazovány

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu odpovědí, **zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v části 1 veřejné zakázky.**

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s., Eliška Erbenová

www.cep-rra.cz