

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 03. 07. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202
Veřejná zakázka s názvem:	Pořízení rentgenových přístrojů
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	<i>Zadavatel pro přehlednost níže uvádí pořadové číslo tohoto vysvětlení zadávací dokumentace v této části veřejné zakázky:</i> <ul style="list-style-type: none">pro část 4 veřejné zakázky se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.
Platí pro část veřejné zakázky s názvem:	<ul style="list-style-type: none">část 4: Pořízení rentgenových přístrojů – 1x mobilní RTG s C-ramenem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedeným částem veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

1) Dotazy uchazeče:

„Dobrý den paní doktorko,


zasílám ještě včerejší dotazy doplněné o jeden další dopřesňující dotaz. Co je nové jsem v textu zažlutil, ostatní je identické jako ve včerejším dopise.

Tímto prosím o anulaci a stáhnutí dokumentu zaslaného 28.6.2018. Platná a finální verze dotazu je tato přiložená k mailu.

Děkuji

S pozdravem“

Následuje PrintScreen jednotlivých dotazů ze souboru .word, který byl přílohou emailu:

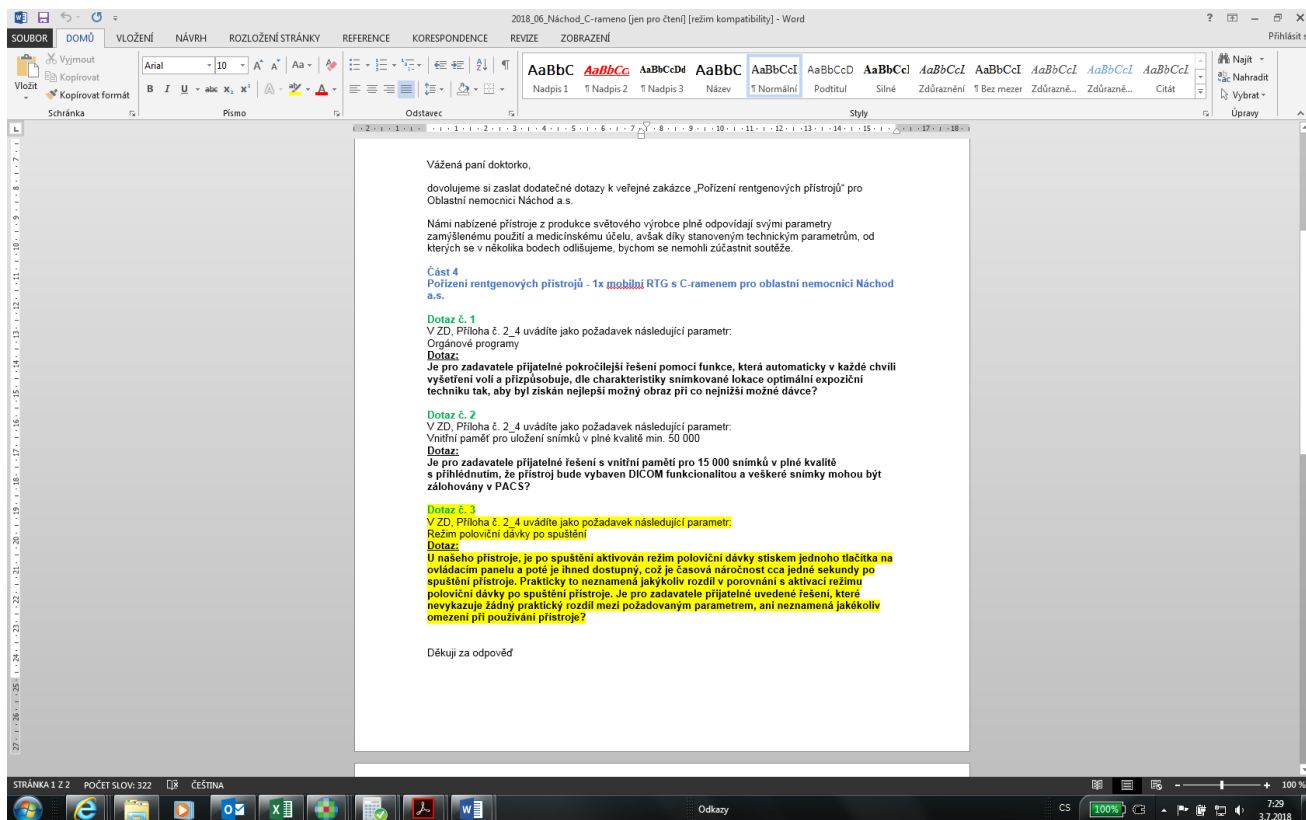

2) Odpovědi zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele dne 29.06.2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Uchazeč zaslal dotazy zadavateli již 28. 06. 2018, které dále upravil a zaslal nově 29. 06. 2018 s tím, že dotazy z předchozího dne bere zpět. **Zadavatel tímto podává barevně odlišené odpovědi na dotazy uchazeče takto:**

Část 4

Pořízení rentgenových přístrojů - 1x mobilní RTG s C-ramenem pro oblastní nemocnici Náchod a.s.

Dotaz č. 1

V ZD, Příloha č. 2_4 uvádíte jako požadavek následující parametr:

Orgánové programy

www.cep-rra.cz

Dotaz:

Je pro zadavatele přijatelné pokročilejší řešení pomocí funkce, která automaticky v každé chvíli vyšetření volí a přizpůsobuje, dle charakteristiky snímkové lokace optimální expoziční techniku tak, aby byl získán nejlepší možný obraz při co nejnižší možné dávce?

ODPOVĚĎ: Zadavatel trvá na požadované technické specifikaci. Pokročilejší funkce a softwarová řešení zadavatel akceptuje pouze navíc k základním požadovaným parametrům.

Dotaz č. 2

V ZD, Příloha č. 2_4 uvádíte jako požadavek následující parametr:

Vnitřní paměť pro uložení snímků v plné kvalitě min. 50 000

Dotaz:

Je pro zadavatele přijatelné řešení s vnitřní pamětí pro 15 000 snímků v plné kvalitě s přihlédnutím, že přístroj bude vybaven DICOM funkcionalitou a veškeré snímky mohou být zálohovány v PACS?

ODPOVĚĎ: Zadavatel akceptuje vnitřní paměť přístroje na 15.000 snímků v plné kvalitě. Zadavatel v souvislosti s tímto trvá na komunikaci přístroje s místním PACS ve formátu DICOM 3.0 a automatickém odesílání snímků do PACS po expozici/připojení k lokální datové síti.

Dotaz č. 3

V ZD, Příloha č. 2_4 uvádíte jako požadavek následující parametr:

Režim poloviční dávky po spuštění

Dotaz:

U našeho přístroje, je po spuštění aktivován režim poloviční dávky stiskem jednoho tlačítka na ovládacím panelu a poté je ihned dostupný, což je časová náročnost cca jedné sekundy po spuštění přístroje. Prakticky to neznámá jakýkoliv rozdíl v porovnání s aktivací režimu poloviční dávky po spuštění přístroje. Je pro zadavatele přijatelné uvedené řešení, které nevykazuje žádný praktický rozdíl mezi požadovaným parametrem, ani neznámá jakékoliv omezení při používání přístroje?

ODPOVĚĎ: Zadavatel trvá na požadované technické specifikaci.

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu odpovědí, **zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:**

- a) **přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2_4 Technické podmínky; a**
b) **dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky v části 4 veřejné zakázky o 3 pracovní dny.** Zadavatel pro tuto část veřejné zakázky ruší znění článku „19. Místo a doba pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

„19. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 07. 2018, v 10,00 hod.

Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a. s., Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 (Evropský dům), 3. patro, kancelář č. 421.

Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 do 15,00 hodin

Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.“

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s., Eliška Erbenová