

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

<b>Kupující</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
IČO	708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
bankovní spojení	██
číslo účtu	████████████████████

dále také jako „*kupující*“ a

<b>Prodávající</b>	<b>PROMA REHA, s.r.o.</b>
--------------------	---------------------------

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 7945

IČO	63219107
DIČ	CZ63219107
se sídlem	Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
zastoupen	Petrem Bucharem, vedoucím obchodu pro ČR
bankovní spojení	██
číslo účtu	████████████████████

dále také jako „*prodávající*“ a

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

## Preamble

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na **dodávky s názvem Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s vlastními technickými podmínkami předmětu koupě, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - Technická specifikace a tabulkou plnění minimálních požadavků kupujícího, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy – Tabulka plnění minimálních požadavků.

2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu kupní smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k **následujícímu vybavení** pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN) (dále též jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Dodávka zahrnuje 172 ks standardních lůžek, 4 ks lůžek s vyšší nosností, 13 ks lůžek pro intenzivní péči a 4 ks resuscitačních lůžek, včetně pasivních a aktivních antidekubitních matrací a celkem 190 ks nočních stolků. Součástí dodávky bude provedení instruktáže pro personál.
- 1.2. Přesná specifikace zboží je uvedena v **příloze č. 1** této smlouvy – **Technická specifikace** a v **příloze č. 2** této smlouvy - **Tabulka plnění minimálních požadavků**. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle článku II. této smlouvy.
- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a v souladu s veškerou dostupnou dokumentací (poskytnutou prodávajícím) příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.4. Kupující prohlašuje, že stavební připravenost v době zahájení plnění dle této smlouvy je nastavena jako tzv. výchozí připravenost (dle projektové dokumentace) a bude kupujícím upravena podle konkrétních potřeb a požadavků dodávaného zboží.
- 1.5. Prodávající do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předloží kupujícímu přesné technické parametry určující stavební připravenost pro dodávané zboží (přesné rozměry zboží, stavební připravenost pro napojení na rozvody technických zařízení budov, případně další nezbytné parametry).
- 1.6. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebudou porušovat ani nebudou mít za následek porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.

## II.

### Podmínky dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu **do 8 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.

2.2 Místem dodání je Oblastní nemocnice Náchod a.s. O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího:

Pověřeným **zástupcem prodávajícího** je: Lenka Chárová, [REDACTED]  
[REDACTED]

Pověřenými **zástupci kupujícího** jsou:

- (i) Ing. Václav Nýč, [REDACTED] nebo;
- (ii) Ing. Miroslav Michl; [REDACTED]

2.3 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na místo dodání specifikované v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektorevize,.. atd.) a předepsaných přijímacích zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; a
- c) instruktáž („školení“) zdravotnického personálu (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o ZP“); a
- d) vystavení protokolu o proškolení a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží pro určeného pracovníka; a
- e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že dodávané zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP, v případě zboží se zdroji ionizujícího záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“) a prováděcích předpisů, zejména „rozhodnutí o povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření, vč. zaplacených správních poplatků; a
- f) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce; a
- g) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá funkční zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.4 Proávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Proávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokázal svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.5 Proávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Proávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich ekologickou likvidaci v souladu s právními předpisy.
- 2.7 Proávající se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu úklid po provedených instalacích, montážích a jiných činnostech při dodání zboží do místa dodání, včetně případného (mokrého) očištění dotčených povrchů.
- 2.8 Proávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

### III.

#### Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí 7 979 402,36 Kč bez DPH, DPH činí 1 276 596,35 Kč, tj. 9 255 998,71 Kč včetně DPH (slovy: devět milionů dvě stě padesát pět tisíc devět set devadesát osm korun českých sedmdesát jeden haléřů).
- 3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, instruktáž (školení) a uvedení do provozu.

- 3.3. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.
- 3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - odvolávka na tuto smlouvu,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
  - soupis příloh.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy.

- 3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře.
- 3.8. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
- 3.9. Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
3. 10. V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.11. Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3. 9. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální

riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.

- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátcem či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

#### IV.

##### Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

#### V.

##### Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce zboží**. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím poskytnuté záruční doby (24 měsíců nebo delší) ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bez vyzvání:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona o ZP,

- revize dle § 67 a 68 zákona o ZP,
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona,

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do zboží kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčností, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 66 zákona o ZP) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce. Prodávající se zejména zavazuje za to, že oprava bude prováděna výhradně zdravotnickými pracovníky nejméně s roční odbornou praxí a s odbornou způsobilostí nebo pracovníky nejméně s tříletou odbornou praxí v oblasti oprav dodávaného zboží nebo zdravotnického prostředku podobného druhu, nebo pracovníky osoby provádějící servis, a to s nejméně tříměsíční odbornou praxí na příslušném zboží nebo zdravotnickém prostředku podobného druhu.

#### 5.4 Reklamacie zboží a kontakty prodávajícího:

- 5.4.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamacie“). I reklamacie učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na zboží nejméně podruhé nebo vzniknou-li na zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

- 5.4.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu **následující kontaktní údaje**, na kterých je povinen přijímat **požadavky na reklamaci**: [REDACTED]. Pracovní doba prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podřídně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.
- 5.4.3. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že **doba nástupu servisního technika** na opravu bude maximálně **do 24 hodin** od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty skutečně v pracovní den mezi **8.00 – 17.00 hod.** nebo **do 12.30 hod.** následujícího pracovního dne, pokud bude reklamace uplatněna v době po 17.00 do 8.00 hodin příslušného dne, nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech.
- 5.4.4. Jde-li o vadu odstranitelnou a nevyžadující použití náhradních dílů, zavazuje se prodávající tuto **odstranit** a uhradit veškeré související náklady nejpozději **do 24 hodin** od nástupu servisního technika na opravu. V případě, že je nutné použití náhradních dílů, které má prodávající k dispozici, zavazuje se prodávající odstranit vadu nejpozději **do 72 hodin** od nástupu servisního technika na opravu. Pakliže je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě **do 10 pracovních dnů** počítaných od nástupu servisního technika na opravu.
- 5.4.5. Pakliže odstranění vady není možné do 72 hodin od nástupu servisního technika, zavazuje se prodávající, že (včetně případů neuznané reklamace), vypůjčí kupujícímu **náhradní zboží** (srovnatelných nebo lepších parametrů), včetně případné nezbytné instruktáže (školení) v rozsahu požadovaném ZOZP, a to tak, aby kupující měl toto náhradní zboží k dispozici a k užívání od 08.00 hodin čtvrtého dne následujícího po dni nástupu servisního technika dle článku 5.4.3. této smlouvy.
- 5.4.6. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.
- 5.4.7. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně **nové bezvadné zboží**, nejpozději však **do 8 týdnů** ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k tomuto novému zboží na kupujícího. Nové zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na nové zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku nového zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající. Prodávající se dále zavazuje k tomuto novému zboží zajistit instruktáž („školení“) zdravotnického personálu v souladu se zákonem o ZP.



- 5.4.8. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.4.9. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.5. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.6. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.7. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

## VI.

### Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje zajistit po dobu **osmi (8) let** po uplynutí záruční doby **dostupnost náhradních dílů zboží** pro území České republiky. Závazek spočívá v tom, že prodávající předloží kupujícímu do 1 (jednoho) měsíce od doručení žádosti informací, kde jsou v České republice veškeré náhradní díly pro řádnou opravu nebo jiné odstranění vady nebo poškození zboží dostupné. Za tuto dostupnost náhradních dílů (dostupný náhradní díl) se zejména nepovažuje:
- a) pokud náhradní díl bude možné pořídit pouze výrobou konkrétního jednotlivého náhradního dílu provedenou na zakázku,
  - b) pokud bude možné dodat náhradní díl pouze za cenu, která bude převyšovat obvyklou hodnotu tohoto náhradního dílu, příp. obvyklou hodnotu náhradního dílu daného druhu, stanovenou znaleckým posudkem o více jak 10 %, a/nebo
  - c) pokud od vyslovení požadavku kupujícího bude možné dodat kupujícímu tento náhradní díl pouze ve lhůtě převyšující 30 dní.
- 6.2. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.3. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.

- 6.4. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícím či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.6. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.7. **Pojištění:** Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností kupujícím nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 15.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží s minimální pojistnou částkou ve výši 15.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k plnění. Prodávající se tato pojištění zavazuje udržovat v platnosti až do skončení záruční doby na zboží a v této době je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o platnosti a rozsahu pojištění.

- 6.8. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

## VII.

### Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.4.3. a 5.4.6. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.4.4. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.

- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6. 7. této smlouvy.
- 7.5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s plněním ve lhůtě dle článku 2.9 této smlouvy.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 2.7 této smlouvy.
- 7.7. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.8. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě dodání činí 10.000 Kč.
- 7.9. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl provadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.10. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

## VIII.

### Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a nedopadají na ni ani jiné výjimky, pro které by tato smlouva, či její část, nemohly být v registru smluv uveřejněny. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

## IX.

### Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.4.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
  - a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;

- b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
  - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 7. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
  - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
  - e) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
  - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
- 9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.


## X.

### Zvláštní ustanovení


- 10.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

- 10.4. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.7. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky, osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zasílací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zasílací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.8. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 10.9. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřena elektronicky.**
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 10.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace;
  - Příloha č. 2 – Tabulka plnění minimálních požadavků;
  - Příloha č. 3 – Závazný vzor Předávacího protokolu.

Za kupujícího

  
Mgr. Martin Cervicek  
Hejtmán Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího

  
Petr Buchar  
vedoucí obchodu pro ČR  
PROMA REHA, s.r.o.

Pol. č. 1: T-6015, standardní elektricky stavitelné lůžko pro pacienty, vč. pasivní matrace, 172ks

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.  
Typ: PLE-N85-T

Lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52:2010

Stabilní, jednoduše čistitelná páková konstrukce lůžka

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál

Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka

Celoplastový kryt podvozku

Elektrický zdvih ložné plochy (zdvihový mechanismus pod ložnou plochou)

Polohování zádového dílu elektrické, 73°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, pomocí hřebene v 5 krocích, 25°

Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburg

Autoregrese zádového dílu 12cm

Autoregrese stehenního dílu 6cm

Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka

Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh a ochranou proti nechtěnému polohování (GO tlačítko), podsvícený s barevně odlišenými funkcemi

Záložní baterie

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Kroucený spirálový napájecí kabel, odolný, v délce 3m od čela lůžka při natažení

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

4x univerzální držák příslušenství (hrázda, infuzní stojan) - hlavová a nožní část

Eurolišty (2ks) + plastový háček (8ks)

Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných kovových lamel

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel


Kompaktní jednodílné ¾ postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s bezpečným mechanismem zajištění zábran pod ložnou plochou

Možnost odejmutí zábran bez použití nářadí

Kovová konstrukce lůžka lakována polyesterovými práškovými barvami: RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha:	200 x 85 cm
Vnější rozměry:	215 x 97cm
Zdvih ložné plochy:	38,5 – 80 cm
Elektrický TR/ATR	16°/ 16°
Bezpečné provozní zatížení lůžka:	250 kg

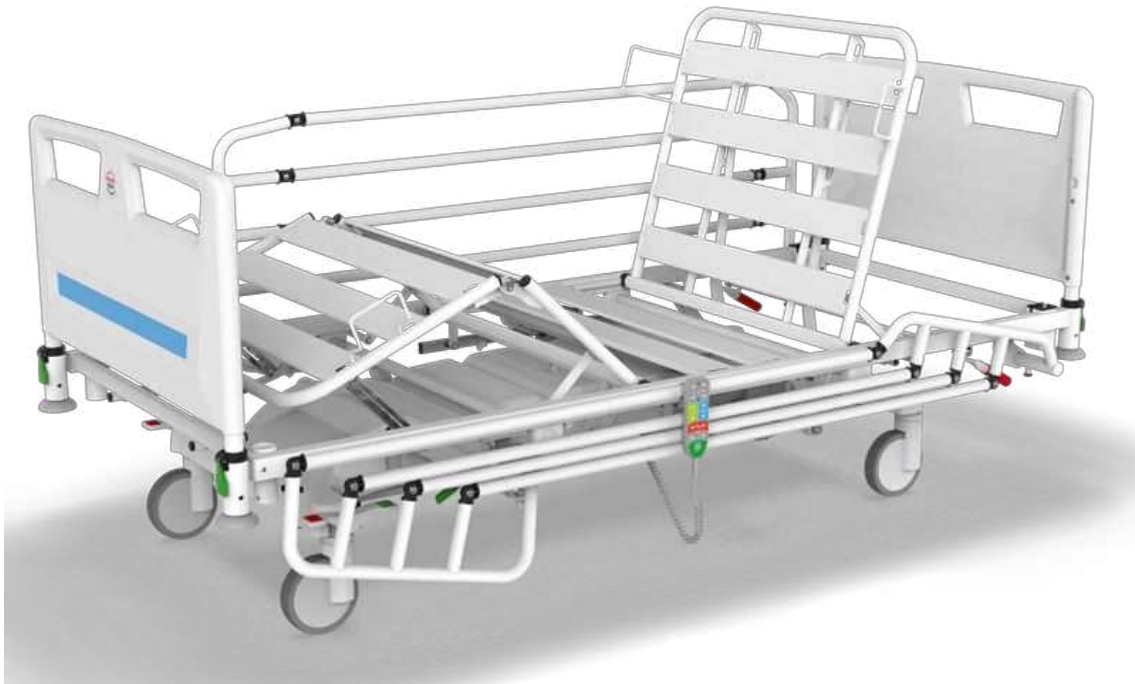

#### Pasivní antidekubitní matrace Lux S

Preventivní pasivní antidekubitní matrace

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně)

Vyrobena ze studené pěny o hustotě 40kg/m<sup>3</sup>

Zpevněné okraje jádra tužší pěnou

Jádro matrace rozděleno do pěti anatomických zón

Díky prořezu jádra je výrazně zlepšeno rozložení tlaku na matraci

Matrace díky příčnému prořezu dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách a dokonale se přizpůsobuje tělu pacienta

Nosnost matrace 200kg

Výška matrace 14 cm

Rozměr matrace dle lůžka, 200x85cm

#### Potah SAFR

Potah pružný ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný,

antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním

prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace



Příslušenství:

Hrazda



Hrazdička s popruhem



Držák nádoby na moč



Držák sáčků na moč




Přenosný držák 2ks holí    Držák infuzní láhve s pojistkou, závěsný



Infuzní stojan  
hliníkový, 4x háček  
teleskopický



Fixační systém  
- flexibilní (fixace hrudní, břišní, zápěstí, kotníků)

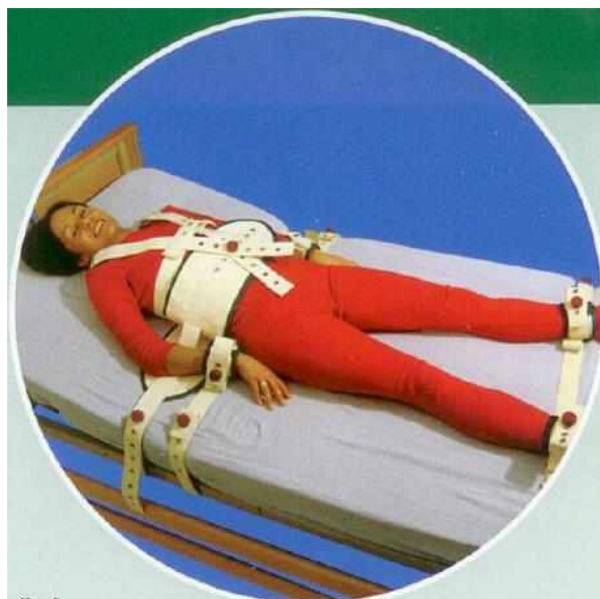



Držák monitoru



Extenční souprava




Infuzní nerezový stojan



Jmenovka (teplotka) A5



Držák na podložní mísu

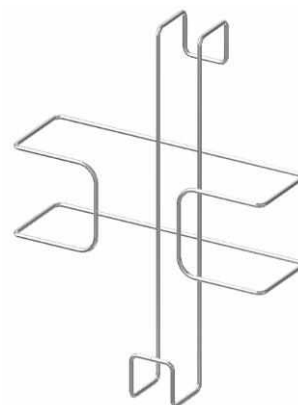

Držák urologických sáčků na moč  
4x háček



Infuzní stojan, pojízdný



Stolek sklopný na čelo lůžka



Pol. č. 2: T-6015a, standardní elektricky stavitelné lůžko pro pacienty, vyšší nosnost, vč. pasivní matrace, 4ks

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.  
Typ: GENE0

Lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010

Stabilní, jednoduše čistitelná páková konstrukce lůžka

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál  
5. kolečko

Zdvih ložné plochy ovládaný elektromotorem

Polohování zádového dílu elektrické, 72°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, 25°

Autoregrese - zádový díl 10 cm, stehenní díl 8 cm k redukci tlaku v břišní oblasti a střížných sil během polohování

Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburg 16°

Záložní baterie

Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných kovových lamel

Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha)

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

4x univerzální držák příslušenství (hrazda, infuzní stojan) - hlavová a nožní část

Kroucený spirálový napájecí kabel, odolný, v délce 3m od čela lůžka při natažení

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel


Kompaktní jednodílné ¾ postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s bezpečným mechanismem zajištění zábran pod ložnou plochou

Možnost odejmutí zábran bez použití náradí

Kovová konstrukce lůžka lakována polyesterovými práškovými barvami: RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel dle vzorníku

Rozměry ložné plochy	90 x 200 cm
Vnější rozměry	102 x 215 cm
Zdvih ložné plochy	37 – 82 cm
Bezpečné provozní zatížení lůžka	250 kg
Hmotnost pacienta	215 kg

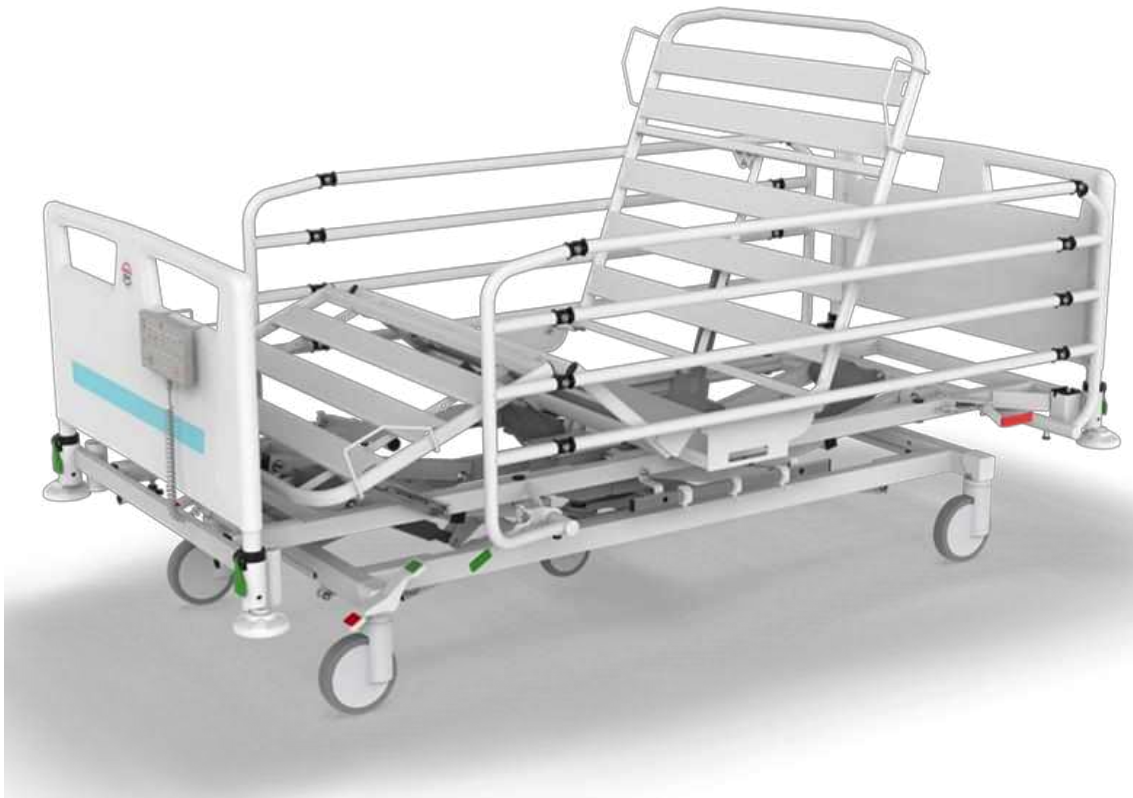

Příslušenství k lůžku

Hrazda  
- zesílená



Hrazdička popruhem  
- naviják



Závěsný košík



Infuzní stojan



Stolek sklopný na čelo lůžka



Pasivní antidekubitní matrace Soft Flex:

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II. - III. stupně)

Vyrobená ze studené a viscoelastické paměťové pěny

Studená pěna 40 kg/m<sup>3</sup> – spodní vrstva matrace

Visco pěna 50 kg/m<sup>3</sup> – vrchní vrstva matrace ve výšce 5cm

Spodní a vrchní vrstva matrace spojena tvarováním, bez lepení

Zónované jádro do sedmi anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Nosnost 200 kg

Rozměr matrace dle lůžka, 200 x 90cm

Výška matrace 14 cm

Potah SAFR - snímatelný

Potah pružný ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C.

Potah se zipem s ochranou proti zatečení (okapnička)

- ze dvou stran matrace.



Pol. č. 3: T-6018, lůžko e. polohovatelné pro intenzivní péči, vč. pasivní matrace, 13ks

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: VISION

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění

Stabilní podvozek - 3 sloupová konstrukce

Plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace – nožní páka po celé šíři lůžka

5. kolečko

Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru

Lýtkový díl polohovatelný pomocí dvou hřebenů v 5 krocích

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR a laterální náklon - polohování elektrické

Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7 cm

CPR - zádový díl

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm, mechanicky

Záložní baterie

2x univerzální držák příslušenství - hlavová část

2x univerzální držák příslušenství - nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z HPL - všechny díly rentgenovatelné (od zádového po pánevní díl ložné plochy)

Možnost použití C-ramene

Držák RTG kazety pod zádovým dílem

Centrální sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR poloha, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha, mobilizační poloha ) + ovládání vážícího systému

Integrovaný váhací systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, ukládání naměřených hodnot do paměti, váživost 300kg

Alarm opuštění lůžka pacientem

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Prodloužení lýtkového dílu

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Postranice plastové dělené (sada 4ks) s dostatečnou ochranou proti samovolnému spuštění

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování (z vnitřní strany patientský, z vnější strany sestřský)

Kroucený spirálový napájecí kabel, odolný, v délce 3m od čela lůžka při natažení

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel a zábran dle vzorníku

Maximální vnější rozměry lůžka: 222 x 105 cm

Rozměr ložné plochy: 200 x 90 cm

Výška ložné plochy bez matrace: 44 - 84 cm

Výška zábran nad ložnou plochou: 45 cm

Maximální úhel Trendelenburg: 16°

Maximální úhel Antitrendelenburg: 16°

Oboustranný laterální náklon: 20° / 20°

Bezpečné pracovní zatížení lůžka: 300 kg

Hmotnost pacienta: 235kg



## Příslušenství k lůžku

Hrazda  
- naviják



Hrazdička s popruhem

Závěsný košík

Stolek sklopný na čelo lůžka z HPL



Pasivní antidekubitní matrace Soft Flex:

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II. - III. stupně)

Vyrobená ze studené a viscoelastické paměťové pěny

Studená pěna 40 kg/m<sup>3</sup> – spodní vrstva matrace

Visco pěna 50 kg/m<sup>3</sup> – vrchní vrstva matrace ve výšce 5cm

Spodní a vrchní vrstva matrace spojena tvarováním, bez lepení

Zónované jádro do sedmi anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Nosnost 200 kg

Rozměr matrace dle lůžka, 200 x 90cm

Výška matrace 14 cm

Potah SAFR - snímatelný

Potah pružný ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C.

Potah se zipem s ochranou proti zatečení (okapnička)

- ze dvou stran matrace.



Pol. č. 4: T-6020, lůžko resuscitační, vč. pasivní matrace

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.  
Typ: VISION

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění  
Stabilní podvozek - 3 sloupová konstrukce  
Plastový kryt podvozku  
Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace – 4x plastový pedál 5. kolečko  
Zádový díl, stehenní díl a lýtkový polohovatelné pomocí elektromotoru  
Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR a laterální náklon - polohování elektrické  
Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7 cm  
CPR - zádový díl  
Nožní pedál - 7 funkcí (zdvih nahoru/dolu, CPR, vyšetřovací poloha, LAT pravý/levý, aktivace)  
Podsvětlení podvozku  
Zvuková signalizace připojení lůžka k el. síti při odbrzděných kolech  
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm pomocí elektromotoru  
Laterální rotační terapie  
Záložní baterie  
2x univerzální držák příslušenství - hlavová část  
2x univerzální držák příslušenství - nožní část  
Čtyřdílná ložná plocha z HPL - všechny díly rentgenovatelné (od zádového po pánevní díl ložné plochy)  
Možnost použití C-ramene  
Držák RTG kazety pod ložnou plochou - zakládání z boku  
Centrální sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR poloha, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha, mobilizační poloha ) + ovládání vázícího systému  
Integrovaný vázící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, ukládání naměřených hodnot do paměti, váživost 300kg  
Alarm opuštění lůžka pacientem  
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)  
Prodloužení lýtkového dílu  
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu  
Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)  
Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná  
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel  
Postranice plastové dělené (sada 4ks) s dostatečnou ochranou proti samovolnému spuštění  
Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování (z vnitřní strany patientský, z vnější strany sesterský)  
Integrované ukazatele náklonu v potranicích  
Kroucený spirálový napájecí kabel, odolný, v délce 3m od čela lůžka při natažení  
Barevný výplň čel a zábran dle vzorníku  
Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Maximální vnější rozměry lůžka:	222 x 105 cm
Rozměr ložné plochy:	200 x 90 cm
Výška ložné plochy bez matrace:	44 - 84 cm
Výška zábran nad ložnou plochou:	45 cm

Maximální úhel Trendelenburg:	16°
Maximální úhel Antitrendelenburg:	14°
Oboustranný laterální náklon:	30° / 30°
Bezpečné pracovní zatížení lůžka:	300 kg
Hmotnost pacienta:	235kg



#### Příslušenství k lůžku

Hrazda



Hrazdička s popruhem  
- naviják



Závěsný košík



Stolek sklopný na čelo lůžka z HPL





### Pasivní antidekubitní matrace Soft Flex:

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II. - III. stupně)

Vyrobená ze studené a viscoelastické paměťové pěny

Studená pěna 40 kg/m<sup>3</sup> – spodní vrstva matrace

Visco pěna 50 kg/m<sup>3</sup> – vrchní vrstva matrace ve výšce 5cm

Spodní a vrchní vrstva matrace spojena tvarováním, bez lepení

Zónované jádro do sedmi anatomických zón


Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Nosnost 200 kg

Rozměr matrace dle lůžka, 200 x 90cm

Výška matrace 14 cm

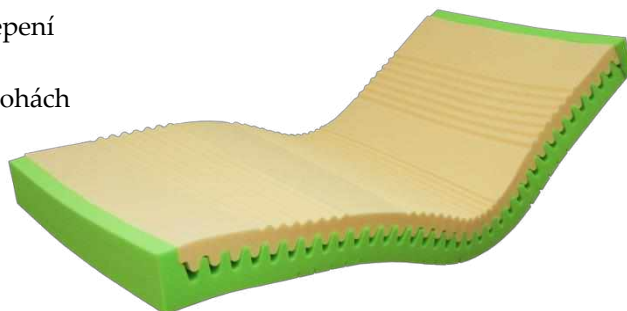

Potah SAFR - snímatelný

Potah pružný ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C.

Potah se zipem s ochranou proti zatečení (okapnička) - ze dvou stran matrace.

Pol. č. 5: T-6201, stolek noční s jídelní deskou pojízdný

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: NS-21-O

Oboustranné kovové provedení

Stolek lakovaný práškovými vypalovacími barvami

Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice

Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích

Zdvíhací mechanismus jídelní desky integrovaný do korpusu stolku

Jídelní deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného ABS plastu

Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem

Plastová vložka zásuvky z ABS

Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev

Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka

Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

Držák ručníků

Uzamykatelná dvířka

Možnost volby barevného provedení dvířek a šuplíku

Korpus stolku RAL 9016 bílá (jako lůžka)

Š x H x V: 52 x 45 x 91 cm

Rozměr jídelní desky: 55 x 36cm

Zdvih jídelní desky: 80 – 110cm

Nosnost jídelní desky: 10kg (ve středu jídelní desky)



Pol. č. 6: T-6215a, matrace antidekubitní aktivní (JIP/ARO), 6ks

Výrobce: Apex Medical Corp  
Typ: Pro-CARE AUTO

Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu, I - IV. stupeň léčby dekubitu  
Celová matrace s úchyty na kostru lůžka  
Auto adjusting systém – vždy ideální nastavení matrace, bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu pacienta (automatické nastavení tlaku)  
Protiskluzová úprava  
Nastavitelný komfort pacienta  
Potah snímatelný na zip  
20 odnímatelných cel  
Statický a dynamický režim  
Funkce maximálního ztuhnutí matrace  
CPR ventil  
Transportní mód  
Světelná kontrolka tlaku a servisu  
Akustický alarm výpadku proudu  
Funkce posazení pacienta  
Zámek kompresoru matrace  
Nosnost matrace 250kg  
Rozměry: 200 x 90 x 20,3 cm



Pol. č. 7: T-6215a, matrace antidekubitní aktivní (ortopedie), 4ks

Výrobce: Apex Medical Corp  
Typ: Pro-CARE AUTO

Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu, I - IV. stupeň léčby dekubitu  
Celová matrace s úchyty na kostru lůžka  
Auto adjusting systém – vždy ideální nastavení matrace, bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu pacienta (automatické nastavení tlaku)  
Protiskluzová úprava  
Nastavitelný komfort pacienta  
Potah snímatelný na zip  
20 odnímatelných cel  
Statický a dynamický režim  
Funkce maximálního ztuhnutí matrace  
CPR ventil  
Transportní mód  
Světelná kontrolka tlaku a servisu  
Akustický alarm výpadku proudu  
Funkce posazení pacienta  
Zámek kompresoru matrace  
Nosnost matrace 250kg  
Rozměry: 200 x 90 x 20,3 cm



## Tabulka plnění minimálních požadavků

Název VZ:	<b>Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod</b>				
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby				
Název firmy:	PROMA REHA, s.r.o.	IČO: 6321910 7	DIČ: CZ63219107	Datum:	02.11.2020

P ol · č.	Ozn.	Název položky	Množst ví [ks]	Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
1	T-6015	standardní elektricky stavitelná lůžka pro pacienty, vč. pasivní matrace	172		
		Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
		lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),		ANO	
		jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), celoplastový kryt podvozku, <b>nebo řešení viz DI č. 1, dotaz č. 1.</b>		ANO	celoplastový kryt podvozku
		zadavatel připouští nůžkovou, pákovou i sloupovou konstrukci lůžka,		ANO	páková konstrukce lůžka
		povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily jeho dekontaminaci a desinfekci,		ANO	
		veškeré svary musejí být celistvé a hladké,		ANO	
		4 dílná, snadno čistitelná ložná plastová plocha, nebo kovové lamely		ANO	kovové lamely
		elektricky výškově stavitelné lůžko, vzdálenost ložné plochy od podlahy v nejnižší poloze maximálně 40 cm, vzdálenost ložné plochy od podlahy v maximální výšce minimálně 75 cm – (uvedené vzdálenosti jsou požadovány z důvodu zajištění bezpečné mobilizace, péče o pacienta a práce personálu),		ANO	38,5 - 80cm

elektricky polohovatelná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů,	ANO	
manuální polohovatelnost lýtkového dílu minimálně ve 3 krocích, snadno proveditelné (tj. jednou sestrou jednou rukou), nebo pomocí elektromotorů,	ANO	manuální v 5 krocích pomocí mechanického hřebenu
automatický odsun zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 6 cm pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování, mechanismus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),	ANO	autoregrese zádová - 12cm autoregrese nožní - 6cm
možnost elektricky nastavitelné Antitrendelenburgovy/Trendelenburg 15° polohy pro včasnou vertikalizaci/mobilizaci pacienta,	ANO	TR / ATR - 16° / 16°
patientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (aktivační tlačítko), zámek funkcí,	ANO	
průměr kol min. 150 mm umožňující plynulý lehký pojezd, kola antistatická plastová s ložisky,	ANO	kolečka pr. 150mm
centrální oboustranné ovládání brzd, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakékoliv poloze lůžka,	ANO	
v rozích lůžka ochranné prvky (např. nárazová kolečka),	ANO	
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,	ANO	uchyty jsou hlavové i nožní část, celkem 4ks
odnímatelná kompaktní plastová čela s barevnou výplní (konkrétní barva bude upřesněna s vítězným účastníkem v rámci objednávky) a s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,	ANO	
minimální bezpečné zatížení lůžka 220 kg,	ANO	250kg
integrované prodloužení lůžka minimálně o 15 cm, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra,	ANO	20cm
kompaktní 3/4 postranice sklopné jednoduché nebo dělené, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bez možnosti ovládání postranic pacientem (sklopení musí probíhat s minimalizací	ANO	kompaktní 3/4 postranice sklopné jednoduché

prostoru potřebného pro sklopení, zadavatel nepřipouští překlopení postranice), bezpečné odjištění, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,		
manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy, CPR dostupné z obou stran lůžka	ANO	
vestavěná záložní baterie pro ovládání lůžka,	ANO	
oboustranné univerzální lišty na příslušenství,	ANO	
svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu	ANO	
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3 m od čela lůžka při natažení,	ANO	
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,	ANO	
napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz.	ANO	230V / 50-60Hz
<b>Rozměry:</b>		
ložná plocha min. (š x d) 85 x 200 cm v základním postavení, tj. bez prodloužení	ANO	200 x 85cm
vnější rozměry lůžka max. 99 x 223 cm, z důvodu průjezdnosti a prostorového uspořádání	ANO	215 x 97cm
<b>Pasivní antidekubitní matrace:</b>		
Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně)	ANO	
Jádru matrace vyrobené ze studené pěny o hustotě min. 40 kg/m <sup>3</sup>	ANO	hustota jádra 40kg/m <sup>3</sup>
Zpevněné vyztužené okraje tužší pěnou, <b>nebo řešení viz DI č. 1, dotaz č. 2.</b>	ANO	zpevněné okraje tužší pěnou
Podélný a příčný antidekubitní prořez zajišťující zónovou tuhost a dobrou ventilaci jádra	ANO	
Nosnost matrace min. 200 kg	ANO	200kg
Výška matrace min. 14 cm	ANO	14cm

Rozměr matrace dle lůžka	ANO	200x85cm
Potah matrace pružný min. ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, prateľný do teploty 70 °C	ANO	
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace	ANO	
<b>Příslušenství ke každému lůžku:</b>		
1 ks hrazdy k lůžku,	ANO	
1 ks hrazdičky plastové včetně nastavitelného popruhu,	ANO	
<b>Příslušenství ke 64 ks lůžek na oddělení chirurgie</b>		
64 ks infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost výměny stran)	ANO	
lišta se 4 ks pohyblivých háčků na obě strany lůžka (128 ks)	ANO	
15 ks přenosný kovový držák na berle	ANO	
25 ks přenosný držák močové lahve	ANO	
2 ks fixační systém	ANO	
10 ks závěsný držák skleněné infuzní láhve	ANO	
6 ks poliček nebo jiného zařízení k upevnění mobilního monitoru na jakémkoliv lůžko na standardním pokoji	ANO	
<b>Příslušenství ke 32 ks lůžek na oddělení ortopedie</b>		
16 ks extenční nerezová souprava	ANO	
4 ks držák monitoru	ANO	
32 ks držák na berle	ANO	
32 ks infuzní nerezové stojany	ANO	
32 ks teplotka plastová A5	ANO	
32 ks držák podložní mísa	ANO	
16 ks držák nádoby na močovou lahev	ANO	
64 ks držák urologických sáčků na moč 4 háčky	ANO	
<b>Příslušenství ke 23 ks lůžek pro dětské oddělení</b>		
3 x držák na infuzi teleskopický	ANO	
2 x infuzní stojan pojízdný	ANO	
3 x držák nádoby na moč	ANO	
8 x polička na monitor	ANO	
3 x stůl sklopný na čelo lůžka	ANO	
3 x držák urologických sáčků	ANO	
1 x sada fixačních pásů	ANO	
5 x stůl sklopný na čelo lůžka	ANO	

		hrazdy a hrazdičky na všechna lůžka		ANO	
<b>Příslušenství ke 22+2 ks lůžek na porodnici</b>					
		ke všem lůžkům teleskopický infuzní stojan		ANO	
		5 ks držáků na močový sáček		ANO	
		5 ks poliček na psaní na čelo		ANO	
		hrazdy a hrazdičky na všechny lůžka		ANO	
<b>Příslušenství ke 25 ks lůžek na gynekologii</b>					
		ke všem lůžkům teleskopický infuzní stojan		ANO	
		5 ks držáků na močový sáček		ANO	
		5 ks poliček na psaní na čelo		ANO	
		hrazdy a hrazdičky na všechny lůžka		ANO	
<b>Příslušenství ke 4 ks lůžek na dospávací pokoj gynekologie</b>					
		4 ks teleskopických infuzních stojanů		ANO	
		4 ks poliček na psaní na čelo postele		ANO	
<b>P</b>	<b>ol</b>	<b>Název položky</b>	<b>Množství [ks]</b>	<b>Splněn požadavek? ANO/NE</b>	<b>Upřesnění splnění požadavku</b>
<b>č.</b>	<b>Ozn.</b>				
2	T-6015a	standardní elektricky stavitelná lůžka pro pacienty, vyšší nosnost, vč. pasivní matrace	4		
		lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),		ANO	
		jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin),		ANO	
		zadavatel připouští sloupovou i pákovou konstrukci lůžka,		ANO	páková konstrukce lůžka
		povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily jeho dekontaminaci a desinfekci,		ANO	
		veškeré svary musejí být celistvé a hladké,		ANO	
		elektrický Trendelenburg a Antitrendelenburg minimálně +/- 14°,		ANO	TR / ATR - 16° / 16°
		kompaktní 3/4 postranice sklopné jednodílné nebo dělené, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bez možnosti ovládní postranic pacientem umýstěné pod úroveň ložné ploch (sklopení musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení, zadavatel		ANO	kompaktní 3/4 postranice sklopné jednodílné



nepřipouští překlopení postranice), bezpečné odjištění, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,		
výškově stavitelné lůžko elektricky, vzdálenost ložné plochy od podlahy v rozsahu minimálně <b>40-75 cm</b> pro bezpečnou mobilizaci a péči o pacienta a práci personálu,	ANO	37 - 82cm
bezpečné pracovní zatížení minimálně 250 kg, hmotnost pacienta minimálně 215kg,	ANO	bezpečné pracovní zatížení 250kg, hmotnost pacienta 215kg
plně elektromotorické polohování jednotlivých dílů ložné plochy (elektromotorické nastavení výšky minimálně zádového a stehenního dílu),	ANO	
polohování lýtkového dílu ložné plochy pomocí min. dvou hřebenů snadno proveditelné (tj. jednou sestrou jednou rukou), nebo pomocí elektromotorů,	ANO	pomocí dvou hřebenů v 5 krocích
čtyřdílná ložná plocha, díly ložné plochy plastové/HPL/kovové, kompaktní,	ANO	kovové lamely
autoregrese zádového a nožního dílu pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování pacienta, mechanismus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),	ANO	autoregrese zádová - 10cm autoregrese nožní - 8cm
manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy,	ANO	
sesterský panel musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámký) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (min. RES, TR a aTR),	ANO	
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,	ANO	uchyty jsou hlavové i nožní část, celkem 4ks
odnímatelná kompaktní plastová čela s barevnou výplní (konkrétní barva bude upřesněna s vítězným účastníkem v rámci každé objednávky) a s aretací proti samovolnému vytažení při transportu;	ANO	



zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,		
manuální integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy o min. 15 cm umožňující přizpůsobit délku ložné plochy výšce pacienta, prodloužení/zkrácení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra, nebo pomocí jednoho elektromotoru,	ANO	manuální prodloužení o 20cm
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3m od čela lůžka při natažení,	ANO	
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,	ANO	
napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz,	ANO	230V / 50-60Hz
eurolišta s univerzálními háčky po bocích lůžka,	ANO	
nosná kolečka antistatická plastová o průměru minimálně 150 mm s brzdou,	ANO	kolečka pr. 150mm
minimálně 4 nárazová kolečka v rozích lůžka,	ANO	
páté centrální kolečko pro jednodušší transport a ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka)	ANO	
<b>Rozměry:</b>		
ložná plocha min. (š × d) 85 × 200 cm.	ANO	200x90cm
<b>Příslušenství ke každému lůžku:</b>		
1 ks zesílená hrazda k lůžku,	ANO	
1 ks plastová hrazdička včetně popruhu s navijákem,	ANO	
1 ks lakovaný závěsný košík,	ANO	
1 ks sklopná polička,	ANO	
vestavěná záložní baterie	ANO	
<b>1 ks</b> infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost výměn stran)	ANO	
<b>Pasivní antidekubitní matrace:</b>		
Jádro matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 38 kg/m <sup>3</sup> ,	ANO	hustota pěny 40kg/m <sup>3</sup>
Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m <sup>3</sup> , o výšce min. 5 cm	ANO	hustota pěny 50kg/m <sup>3</sup>

Vrstvy matrace spojeny tvarováním (bez lepení) - pro lepší provzdušnění matrace a redukcí střížných sil vznikajících při polohování	ANO	
Matrace rodělena do min. 7 anatomických zón	ANO	7 zón
Pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II – III stupně)	ANO	matrace pro II. až III. stupeň dekubitů
Potah snadno snímatelný – zip do L s ochranou proti průsaku nečistot do jádra (okapnička)	ANO	
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na 70°C	ANO	
Rozměr matrace dle lůžka, výška matrace min. 14 cm	ANO	200x90x14cm
Nosnost matrace min. 200 kg	ANO	200kg

P ol · č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	T-6018	<b>lůžko el.polohovatelné pro intenzivní péči, vč. pasivní matrace</b>	13

				Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění				ANO	
Lůžko pro vyšší intenzivní péči:				ANO	
lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),				ANO	
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), nebo kryt podvozku				ANO	kryt podvozku
zadavatel připouští sloupovou konstrukci lůžka,				ANO	
povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily jeho dekontaminaci a desinfekci,				ANO	
veškeré svary musejí být celistvé a hladké,				ANO	
elektrický Trendelenburg a Antitrendelenburg minimálně +/- 12°,				ANO	TR / ATR - 16° / 16°
oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°				ANO	20°/ 20°
integrován váhící systém umožňující vážení pacienta v jakékoli poloze				ANO	

s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta,		
alarm opuštění lůžka pacientem,	ANO	
pracovní vážitelnost integrované váhy min. 230 kg,	ANO	váživost 300kg
zvýšená výška postranic min. 44 cm nad povrchem ložné plochy, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, postranice dělené, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,	ANO	výška postranic 45cm
výškově stavitelné lůžko elektricky, vzdálenost ložné plochy od podlahy v rozsahu minimálně 44 - 75cm pro bezpečnou mobilizaci a péči o pacienta a práci personálu,	ANO	44 - 84cm
bezpečné pracovní zatížení minimálně 250 kg, maximální hmotnost pacienta minimálně 185 kg,	ANO	bezpečné pracovní zatížení 300kg, hmotnost pacienta 235kg
elektromotorické polohování jednotlivých dílů ložné plochy (elektromotorické nastavení výšky minimálně zádového a stehenního dílu),	ANO	
polohování lýtkového dílu ložné plochy pomocí min. dvou hřebenů, snadno proveditelné (tj. jednou sestrou jednou rukou), nebo pomocí elektromotorů,	ANO	pomocí dvou hřebenů v 5 krocích
čtyřdílná ložná plocha, díly ložné plochy plastové/HPL, kompaktní, přizpůsobené pro rentgenování klasickým RTG přístrojem, C ramenem bez omezení hrudníku až k pánvi,	ANO	ložná plocha HPL
autoregrese zádového a nožního dílu pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování pacienta, mechanismus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),	ANO	autoregrese zádová - 14cm autoregrese nožní - 7cm
manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy,	ANO	
centrální sesterský panel s ovládáním všech funkcí a vázícího systému, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými	ANO	

polohami (min. RES, TR, aTR a kardiacké křeslo),		
pacientský ovládací panel s možností blokace,	ANO	v zábrách
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,	ANO	uchyty jsou hlavové i nožní část, celkem 4ks
2odnímatelná kompaktní plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,	ANO	
manuální integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy min. 20 cm umožňující přizpůsobit délku ložné plochy výšce pacienta, prodloužení/zkrácení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra, nebo pomocí elektromotoru,	ANO	manuální prodloužení o 20cm
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření délce min. 3m od čela lůžka při natažení,	ANO	
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,	ANO	
napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz,	ANO	230V / 50-60Hz
eurolišta s univerzálními háčky po bocích lůžka,	ANO	
nosná kolečka antistatická plastová o průměru minimálně 150 mm s brzdou a aretací, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakémkoliv poloze lůžka,	ANO	kolečka pr. 150mm
minimálně 4 nárazová kolečka v rozích lůžka,	ANO	
páté centrální kolečko pro jednodušší transport a ovládání společně s centrálním ovládacím brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka),	ANO	nožní páka po celé šířce lůžka
<b>Příslušenství ke každému lůžku:</b>		
1 ks hrazda k lůžku,	ANO	

1 ks plastová hrazdička včetně popruhu s navijákem,	ANO	
1 ks lakovaný závěsný košík,	ANO	
1 ks sklopná polička,	ANO	
vestavěná záložní baterie	ANO	
<b>Rozměr:</b>		
ložná plocha min. (š × d) 90 x 200 cm.	ANO	200 x 90 cm
<b>Pasivní antidekubitní matrace:</b>		
Jádro matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 38kg/m <sup>3</sup> ,	ANO	hustota pěny 40kg/m <sup>3</sup>
Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m <sup>3</sup> , o výšce min. 5cm	ANO	hustota pěny 50kg/m <sup>3</sup>
Vrstvy matrace spojeny tvarováním (bez lepení) - pro lepší provzdušnění matrace a redukci střížných sil vznikajících při polohování	ANO	
Pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II – III stupně)	ANO	matrace pro II. až III. stupeň dekubitů
Potah snadno snímatelný – zip minimálně do L s ochranou proti průsaku nečistot do jádra (okapnička)	ANO	
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na <b>70 °C</b>	ANO	
Rozměr matrace dle lůžka, výška matrace min. 14 cm	ANO	200x90x14cm
Nosnost matrace min. 200 kg	ANO	200kg

P o l i č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
4	T-6020	lůžko resuscitační, vč. pasivní matrace	4

				Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění				ANO	
lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),				ANO	
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), nebo kryt podvozku				ANO	kryt podvozku
zadavatel připouští sloupovou konstrukci lůžka,				ANO	
povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela				ANO	

znesložily jeho dekontaminaci a desinfekci,		
veškeré svary musejí být celistvé a hladké,	ANO	
integrovaný vážicí systém umožňující vážení pacienta v jakékoli poloze s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta,	ANO	
alarm opuštění lůžka pacientem,	ANO	
pracovní vážitelnost integrované váhy min. 250 kg,	ANO	váživost 300kg
oboustranný laterální náklon minimálně +/- 30° s možností laterálního polohování v automatickém (kontinuálním) režimu s programovatelnými časy a úhly pro prevenci a podporu léčby dekubitů, plicních komplikací,	ANO	laterální náklon 30°/30°
integrovaný ukazatel náklonu v postranicích,	ANO	
elektrický Trendelenburg a Antitrendelenburg minimálně +/- 12°,	ANO	TR / ATR - 16° / 14°
zvýšená výška postranic min. 44 cm nad povrchem ložné plochy, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, postranice dělené, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,	ANO	výška postranic 45cm
výškově stavitelné lůžko elektricky, vzdálenost ložné plochy od podlahy v rozsahu min. 44 – 78cm pro bezpečnou mobilizaci a péči o pacienta a práci personálu,	ANO	44 - 84cm
bezpečné pracovní zatížení minimálně 250 kg, maximální hmotnost pacienta min. 230 kg,	ANO	bezpečné pracovní zatížení 300kg, hmotnost pacienta 235kg
plně elektromotorické polohování všech dílů ložné plochy,	ANO	
čtyřdílná ložná plocha, díly ložné plochy plastové/HPL, kompaktní, přizpůsobené pro rentgenování klasickým RTG přístrojem, C ramenem bez omezení hrudníku až k pánvi,	ANO	ložná plocha HPL
konstrukce lůžka přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu,	ANO	
autoregrese zádového a nožního dílu pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování pacienta, mechanismus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),	ANO	autoregrese zádová - 14cm autoregrese nožní - 7cm

manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy,	ANO	
centrální sesterský panel s ovládáním všech programovatelných funkcí a vážícího systému, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (min. RES, TR, aTR a kardiacké křeslo),	ANO	
integrované ovladače v postranicích z vnější (pacientský) i vnitřní strany (sesterský)	ANO	
nožní pedál - z každé strany lůžka jeden (min. laterální náklon pravý, laterální náklon levý, vyšetřovací poloha, polohování ložné plochy nahoru, polohování ložné plochy dolů + aktivace pedálu)	ANO	
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,	ANO	
odnímatelná kompaktní plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,	ANO	
integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy min. 20 cm umožňující přizpůsobit délku ložné plochy výšce pacienta, pomocí elektromotoru,	ANO	elektrické prodloužení 20cm
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3m od čela lůžka při natažení,	ANO	
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,	ANO	
napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz,	ANO	230V / 50-60Hz
eurolišta s univerzálními háčky po bocích lůžka,	ANO	

nosná kolečka antistatická plastová o průměru minimálně 150 mm s brzdou a aretací, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakékoliv poloze lůžka,	ANO	kolečka pr. 150mm
minimálně 4 nárazová kolečka v rozích lůžka,	ANO	
páté centrální kolečko pro jednodušší transport a ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka),	ANO	nožní překlopná dvouramenní páka
<b>Příslušenství ke každému lůžku:</b>		
1 ks hrazda k lůžku,	ANO	
1 ks plastová hrazdička včetně popruhu s navijákem,	ANO	
1 ks lakovaný závěsný košík,	ANO	
1 ks sklopná polička,	ANO	
vestavěná záložní baterie	ANO	
<b>Rozměr:</b>		
ložná plocha min. (š × d) 90 x 200 cm.	ANO	200 x 90cm
<b>Pasivní antidekubitní matrace:</b>		
Jádro matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 38 kg/m <sup>3</sup> ,	ANO	hustota pěny 40kg/m <sup>3</sup>
Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m <sup>3</sup> , o výšce min. 5 cm	ANO	hustota pěny 50kg/m <sup>3</sup>
Vrstvy matrace spojeny tvarováním (bez lepení) - pro lepší provzdušnění matrace a redukci střížných sil vznikajících při polohování	ANO	
Pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II – III stupně)	ANO	matrace pro II. až III. stupeň dekubitů
Potah snadno snímatelný – zip do minimálně dvou stran s ochranou proti průsaku nečistot do jádra (okapnička)	ANO	
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na 70 °C	ANO	
Rozměr matrace dle lůžka, výška matrace min. 14 cm	ANO	200x90x14cm
Nosnost matrace min. 200 kg	ANO	200kg

P ol · č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
--------------------	------	---------------	---------------

Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
-----------------------------	-----------------------------



5	T-6201	stolek noční s jídelní deskou pojízdný	190		
		Oboustranné kovové provedení		ANO	
		Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv		ANO	
		Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice		ANO	
		Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích		ANO	
		Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu/HPL po celém obvodu		ANO	
		Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem		ANO	
		Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí		ANO	
		Plastová vložka zásuvky z ABS		ANO	
		Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev		ANO	
		Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička		ANO	
		Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm		ANO	klolečka o pr. 65mm
		Uzamykatelná dvířka		ANO	
		Držák ručníku		ANO	
		Korpus stolku bílý (stejná barva jako lůžka)		ANO	RAL 9016
		Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele		ANO	dle vzorníku dodavatele
		Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek		ANO	dle vzorníku dodavatele
		Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cm Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cm Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cm Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cm Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cm		ANO	52 x 45 x 91 cm
		Rozměr jídelní desky min. 55 x 35 cm		ANO	55 x 36cm
		Zdvih jídelní desky min. 25 cm		ANO	80 - 110cm
		Nosnost jídelní desky min. 5 kg		ANO	10kg ve středu jídelní desky, 5kg na kraji jídelní desky

P	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
---	------	---------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------

Č. ·				
6	T-6215a	matrace antidekubitní aktivní (JIP/ARO)	6	
		Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu I-IV. stupeň léčby dekubitu		ANO
		Celová matrace s úchyty na kostru lůžka		ANO
		Automatický systém - ideální nastavení matrace bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu pacienta		ANO
		Protiskluzová úprava		ANO
		Nastavitelný komfort pacienta		ANO
		Potah snímatelný na zip		ANO
		min. 20 odnímatelných cel		ANO 20 odnímatelných cel
		Statický a dynamický režim		ANO
		Režim maximálního ztuhnutí matrace		ANO
		Režim posazení pacienta		ANO
		CPR ventil		ANO
		Transportní mód bez kompresoru		ANO
		Světelná kontrolka tlaku a servisu		ANO
		Akustický alarm výpadku proudu		ANO
		Zámek kompresoru matrace		ANO
		Nosnost matrace minimálně 200 kg		ANO nosnost 250kg
		Rozměr matrace 200 x 90 cm		ANO 200x90cm
		Výška matrace max. 23 cm		ANO 20,3cm

P ol · č.	Ozn.	Název položky	Množst ví [ks]	Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
7	T-6215b	matrace antidekubitní aktivní (ortopedie)	4		
		pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až III.stupně			Dle "Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)" uchazeč může nabídnout, v položce č. 7, matraci o parametrech uvedených v položce č. 6 (tj. matraci s ozn. T-6215a).
		režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku			Tím to tedy nabízíme do položky č.7 matraci o parametrech uvedených v položce č. 6 (tj. matraci s ozn. T-6215a).

(při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)		
možnost nastavení tlaku dle váhy pacienta		
možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru)		
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování		
struktura matrace s různou velikostí/konstrukcí cel minimálně ve 3 zónách (hlava, tělo, paty)		
nejkratší nastavitelná perioda dynamického režimu maximálně 20 minut		
možnost rychlého vypuštění pro KPR		
nosnost minimálně 200 kg		
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti		
zip, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra		
plná tvarová a rozměrová kompatibilita s lůžky, výška maximálně 20 cm		
samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování		

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:									
Zástupci kupujícího:									
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav obalů zboží	Výsledek montáže, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	školení zdravotnického personálu, včetně vystavení protokolu a protokolu opravňujícího provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE	

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady


V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**zástupce prodávajícího**  
(jméno, razítko a podpis)

\_\_\_\_\_  
**zástupce kupujícího 1.**  
(jméno, razítko a podpis)

\_\_\_\_\_  
**zástupce kupujícího 2.**  
(jméno, razítko a podpis)