



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Pořízení RTG přístrojů pro ONN“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,

nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 27.6.2022 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž si je vědom toho, že tak činí po zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení a tuto skutečnost následně zohlední v rámci dalších úkonů zadavatele:

Dotaz č. 1:

„číslo 1.44 – Barevný dotykový displej o velikosti min. 10“ a ovládání na krytu primární clony pro volbu nastavení/zobrazení expozičních parametrů, úhlu náklonu, kolimace, SID, zvoleného orgánového programu, zvolené filtrace apod..“


Bude zadavatel akceptovat RTG přístroj od renomovaného výrobce s velikostí displeje 7“ – při zachování požadovaných nároků dle zadávací dokumentace.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

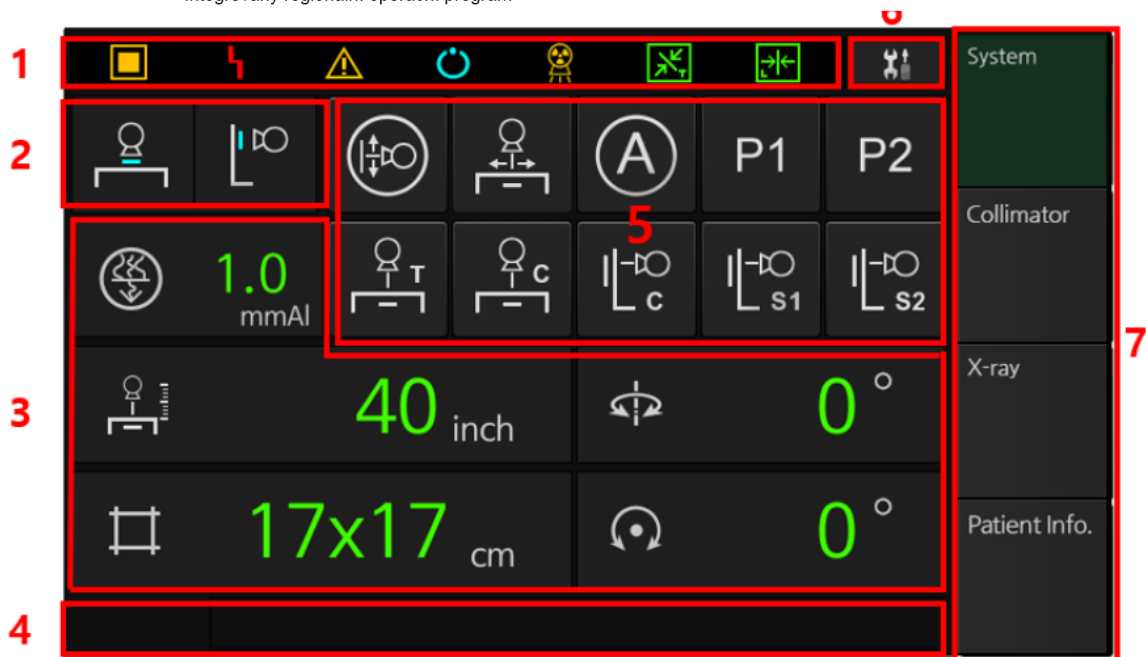

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Generator&Detent status indicator | 2. Detector status indicator |
| 3. Position information | 4. Message box |
| 5. Auto positioning function | 6. Configuration |
| 7. Menu | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku. Pro účel přehledného dotykového ovládání a zobrazování všech požadovaných informací je dle zadavatele min. požadovaná velikost displeje opodstatněná. Navíc, v rámci průzkumu bylo zjištěno, že většina světových výrobců RTG systémů má tento dotykový ovládací displej s uhlopříčkou větší než požadovaných 10".

Dotaz č. 2:

„V bodě 1.49 – požaduje zadavatel DICOM tiskárna

Nechápeme proč zadavatel požaduje tuto tiskárnu, neboť všechny snímky budou odesílány do PACS nebo lokálně ukládány v paměti akviziční stanice?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel nadále nepožaduje v rámci specifikace (bod 1.49) DICOM tiskárnu, jedná se v současných provozních podmínkách o nadbytečnou součást akviziční stanice.

Změna výše uvedeného parametru v rámci technických požadavků zadavatele bude zohledněna v navazujících úkonech zadavatele, přičemž dojde rovněž k úpravě příslušné přílohy č. 2_3 zadávací dokumentace.

V Praze dne 7. července 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**