


ZMĚNOVÝ LIST Z01
UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE CT V M.Č. E.1.38

Dle výkresu technologie PS 01 č. V-01a je zakresleno **optimální umístění technologie CT** v rámci stávající vyšetřovny CT. V případě, že s ohledem na velikost stávající vyšetřovny CT a rozměr nové technologie CT nebude možno toto uspořádání zajistit, je možno uvažovat natočení gantry CT (viz výkres č. V-01b). **Zadavatelem preferované umístění, s natočením osy gantry CT v opačném směru, je uvedeno na schématu níže.** Konečné uspořádání technologie CT nutno po ukončeném výběrovém řízení nechat odsouhlasit uživatelem !!

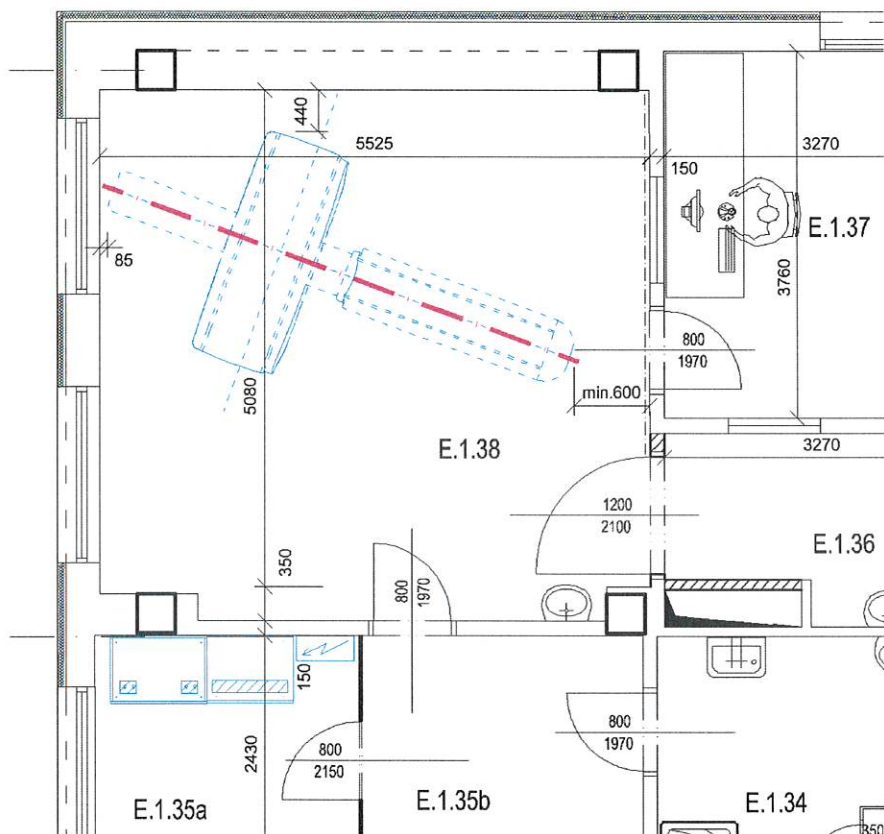

Vzhledem k tomu, že v době zpracování tohoto projektu nebyl ještě uživatelem proveden výběr dodavatele technologie počítačové tomografie (CT), jsou stavebně instalační požadavky určeny pokud možno univerzálně (porovnání dle podkladů firem vybraných projektantem nebo vytipovány lékařem). **Tyto požadavky je proto třeba brát pouze jako orientační s tím, že v případě výběru dodavatele CT musí být tyto podklady aktualizovány a upřesněny dle podkladů vybrané firmy a to formou dodatku technologického projektu – technologický projekt bude zajištěn vybraným dodavatelem technologie CT!!!**

Tento změnový list Z01 se tímto stává nedílnou součástí projektu „Stavební úpravy pro obměnu zařízení CT, Oblastní nemocnice Jičín, pavilon E, st. p. č. 3329, k.ú. Jičín“ z 04/2021.

V Ústí nad Labem, dne 23.06.2022


Ing. Martin Gazda

