

DODATEČNÉ INFORMACE č.3

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

„Dodávka a instalace laparoskopické věže pro chirurgické oddělení ON Náchod a.s.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ26000202
Způsob zadání:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1

Standardní příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné

Požadavek:

- ručky a bipolární pinzety po 3 ks (160 mm rovná, 160 mm Zahn., 300 mm částečně izol., 350 mm plně izol.)
- neutrální elektroda jednorázová – dělená, nedělená, pro dospělé, dětská
- neutrální elektroda pro opakované použití

Dotaz:

Je jednorázová neutrální elektroda požadována dělená i nedělená, nebo záleží na volbě uchazeče ?

Odpověď na dotaz č.1

Neutrální elektroda jednorázová je požadována dělená i nedělená.

ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel níže popsaným způsobem mění zadávací podmínky veřejné zakázky, včetně lhůty pro podání nabídek, v zadávací dokumentaci, část 2.1 Parametry zdravotnických přístrojů, odstavec Standardní příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné a to následujícím způsobem:

Dotaz č. 2:

Standardní příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné

Požadavek:

- ručky a bipolární pinzety po 3 ks (160 mm rovná, 160 mm Zahn., 300 mm částečně izol., 350 mm plně izol.)

Dotaz:

Co zadavatel rozumí pod pojmem částečně, resp. plně izolovaná pinzeta. Které části nástroje se izolace týká ?

Dotaz č. 3:

Standardní příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné

Požadavek:

- ručky a bipolární pinzety po 3 ks (160 mm rovná, 160 mm Zahn., 300 mm částečně izol., 350 mm plně izol.)

Dotaz:

Požadavek na pinzetu 350 mm - bude zadavatel akceptovat laparoskopický nástroj s odpovídající pracovní částí a připojením na bipolární výstup ?

Odpověď na dotaz č. 2 a 3

Zadavatel upravuje obchodní podmínku uvedenou v článku 2.1 Parametry zdravotnických přístrojů, odstavec **Standardní příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné** a to následujícím způsobem:

Ruší:

Standardní příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné:

- ručky a bipolární pinzety po 3 ks (160 mm rovná, 160 mm Zahn., 300 mm částečně izol., 350 mm plně izol.)
- neutrální elektroda jednorázová – dělená, nedělená, pro dospělé, dětská
- neutrální elektroda pro opakované použití

Systém bude plně kompatibilní se stávajícím vybavením (výrobce stávajícího vybavení je firma Olympus). Kompatibilita může být zabezpečena oboustrannými redukcemi.

Zadavatel nově požaduje:

Standardní příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné:

- neutrální elektroda jednorázová – dělená, nedělená, pro dospělé, dětská
- neutrální elektroda pro opakované použití

Systém bude plně kompatibilní se stávajícím vybavením (výrobce stávajícího vybavení je firma Olympus). Kompatibilita může být zabezpečena oboustrannými redukcemi.

ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel níže popsaným způsobem mění zadávací podmínky veřejné zakázky, včetně lhůty pro podání nabídek, v zadávací dokumentaci, část 2.1 Parametry zdravotnických přístrojů, odstavec Odsávačka a Zdroj světla následovně:

Zadavatel upravuje požadavek v odstavci „Odsávačka“. Zadavatel nově požaduje (zvýrazněno):

➤ **Odsávačka**

- vakuometr
 - mikrobiofiltr
 - držák pro přenášení
 - odsávací láhev min. 1,5 litru
 - nominální vakuum 85 kPa
 - sací výkon min. 20 l / min
 - bezúdržbový provoz a resterilizovatelné příslušenství
 - **proplach u odsávačky – průtok min. 0-1,5l za min., max. tlak 300-500 mmHg, hadicový set resterilizovatelný, koncovka/proplach/sání 5 mm a 10 mm**
- Systém bude plně kompatibilní se stávajícím vybavením (výrobce stávajícího vybavení je firma Olympus). Kompatibilita může být zabezpečena oboustrannými redukcemi.

Zadavatel upravuje požadavek v odstavci „Zdroj světla“. Zadavatel nově požaduje (zvýrazněno):

➤ Zdroj světla

- LED technologie
- životnost minimálně 30 000 hodin
- světelný výkon odpovídající 180W xenonové výbojce
- **lze nabídnout také xenonový zdroj světla s výkonem 300 W**

System bude plně kompatibilní se stávajícím vybavením (výrobce stávajícího vybavení je firma Olympus). Kompatibilita může být zabezpečena oboustrannými redukcemi.

Zadavatel upravuje termín pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek:


Zadavatel z důvodů úpravy zadávacích podmínek prodlužuje termín pro podání nabídek do **26.1.2015 do 10:00 hod.**

Otevírání obálek se tak uskuteční 26.1.2015 v 10:15 hodin v sídle zadavatele, zasedací místnost budova „E“.

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Náchodě dne 08.01.2014

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
21

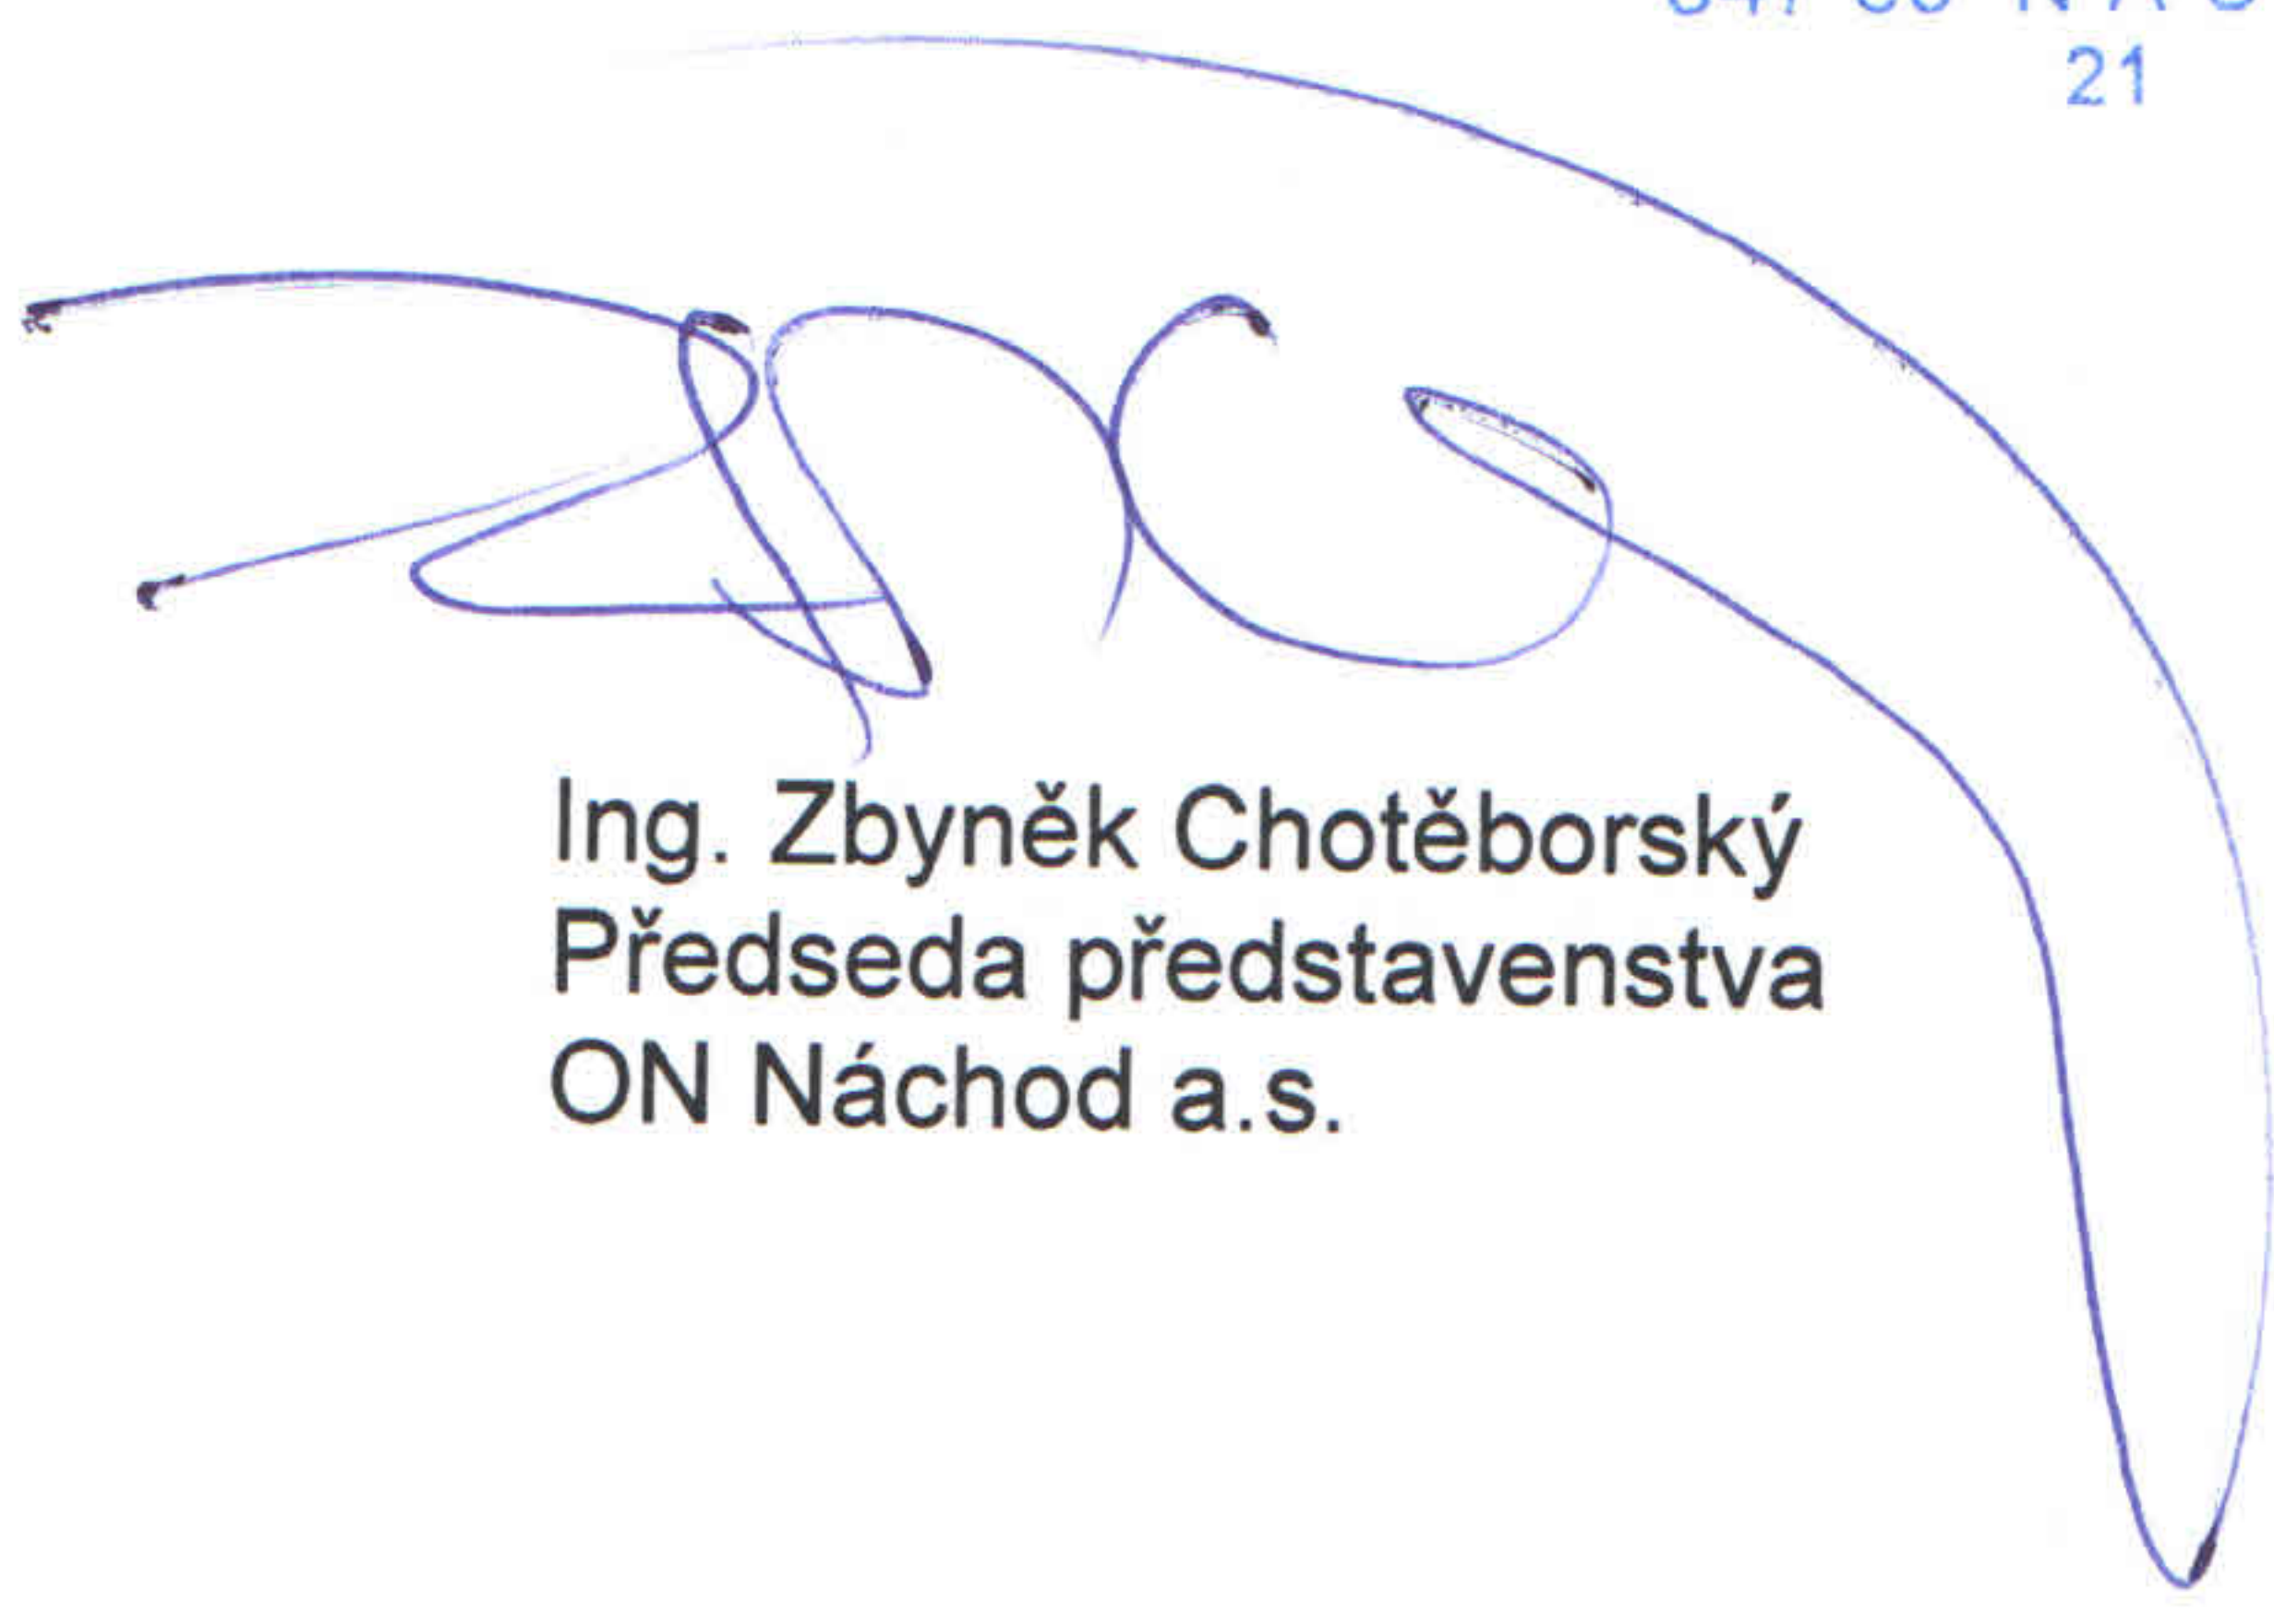

Ing. Zbyněk Chotěborský
Předseda představenstva
ON Náchod a.s.