

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Obchodní firma: **PROMA REHA, s.r.o.**
IČO: 63219107
DIČ: CZ63219107
Se sídlem: Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
Zastoupena: Petrem Bucharem, vedoucím obchodu pro ČR
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:
.....
Email: servis@promareha.cz / obchod2@promareha.cz

dále jen jako „**poskytovatel**“ na straně jedné

a

Název: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
IČO: 260 00 202
DIČ: CZ 26000202
DIČ pro účely DPH: CZ 699004900
Sídlem: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Zastoupena: RNDr. Bc. Janem Machem, členem správní rady
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 78-8883900227/0100

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:
.....
e-mail:@nemocnicenachod.cz

dále jen jako „**objednatel**“ či „**ONN**“ na straně druhé

Preambule

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací objednatele, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem **Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Čl. 1

Postavení smluvních stran

- (1) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

Čl. 2

Předmět a účel smlouvy

- (1) Tato smlouva přímo závisí na potřebě **pozáručního servisu pro vybavení - elektricky polohovatelná lůžka, matrace a noční stolky** - pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN), které je blíže specifikováno v **příloze č. 1** této smlouvy a bylo pořízeno na základě kupní smlouvy uzavřené rovněž ve výše uvedeném zadávacím řízení (dále jen „**kupní smlouva**“). Smluvní strany prohlašují, že všechny podmínky kupní smlouvy jsou jim v době uzavření této smlouvy známy.
- (2) Účelem této smlouvy je zajištění správné funkčnosti a bezpečnosti vybavení jako zdravotnických přístrojů, které jsou objednatelem používány k poskytování zdravotní péče.
- (3) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele za sjednanou odměnu provádět na náklad poskytovatele pro objednatele pozáruční servisní služby k vybavení, jehož bližší specifikace tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou poskytovatele podanou do zadávacího řízení. Účelem této smlouvy je zajištění neustálé provozuschopnosti vybavení a splnění požadavků právních předpisů na provoz tohoto vybavení u objednatele způsobem splňujícím medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem a právními předpisy, korespondující s návodem k obsluze vybavení, jeho technickou specifikací a pokyny výrobce, spočívající zejména v následujících úkonech (dále jen „**pozáruční servis**“)
 - provádění pravidelných **bezpečnostně technických kontrol a revizí** dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZP**“), seřizování, provádění kontrol a dalších činností dle pokynů výrobce a příslušných právních předpisů, které se k zajištění bezpečnosti a funkčnosti vybavení vztahují (dále jen „**BTK**“),
 - **pověření a proškolení** obsluhujícího personálu ONN k provádění instruktáže/školení nově příchozích zaměstnanců ONN, pokud to výrobce umožní, **nebo poskytování instruktáže** obsluhujícího personálu dle ZZP při nástupu nových pracovníků autorizovanou osobou po celou dobu životnosti vybavení,
 - **dodávky veškerých nových, nepoužitých náhradních dílů při opravách vybavení** po dobu, kdy je poskytován servis dle této smlouvy,
 - **garance servisní odezvy,**
 - **příp. nutné aktualizace systémového SW u vybavení po dobu jeho životnosti.**

- (4) Součástí předmětu dle této smlouvy je i v provádění oprav jakýchkoli vad, které se projeví či nastanou v době poskytování servisu dle této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak (dále jen jako „**poskytování potřebných servisních služeb**“).

(Pozáruční servis a poskytování potřebných servisních služeb společně jako „**servis**“).

- (5) Veškerý servis dle této smlouvy bude prováděn **po ukončení záručního servisu dle kupní smlouvy na výše uvedené vybavení, a to v přímé návaznosti na ukončení záručního servisu. Smlouva bude účinná po dobu 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Čl. 3

Rozsah servisu a místo plnění

- (1) Poskytovatel je povinen provádět pozáruční servis vybavení v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Poskytovatel je povinen provádět i veškeré další činnosti a garantovat dodávky veškerých náhradních dílů, jichž je za účelem dosažení účelu této smlouvy zapotřebí.
- (2) Místem provádění servisu jsou prostory v sídle objednatele, kde se vybavení nachází, nestanoví-li objednatel v konkrétní objednávce jinak. V případě, že není možné provádět servis v těchto prostorách či to charakter vady vybavení vyžaduje, je místem plnění pro účely provádění servisu provozovna poskytovatele. Poskytovatel si v tomto případě vybavení dopraví do své provozovny a zpět k objednateli na své náklady.
- (3) Poskytovatel prohlašuje, že veškerý servis, BTK a opravy budou provádět pouze příslušně vyškolení pracovníci dle ZZP. Příslušná potvrzení, osvědčení, zápisy a jiné podobné listiny k prokázání splnění podmínek před kontrolními orgány (zejm. Státní ústav pro kontrolu léčiv) předá poskytovatel bezodkladně objednateli.

Čl. 4

Poskytování servisu

- (1) Požadavky objednatele na provedení servisu, s výjimkou provádění servisu spočívajícího v provádění pravidelných BTK servisovaného vybavení dle odst. 3 tohoto článku, budou vznášeny prostřednictvím objednávek zasílaných poskytovateli (dále jen „**objednávka**“), a to v pracovních dnech v čase od 8:00 do 17:00 (dále rovněž jen „**pracovní doba poskytovatele**“) písemně na elektronickou e-mailovou adresu servis@promareha.cz a telefonicky na odpovědnou osobu provádějícího servis:

Jméno a příjmení:

.....

E-mail: servis@promareha.cz

- (2) Poskytovatel je povinen v pracovních dnech ve své pracovní době neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od obdržení objednávky, tuto skutečnost objednateli (resp. odpovědné osobě objednatele) potvrdit, a to na e-mailovou adresu@nemocnicenachod.cz nebo@nemocnicenachod.cz, včetně vymezení časové náročnosti na provedení požadavku dle objednávky, popř. si vyžádat od objednatele doplňující informace, které nezbytně potřebuje ke splnění svých povinností. Objednávka se má za potvrzenou okamžikem dohody smluvních stran ohledně jejího obsahu, včetně lhůt k provedení.
- (3) V havarijních případech lze objednávku provést telefonicky, písemné potvrzení objednávky se provede bez zbytečného odkladu následně.
- (4) Předpokládaná cena provedení servisní činnosti bude uvedena v potvrzení objednávky, při navýšení těchto nákladů musí být objednatel upozorněn a navýšení nákladů odsouhlasit.
- (5) Náhradní díly, pomocný materiál a případně kompletní výrobky, které bude nutno vyměnit, budou fakturovány dle skutečné spotřeby po odsouhlasení objednatelem.
- (6) Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je poskytovatel povinen provádět BTK přístrojového

vybavení:

- v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou normou a výrobcem,
- provádění veškerých kontrol či podobných úkonů vyžadovaných k provozu zařízení platnou legislativou či doporučeními a pokyny výrobce, zejm. pak bezpečnostně technické kontroly, kontrolu elektrické bezpečnosti, apod.

Tyto bezpečnostně technické kontroly provádí poskytovatel bez vyzvání dle požadavků výrobce a v souladu s platnou legislativou. Termín a provedení pravidelné údržby je poskytovatel povinen dohodnout s objednatelem nejméně **30 pracovních dnů** předem. Pokud poskytovatel neplní řádně a včas tuto povinnost, tak případné sankce a postihy od kontrolních orgánů jdou k jeho tíži a ponese za ně plnou odpovědnost, příp. bude povinen Objednateli nahradit škodu takto vzniklou, a to bez ohledu na příp. sjednané smluvní pokuty. Plánované odstávky vybavení nezbytné pro zajištění preventivní údržby, nezbytných bezpečnostně technických kontrol, zkoušek provozní stálosti, ověřování, apod. ze strany poskytovatele nepřesáhnou **5 pracovních dnů** v roce. V ostatním platí pro provádění pravidelné údržby přístrojového vybavení stejné podmínky jako pro ostatní případy poskytování servisu.

(7) Předmětem této smlouvy je rovněž provádění oprav veškerých vad vybavení, které se projeví či nastanou v době, kdy je poskytován servis dle této smlouvy. Pro odstranění nejasností se výslovně stanoví, že vadou vybavení se rozumí zejména jakékoli omezení funkčnosti, bezpečnosti, využitelnosti či uživatelského komfortu vybavení bez ohledu na důvod tohoto omezení.

(8) S prováděním oprav vybavení je poskytovatel povinen započít, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, **v pracovních dnech do 24 hodin od jejího nahlášení, v ostatních dnech do 48 hodin od jejího nahlášení**, pokud se nebude jednat o složitou závadu, která bude vyžadovat delší čas na přípravu. V takovém případě bude dohodnut jiný termín pro započítání s prováděním oprav.

Poskytovatel je povinen odstranit závadu a provést opravu přístrojového vybavení nejpozději **do 72 hodin** od nahlášení závady. Pakliže se jedná o závažnou závadu vyžadující delší termín pro opravu, zejména závadu k jejímuž odstranění je nezbytné dodání náhradního dílu, který nemá poskytovatel k dispozici na skladě a musí tento díl objednat, jsou smluvní strany povinny v této lhůtě dohodnout jiný adekvátní termín (lhůtu) pro provedení takové opravy. Do lhůty pro odstranění závady se nezapočítává doba od objednání náhradního dílu do jeho naskladnění, případně doba odpovídající jiné prokazatelné překážce, nezaviněné poskytovatelem, bránící včasnému provedení opravy. Náhradní díl je poskytovatel povinen objednat nejpozději **do 72 hodin** od nahlášení závady.

Poskytovatel se zavazuje na vyzvání objednatele k (bezplatnému) **vypůjčení náhradního přístrojového vybavení** srovnatelných nebo lepších parametrů po dobu opravy, pokud nebude závada odstraněna, **do 72 hodin od nahlášení závady**, nebo při odvozu přístrojového vybavení do externího servisu.

(9) O provedení pozáručního servisu poskytovatelem na základě této smlouvy a objednávky bude vždy poskytovatelem **sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, za objednatele technikem ONN** (dále jen „**servisní výkaz**“). Servisní výkaz bude obsahovat zejména specifikaci vybavení (min. název, typ, výrobní číslo a **evidenční číslo objednavatele**), k němuž byl poskytován servis, popis, co bylo obsahem servisu a datum jeho provedení. Tento poskytovatel předá objednateli při předání a převzetí dle čl. 11 této smlouvy, nebo následně, nejpozději však do jednoho týdne od poskytnutí plnění na e-mail:

.....@nemocnicenachod.cz,@nemocnicenachod.cz .

(10) Poskytovatel je povinen v případě potřeby použití náhradních dílů při provádění servisu vybavení pořídit a použít pouze nové náhradní díly doporučené pro tyto účely výrobcem. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, odpovídá poskytovatel objednateli za veškeré škody vzniklé objednateli v souvislosti s použitím vybavení poté, co tuto svoji povinnost porušil, čímž není dotčena jeho povinnost k nápravě, ani nároky objednatele vyplývající z jiných ustanovení této smlouvy.

- (11) Poskytovatel se při poskytování servisu zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelné právní předpisy či jiné normy, jakož i podmínky ostrahy objednatele a jeho provozního areálu.

Čl. 5

Prohlášení poskytovatele

- (1) Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je v souladu s podmínkami stanovenými v ZZP oprávněn poskytovat služby, vykonávat činnosti týkající se vybavení dle této smlouvy. **Výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby provádějící distribuci a servis obecných zdravotnických prostředků tvořících předmět VZ či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace této osoby na SÚKL, tvoří Přílohu č. 4** této smlouvy. Poskytovatel je povinen objednatel informovat o jakékoliv změně registrace v Registru zdravotnických prostředků, která vznikne vydáním potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti, a to neprodleně, nejdéle však do 1 měsíce od nastalé změny vztahující se k předmětu smlouvy. Pokud poskytovatel tuto svou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- (2) Poskytovatel prohlašuje, že má k dispozici veškeré návody k obsluze vybavení, jeho technickou specifikaci, jakož i veškerou další dokumentaci, které je za účelem provádění servisu dle této smlouvy zapotřebí.
- (3) Poskytovatel se zavazuje zajistit utajování důvěrných a utajovaných informací všemi pracovníky a rovněž i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, o kterých se poskytovatel v souvislosti se svou činností pro objednatel dozví nebo dostane do kontaktu, dále veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Ustanovení tohoto článku se vztahují, jak na období trvání této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.
- (4) Poskytovatel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- (5) Poskytovatel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na poskytování služeb, budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při poskytování služeb přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u poskytovatele.

Čl. 6

Další práva a povinnosti smluvních stran

- (1) Poskytovatel je povinen poskytovat servis, k němuž je zavázán, poctivě, s vynaložením veškeré pečlivosti, znalostí a odbornou péčí, které jsou s jeho povoláním spojeny. Je přitom povinen dbát zájmů objednatele a chránit jeho dobrou pověst.
- (2) Při plnění závazků z této smlouvy plynoucích budou obě smluvní strany jednat ve smyslu zásad dobré víry a poctivého obchodního styku.

- (3) Poskytovatel zajistí v pracovní době poskytovatele bezplatnou **možnost přímé telefonické konzultace technického problému** s vybavením, a to osobou k tomu odborně příslušnou, na tel. č. +420 775 776 137 či elektronicky na e-mailové adrese servis@promareha.cz. Odezva poskytovatele musí být nejpozději **do 24 hodin** od nahlášení problému.
- (4) Poskytovatel se zavazuje být během plnění závazků dle této smlouvy v potřebném spojení s objednatelem a pravidelně jej informovat o výsledcích plnění svých povinností.
- (5) Poskytovatel může pro plnění účelu této smlouvy smluvně spolupracovat s třetími osobami, které splňují požadavky příslušných právních předpisů, jiných norem či této smlouvy vztahujících se k provádění servisu. V takovém případě však odpovídá stejně, jako kdyby závazky z této smlouvy plnil sám.
- (6) Objednatel je povinen v rámci poskytování součinnosti umožnit poskytovateli plný přístup k vybavení. Objednatel se dále zavazuje provozovat vybavení v souladu s návodem k obsluze, instrukcemi a v souladu s odborným školením provedeným technikou poskytovatele.
- (7) V záležitostech poskytování informací poskytovateli a všech ostatních záležitostech vyplývajících z této smlouvy, je kontaktní osobou na straně objednatele:
- a. jméno, příjmení:
 - b. adresa: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
 - c. tel.: + 420
 - d. e-mail:@nemocnicenachod.cz nebo jí pověřený pracovník
- (8) **Odpovědnou osobou poskytovatele** ve věcech plnění závazků dle této smlouvy je:
- Jméno, příjmení:
 - adresa: Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
 - tel. č.: +420
 - e-mail: obchod2@promareha.cz
- (9) Smluvní strany nejsou oprávněny provádět zápočty pohledávek bez souhlasu druhé smluvní strany. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplyvá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.
- (10) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení smlouvy či smlouvy.
- (11) Jakékoli zřízení zástavního práva k věci kupujícího se považuje za nesjednané s ohledem na ustanovení § 25 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
- (12) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Čl. 7

Cena servisu a platební podmínky

- (1) V ceně servisních činností jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s jejich provedením, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení včetně ceny potřebných náhradních dílů/servisních kitů nutných k provedení BTK dle pokynů výrobce), pokud nejsou z provádění

servisu dle této smlouvy výslovně vyjmuty.

- (2) Cena za provedení servisních činností je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijetí nabídky poskytovatele. Ceny jednotlivých úkonů, které jsou součástí servisních činností, jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena náhradních dílů bude vždy předmětem jednání.
- (3) Poskytovatel může navrhnout zvýšení ceny pouze v souvislosti se **změnou daňových právních předpisů** ve smyslu změny zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, nebo na základě písemné dohody smluvních stran.
- (4) Ceny (jednotkové ceny pozáručního servisu) uvedené v Příloze č. 2 smlouvy nebudou měněny po dobu účinnosti smlouvy.
- (5) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- (6) Objednatel požaduje daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě. Doručení proběhne do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu fakturace@nemocnicenachod.cz.
- (7) Datem zdanitelného plnění je 1. den kalendářního čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ve kterém bylo poskytnuto plnění dle této smlouvy. Poskytovatel je tedy povinen daňové doklady (faktury) vystavovat čtvrtletně zpětně, tj. vždy za předchozí 3 měsíce poskytování servisu dle předmětu této smlouvy. Faktury budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (8) Faktury jsou splatné ve lhůtě **60 (šedesát) dní** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Doba splatnosti je sjednána v souladu s ust. § 1963 odst. 2 občanského zákoníku s ohledem na povahu plnění předmětu této smlouvy, s čímž smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.
- (9) Faktury budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (10) Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Na faktuře budou identifikovány smluvní strany, dále na ní bude uvedena specifikace vybavení (min. název, typ, výrobní číslo, evidenční číslo objednavatele), k němuž je poskytován servis, popis servisní činnosti, označení této smlouvy a příp. objednávky objednatele, podpis osoby oprávněné k vystavení faktury poskytovatele, je-li to technicky možné. K faktuře budou doloženy kopie příslušných podepsaných servisních výkazů jako její nedílná příloha za fakturované období.
- (11) V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit poskytovateli k opravě či doplnění a nedostává se do prodlení s úhradou faktury. Od doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
- (12) Poskytovatel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

Čl. 8 Záruka

- (1) **Na servis** poskytuje poskytovatel záruku v délce trvání **6 měsíců** a na dodané **náhradní díly** poskytuje poskytovatel záruku v délce trvání **2 let**. Záruka na servis a na náhradní díly trvá rovněž po ukončení trvání této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen oznámit případné vady poskytnutého servisu bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.

- (3) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

Čl. 9 **Pojištění**

- (1) Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve výši minimálně **2.000.000 Kč** (slovy dva miliony korun českých). Kopie pojistné smlouvy - respektive dokument potvrzující pojištění tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- (2) Poskytovatel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného servisu; v případě změn prováděného servisu je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu poskytování servisu pojistné krytí požadované v odst. 1 tohoto článku smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu poskytování servisu dle této smlouvy je poskytovatel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.
- (3) Jakékoliv škody z plnění vzniklé objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním dle tohoto článku, budou hrazeny poskytovatelem.
- (4) V případě, že objednatel nebo poskytovatel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.
- (5) V případě, že poskytovatel poruší povinnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Čl. 10 **Doba trvání a zánik smlouvy, přerušování poskytování servisu**

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu poskytování servisu uvedenou v čl. 2 odst. 5 této smlouvy.
- (2) Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě nebo její ukončení musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vztupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší, než Dodatek pozdější.
- (3) Tato smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
- a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni;
 - b) odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývajících z této smlouvy řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůtě 30 dnů;
 - c) odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.
- (4) Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10-ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- (5) V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.

- (6) Objednatel je oprávněn pozastavit poskytování plnění dle této smlouvy doručením písemné výzvy k pozastavení poskytování servisu poskytovateli (dále jen „**pozastavení poskytování servisu**“), a to do doby přesně stanovené ve výzvě, nebo do doručení písemného odvolání této výzvy. Za dobu, kdy je pozastaveno poskytování servisu, poskytovatel není povinen plnit dle této smlouvy, zejména není povinen odstranit závady, které se projeví v době.

Čl. 11

Předání a převzetí

- (1) Po řádném provedení servisu je poskytovatel povinen předat objednateli výsledek své činnosti a vystavit o tomto předání objednateli písemné potvrzení. Poskytovatel se zavazuje objednatele písemně či prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu@nemocnicenachod.cz;@nemocnicenachod.cz, vyzvat k převzetí výsledku své činnosti a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání **přiměřenou dobu předem s ohledem na prováděný servisní úkon (tj. alespoň 2 pracovní dny předem, pokud nejde o servisní úkon prováděný v sídle kupujícího)**, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí. Pokud poskytovatel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí odmítnout. Na výzvu poskytovatele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí výsledku.
- (2) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí výsledku činnosti poskytovatele, bude mezi smluvními stranami dojednáán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma stranám.
- (3) Poskytovatel je povinen zároveň před předáním a převzetím výsledku své činnosti na své nebezpečí provést přezkoušení vybavení a jeho uvedení zpět do provozu za účelem zjištění, že servis byl řádně proveden. Provedením tohoto přezkoušení se poskytovatel nemůže dovolávat existence zjevných vad, ledaže prokáže, že zjevná vada musela být objednateli při provedení tohoto přezkoušení známa.
- (4) Předpokladem předání a převzetí výsledku činnosti poskytovatele je prokázání, že vybavení je po provedení servisu způsobilé plnit své funkce a má předepsané, příp. jinak obvyklé vlastnosti.
- (5) Objednatel je povinen převzít výsledek řádně provedeného servisu v místě plnění a v souladu s touto smlouvou. Objednatel je oprávněn převzetí výsledku činnosti poskytovatele odmítnout zejména v případě, že tento výsledek bude vykazovat vadu (vady) vybavení nebo použitého náhradního dílu, které byly předmětem servisní činnosti.

Čl. 12

Sankce

- (1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
- (2) V případě, že poskytovatel nedodrží termíny uvedené v článku 4 odst. 8 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý pracovní den takového prodlení, a to v případě, že nedojde k zapůjčení náhradního přístrojového vybavení srovnatelných nebo lepších parametrů po celou dobu opravy.
- (3) V případě porušení povinnosti provádět bezpečnostně technické kontroly, opravy a instruktáž pouze vyškolenými pracovníky dle ZZP, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (4) Pro případ porušení povinnosti použít při provádění servisu vybavení pouze nové náhradní díly doporučené pro tyto účely výrobcem, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti použít výhradně výrobcem doporučené náhradní díly nebo porušení povinnosti použít výhradně nové výrobcem doporučené náhradní díly.

- (5) Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 5 odst. 3 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (6) V případě prodlení poskytovatele s vypůjčením náhradního přístrojového vybavení srovnatelných nebo lepších parametrů po celou dobu opravy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- (7) Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povinnosti, na něž se vztahuje, do 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (8) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na uhrazenou výši smluvní pokuty. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost poskytovatele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- (9) Objednatel nepřipouští sjednání omezení rozsahu náhrady škody. Jakékoli vyloučení či omezení rozsahu náhrady škody způsobené výrobkem uvedené v dohodě se považuje za nesjednané.
- (10) Objednatel neakceptuje sjednání smluvních pokut ve svůj neprospěch, jakákoli ujednání o smluvních pokutách, které by měl hradit objednatel, se tedy ve smlouvě považují za nesjednané.

Čl. 13

Podmínky doručování

- (1) Veškerá komunikace smluvních stran v záležitostech vyplývajících z této smlouvy bude probíhat následujícími způsoby: prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce této smlouvy, prostřednictvím kontaktních osob prodávajícího, resp. kupujícího uvedených v hlavičce smlouvy, datovou schránkou, e-mailem či osobně v sídlech smluvních stran.
- (2) Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně místa podnikání/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno a nastanou účinky doručení dle odst. 3 tohoto článku.
- (3) Pro účely této smlouvy se písemnost odeslaná prostřednictvím držitele poštovní licence považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem od odeslání (tímto ustanovením není dotčen čl. 10 odst. 4 této smlouvy upravující okamžik doručení písemnosti obsahující odstoupení od smlouvy), písemnost odeslaná e-mailem okamžikem potvrzení o jejím doručení adresátovi a písemnost odeslaná datovou schránkou okamžikem dodáním do datové schránky adresáta.

Čl. 14¹

Přílohy

- (1) Příloha č. 1: Doplněná technická specifikace
- (2) Příloha č. 2: Jednotkové ceny pozáručního servisu
- (3) Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě

¹ Účastník příp. připojí jako další přílohu plnou moc, pokud smlouvu za prodávajícího podepisuje osoba na základě plné moci.

- (4) Příloha č. 4: Doklad osvědčující způsobilost k servisu zdravotnických prostředků (Výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby provádějící distribuci a servis obecných zdravotnických prostředků tvořících předmět VZ či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace této osoby na SÚKL

V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před přílohami.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti ihned po uplynutí záruční doby dle kupní smlouvy v souvislosti s níž se tato smlouva uzavírá.
- (2) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i se zveřejněním celé této smlouvy. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto smlouvu zasílá k uveřejnění do registru smluv objednatel. Objednatel bude ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.
- (3) Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků z této smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem společnosti jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, pověřeného pracovníka, místa dodávky, bankovního spojení apod.), budou oznámeny písemným doporučeným dopisem druhé smluvní straně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
- (4) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění a nahrazuje veškeré předchozí dohody, smlouvy a jiná ujednání učiněná ve vztahu k tomuto předmětu plnění smluvními stranami v minulosti, ať již v písemné, ústní či jiné formě.
- (5) Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat tuto smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky poskytovatele jako dodavatele, zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- (7) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
- (8) Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené touto smlouvou se vylučuje. Smluvní strany si rovněž potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- (9) Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřena elektronicky**.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.

Poskytovatel: 10.02.2021

Objednatel: 15.02.2021

.....
PROMA REHA, s.r.o.
Petr Buchar
vedoucí obchodu pro ČR


.....
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
RNDr. Bc. Jan Mach
člen správní rady

Pol. č. 1: T-6015, standardní elektricky stavitelné lůžko pro pacienty, vč. pasivní matrace, 172ks

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.
 Typ: PLE-N85-T

Lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52:2010
 Stabilní, jednoduše čistitelná páková konstrukce lůžka
 Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál
 Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka
 Celoplastový kryt podvozku
 Elektrický zdvih ložné plochy (zdvihový mechanismus pod ložnou plochou)
 Polohování zádového dílu elektrické, 73°
 Polohování nožního dílu elektrické, 40°
 Polohování lýtkového dílu mechanické, pomocí hřebene v 5 krocích, 25°
 Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburg
 Autoregrese zádového dílu 12cm
 Autoregrese stehenního dílu 6cm
 Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka
 Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh a ochranou proti nechtěnému polohování (GO tlačítko), podsvícený s barevně odlišenými funkcemi
 Záložní baterie
 Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
 Kroucený spirálový napájecí kabel, odolný, v délce 3m od čela lůžka při natažení
 Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm
 4x univerzální držák příslušenství (hrazda, infuzní stojan) - hlavová a nožní část
 Eurolišty (2ks) + plastový háček (8ks)
 Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných kovových lamel
 Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová
 Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná
 Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel
 Kompaktní jednodílné ¾ postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s bezpečným mechanismem zajištění zábran pod ložnou plochou
 Možnost odejmutí zábran bez použití náradí
 Kovová konstrukce lůžka lakována polyesterovými práškovými barvami: RAL 9016 bílá
 Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha:	200 x 85 cm
Vnější rozměry:	215 x 97cm
Zdvih ložné plochy:	38,5 – 80 cm
Elektrický TR/ATR	16°/ 16°
Bezpečné provozní zatížení lůžka:	250 kg

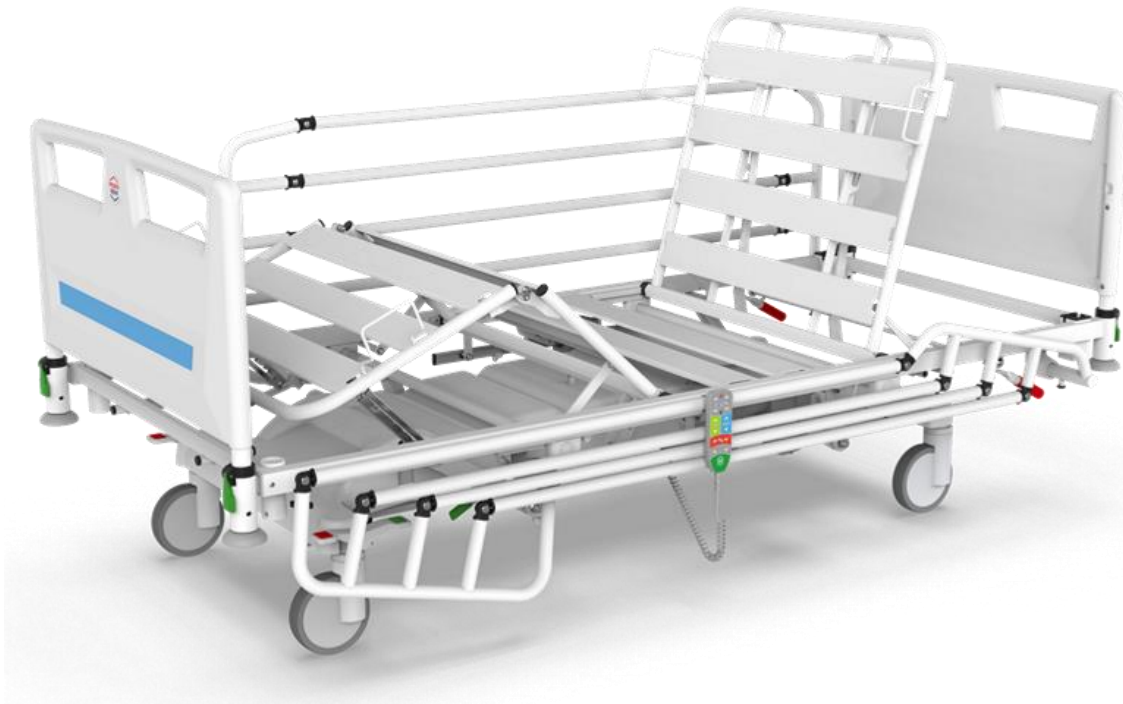

Pasivní antidekubitní matrace Lux S

Preventivní pasivní antidekubitní matrace

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně)

Vyrobena ze studené pěny o hustotě 40kg/m³

Zpevněné okraje jádra tužší pěnou

Jádro matrace rozděleno do pěti anatomických zón

Díky prořezu jádra je výrazně zlepšeno rozložení tlaku na matraci

Matrace díky příčnému prořezu dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách a dokonale se přizpůsobuje tělu pacienta

Nosnost matrace 200kg

Výška matrace 14 cm

Rozměr matrace dle lůžka, 200x85cm


Potah SAFR

Potah pružný ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný,

antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním

prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace

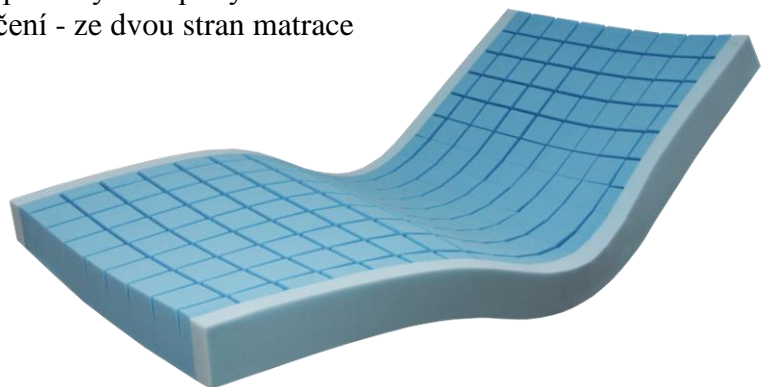

Příslušenství:

Hrazda



Hrazdička s popruhem



Držák nádoby na moč



Držák sáčků na moč



Přenosný držák 2ks holí
závěsný



Držák infuzní láhve s pojistkou,




Infuzní stojan

- hliníkový, 4x háček
- teleskopický



Fixační systém

- flexibilní (fixace hrudní, břišní, zápěstí, kotníků)

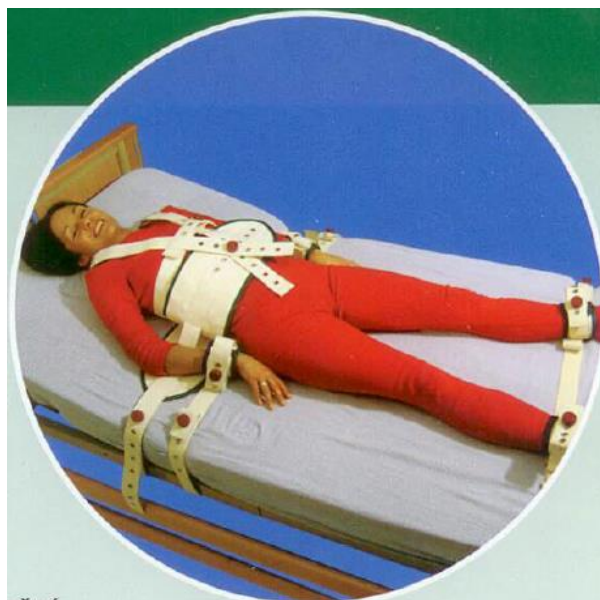

Držák monitoru



Extenční souprava




Infuzní nerezový stojan



Jmenovka (teplotka) A5




Držák na podložní mísu

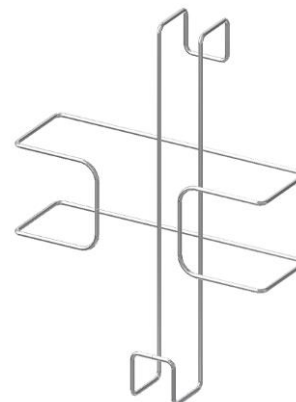

Držák urol. sáčků
- 4x háček



Infuzní stojan, pojízdný

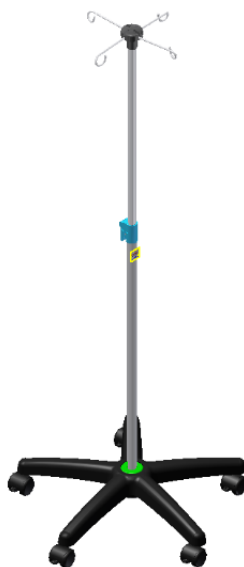

Stolek sklopný na čelo lůžka



**Pol. č. 2: T-6015a, standardní elektricky stavitelné lůžko pro pacienty,
vyšší nosnost, vč. pasivní matrace, 4ks**

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.
Typ: GENE0

Lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010
Stabilní, jednoduše čistitelná páková konstrukce lůžka
Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace - 2x
plastový pedál
5. kolečko
Zdvih ložné plochy ovládaný elektromotorem
Polohování zádového dílu elektrické, 72°
Polohování nožního dílu elektrické, 40°
Polohování lýtkového dílu mechanické, 25°
Autoregrese - zádový díl 10 cm, stehenní díl 8 cm k redukci tlaku v břišní oblasti a sřizných sil
během polohování
Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburg 16°
Záložní baterie
Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných kovových lamel
Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých
funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého
křesla, Trendelenburkova poloha)
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)
4x univerzální držák příslušenství (hrazda, infuzní stojan) - hlavová a nožní část
Kroucený spirálový napájecí kabel, odolný, v délce 3m od čela lůžka při natažení
Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)
Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel
Kompaktní jednodílné ¾ postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s bezpečným
mechanismem zajištění zábran pod ložnou plochou
Možnost odejmutí zábran bez použití náradí
Kovová konstrukce lůžka lakována polyesterovými práškovými barvami: RAL 9016 bílá
Barevný výplň čel dle vzorníku

Rozměry ložné plochy	90 x 200 cm
Vnější rozměry	102 x 215 cm
Zdvih ložné plochy	37 – 82 cm
Bezpečné provozní zatížení lůžka	250 kg
Hmotnost pacienta	215 kg



Příslušenství k lůžku

Hrazda
- zesílená



Hrazdička popruhem
- naviják

Závěsný košík



Infuzní stojan



Stolek sklopný na čelo lůžka



Pasivní antidekubitní matrace Soft Flex:

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II. - III. stupně)

Vyrobená ze studené a viscoelastické paměťové pěny

Studená pěna 40 kg/m³ – spodní vrstva matrace

Visco pěna 50 kg/m³ – vrchní vrstva matrace ve výšce 5cm

Spodní a vrchní vrstva matrace spojena tvarováním, bez lepení

Zónované jádro do sedmi anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Nosnost 200 kg

Rožměr matrace dle lůžka, 200 x 90cm

Výška matrace 14 cm

Potah SAFR - snímatelný


Potah pružný ve dvou směrech,

paropropustný, omyvatelný, antialergický,
antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním
prostředkům,

se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C.

Potah se zipem s ochranou proti zatečení (okapnička)

- ze dvou stran matrace.

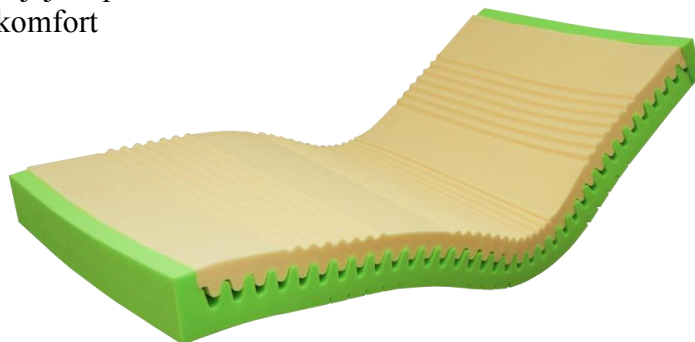

Pol. č. 3: T-6018, lůžko e. polohovatelné pro intenzivní péči, vč. pasivní matrace, 13ks

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: VISION

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění

Stabilní podvozek - 3 sloupová konstrukce

Plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace – nožní páka po celé šíři lůžka

5. kolečko

Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru

Lýtkový díl polohovatelný pomocí dvou hřebenů v 5 krocích

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR a laterální náklon - polohování elektrické

Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7 cm

CPR - zádový díl

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm, mechanicky

Záložní baterie

2x univerzální držák příslušenství - hlavová část

2x univerzální držák příslušenství - nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z HPL - všechny díly rentgenovatelné (od zádového po pánevní díl ložné plochy)

Možnost použití C-ramene

Držák RTG kazety pod zádovým dílem

Centrální sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce

jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR poloha, vyšetřovací poloha,

poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha, mobilizační poloha) + ovládání vázícího systému

Integrovaný vázící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, ukládání naměřených hodnot do paměti, váživost 300kg

Alarm opuštění lůžka pacientem

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Prodloužení lýtkového dílu

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Postranice plastové dělené (sada 4ks) s dostatečnou ochranou proti samovolnému spuštění

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování (z vnitřní strany patientský, z vnější strany sesterský)

Kroucený spirálový napájecí kabel, odolný, v délce 3m od čela lůžka při natažení

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel a zábran dle vzorníku

Maximální vnější rozměry lůžka: 222 x 105 cm

Rozměr ložné plochy: 200 x 90 cm

Výška ložné plochy bez matrace: 44 - 84 cm

Výška zábran nad ložnou plochou: 45 cm

Maximální úhel Trendelenburg: 16°

Maximální úhel Antitrendelenburg: 16°

Oboustranný laterální náklon: 20° / 20°

Bezpečné pracovní zatížení lůžka: 300 kg

Hmotnost pacienta: 235kg



Příslušenství k lůžku


Hrazda



Hrazdička s popruhem
- naviják



Stolek sklopný na čelo lůžka z HPL

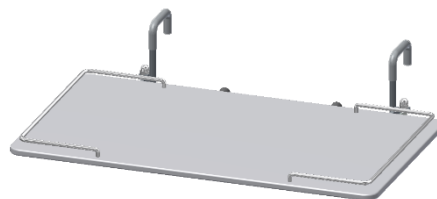

Pasivní antidekubitní matrace Soft Flex:

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II. - III. stupně)

Vyrobená ze studené a viscoelastické paměťové pěny

Studená pěna 40 kg/m³ – spodní vrstva matrace

Visco pěna 50 kg/m³ – vrchní vrstva matrace ve výšce 5cm

Spodní a vrchní vrstva matrace spojena tvarováním, bez lepení

Zónované jádro do sedmi anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Nosnost 200 kg

Rozměr matrace dle lůžka, 200 x 90cm

Výška matrace 14 cm


Potah SAFR - snímatelný

Potah pružný ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C.

Potah se zipem s ochranou proti zatečení (okapnička)

- ze dvou stran matrace.

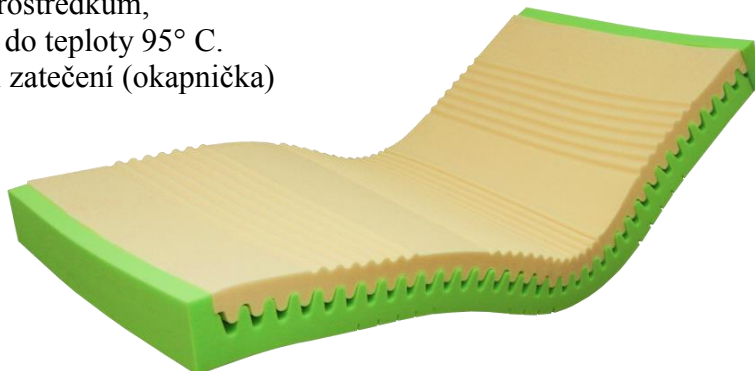

Pol. č. 4: T-6020, lůžko resuscitační, vč. pasivní matrace

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: VISION

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění

Stabilní podvozek - 3 sloupová konstrukce

Plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace – 4x plastový pedál 5. kolečko

Zádový díl, stehenní díl a lýtkový polohovatelné pomocí elektromotoru

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR a laterální náklon - polohování elektrické

Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7 cm

CPR - zádový díl

Nožní pedál - 7 funkcí (zdvih nahoru/dolu, CPR, vyšetřovací poloha, LAT pravý/levý, aktivace)

Podsvětlení podvozku

Zvuková signalizace připojení lůžka k el. síti při odbrzděných kolech

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm pomocí elektromotoru

Laterální rotační terapie

Záložní baterie

2x univerzální držák příslušenství - hlavová část

2x univerzální držák příslušenství - nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z HPL - všechny díly rentgenovatelné (od zádového po pánevní díl ložné plochy)

Možnost použití C-ramene

Držák RTG kazety pod ložnou plochou - zakládání z boku

Centrální sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR poloha, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha, mobilizační poloha) + ovládání vázícího systému

Integrovaný vázící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, ukládání naměřených hodnot do paměti, váživost 300kg

Alarm opuštění lůžka pacientem

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Prodloužení lýtkového dílu

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Postranice plastové dělené (sada 4ks) s dostatečnou ochranou proti samovolnému spuštění

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování (z vnitřní strany pacientský, z vnější strany sesterský)

Integrované ukazatele náklonu v potranicích

Kroucený spirálový napájecí kabel, odolný, v délce 3m od čela lůžka při natažení

Barevný výplň čel a zábran dle vzorníku

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Maximální vnější rozměry lůžka: 222 x 105 cm

Rozměr ložné plochy: 200 x 90 cm

Výška ložné plochy bez matrace: 44 - 84 cm
Výška zábran nad ložnou plochou: 45 cm
Maximální úhel Trendelenburg: 16°
Maximální úhel Antitrendelenburg: 14°
Oboustranný laterální náklon: 30° / 30°
Bezpečné pracovní zatížení lůžka: 300 kg
Hmotnost pacienta: 235kg



Příslušenství k lůžku

Hrazda




Hrazdička s popruhem
- naviják

Závěsný košík



Stolek sklopný na čelo lůžka z HPL

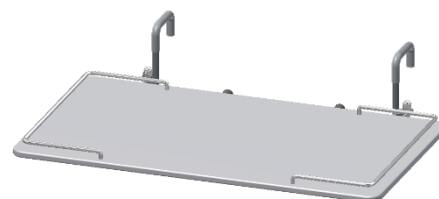

Pasivní antidekubitní matrace Soft Flex:

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II. - III. stupně)

Vyrobena ze studené a viscoelastické paměťové pěny

Studená pěna 40 kg/m³ – spodní vrstva matrace

Visco pěna 50 kg/m³ – vrchní vrstva matrace ve výšce 5cm

Spodní a vrchní vrstva matrace spojena tvarováním, bez lepení

Zónované jádro do sedmi anatomických zón


Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Nosnost 200 kg

Rozměr matrace dle lůžka, 200 x 90cm

Výška matrace 14 cm

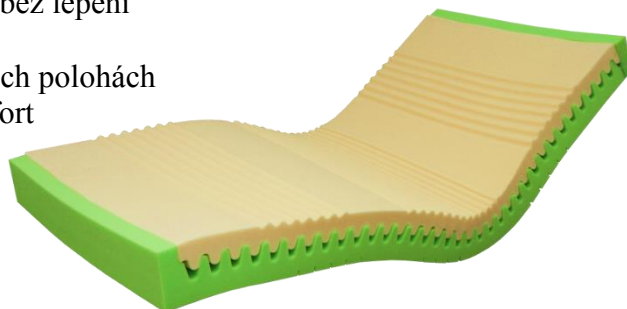

Potah SAFR - snímatelný

Potah pružný ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C.

Potah se zipem s ochranou proti zatečení (okapnička) - ze dvou stran matrace.

Pol. č. 5: T-6201, stolek noční s jídelní deskou pojízdný

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: NS-21-O

Oboustranné kovové provedení

Stolek lakován práškovými vypalovacími barvami

Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice

Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích

Zdvíhací mechanismus jídelní desky integrovaný do korpusu stolku

Jídelní deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného ABS plastu

Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem

Plastová vložka zásuvky z ABS

Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev

Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka

Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

Držák ručníků

Uzamykatelná dvířka

Možnost volby barevného provedení dvířek a šuplíku

Korpus stolku RAL 9016 bílá (jako lůžka)



Š x H x V: 52 x 45 x 91 cm

Rozměr jídelní desky: 55 x 36cm

Zdvih jídelní desky: 80 – 110cm

Nosnost jídelní desky: 10kg (ve středu jídelní desky)

Pol. č. 6: T-6215a, matrace antidekubitní aktivní (JIP/ARO), 6ks

Výrobce: Apex Medical Corp
Typ: Pro-CARE AUTO

Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu, I - IV. stupeň léčby dekubitu
Celová matrace s úchyty na kostru lůžka
Auto adjusting systém – vždy ideální nastavení matrace, bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu pacienta (automatické nastavení tlaku)
Protiskluzová úprava
Nastavitelný komfort pacienta
Potah snímatelný na zip
20 odnímatelných cel
Statický a dynamický režim
Funkce maximálního ztuhnutí matrace
CPR ventil
Transportní mód
Světelná kontrolka tlaku a servisu
Akustický alarm výpadku proudu
Funkce posazení pacienta
Zámek kompresoru matrace
Nosnost matrace 250kg
Rozměry: 200 x 90 x 20,3 cm



Pol. č. 7: T-6215a, matrace antidekubitní aktivní (ortopedie), 4ks

Výrobce: Apex Medical Corp
Typ: Pro-CARE AUTO

Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu, I - IV. stupeň léčby dekubitu
Celová matrace s úchyty na kostru lůžka
Auto adjusting systém – vždy ideální nastavení matrace, bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu pacienta (automatické nastavení tlaku)
Protiskluzová úprava
Nastavitelný komfort pacienta
Potah snímatelný na zip
20 odnímatelných cel
Statický a dynamický režim
Funkce maximálního ztuhnutí matrace
CPR ventil
Transportní mód
Světelná kontrolka tlaku a servisu
Akustický alarm výpadku proudu
Funkce posazení pacienta
Zámek kompresoru matrace
Nosnost matrace 250kg
Rozměry: 200 x 90 x 20,3 cm



Příloha č. 2: Jednotkové ceny pozáručního servisu

Název zdravotnického prostředku nebo laboratorní techniky: Lůžko standardní
 Model: PLE-N85-T, GENE0

Ceny za servisní práce v pozáruční době

Servisní služba	Četnost	Kč bez DPH	hodnota DPH v Kč	Celkem Kč vč. DPH
Roční náklady na pravidelnou bezpečnostní technickou kontrolu za předmět plnění (včetně materiálu a dopravy)	<i>1x za rok, dle doporučení výrobce</i>	500,-	105,-	605,-
Cena hodiny servisní práce (sazba za 1 hodinu práce pracovníka) *pokud bude práce fakturována výkonovým ceníkem, bude tento ceník přílohou smlouvy	<i>uvede poskytovatel cenu za hodinu</i>	380,- Kč	79,80,-	459,80,-
Cena za dopravu do sídla objednatele a zpět, včetně promeškaného času (cena jedné dopravy od poskytovatele do sídla objednatele a zpět v případě požadovaného servisu nebo pozáruční opravy)	<i>uvede poskytovatel cenu za 1 km.</i>	4,90,- Kč	1,03,-	5,93,-

Název zdravotnického prostředku nebo laboratorní techniky: Lůžko pro JIP a ARO
Model: VISION

Ceny za servisní práce v pozáruční době

Servisní služba	Četnost	Kč bez DPH	hodnota DPH v Kč	Celkem Kč vč. DPH
Roční náklady na pravidelnou bezpečnostní technickou kontrolu za předmět plnění (včetně materiálu a dopravy)	<i>1x za rok, dle doporučení výrobce</i>	3.000,-	630,-	3.630,-
Cena hodiny servisní práce (sazba za 1 hodinu práce pracovníka) <i>*pokud bude práce fakturována výkonovým ceníkem, bude tento ceník přílohou smlouvy</i>	<i>uvede poskytovatel cenu za hodinu</i>	380,- Kč	79,80,-	459,80,-
Cena za dopravu do sídla objednatele a zpět, včetně promeškaného času (cena jedné dopravy od poskytovatele do sídla objednatele a zpět v případě požadovaného servisu nebo pozáruční opravy)	<i>uvede poskytovatel cenu za 1 km.</i>	4,90,- Kč	1,03,-	5,93,-

Název zdravotnického prostředku nebo laboratorní techniky: aktivní antidekubitní matrace
Model: Pro - care Auto

Ceny za servisní práce v pozáruční době

Servisní služba	Četnost	Kč bez DPH	hodnota DPH v Kč	Celkem Kč vč. DPH
Roční náklady na pravidelnou bezpečnostní technickou kontrolu za předmět plnění (včetně materiálu a dopravy)	<i>1x za rok, dle doporučení výrobce</i>	500,-	105,-	605,-
Cena hodiny servisní práce (sazba za 1 hodinu práce pracovníka) <i>*pokud bude práce fakturována výkonovým ceníkem, bude tento ceník přílohou smlouvy</i>	<i>uvede poskytovatel cenu za hodinu</i>	380,- Kč	79,80,-	459,80,-
Cena za dopravu do sídla objednatele a zpět, včetně promeškaného času (cena jedné dopravy od poskytovatele do sídla objednatele a zpět v případě požadovaného servisu nebo pozáruční opravy)	<i>uvede poskytovatel cenu za 1 km.</i>	4,90,- Kč	1,03,-	5,93,-



Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 7721126412

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro
pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojistník, pojištěný: **PROMA REHA, s.r.o.**
IČO: **63219107**
Sídlo: **Česká Skalice, Riegrova 342, PSČ 522 03, Česká republika**
Pojištěná nebezpečí: **Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**
Limit pojistného plnění: **50.000.000,- Kč**
Územní platnost pojištění: **Celý svět vyjma USA, Kanady a Austrálie**
Počátek pojištění: **24. 10. 2019** Konec pojištění: **23. 10. 2022**

Přesný rozsah pojištění (spoluúčasti, sublimity pojistného plnění, podmínky pojištění apod.) je uveden v pojistné smlouvě č. 7721126412.

Toto potvrzení nijak nemění ani nerozšiřuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7721126412.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojištěného.

V Praze dne 12. 11. 2019

Za pojistitele:


Ing. Dana Látalová
Úsek pojištění hospodářských rizik


Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Generální ředitelství
Pobřeží 665/21
126 00 Praha 2
ČZ


Mgr. Josef Svojsík
Úsek pojištění hospodářských rizik

Příloha č. 4: Doklad osvědčující způsobilost k servisu zdravotnických prostředků



STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV	Šrobárova 48 100 41 Praha 10	Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377	E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz
ADRESÁT PROMA REHA, s.r.o. Ing. Michal Janecký		ADRESA Riegrova 342 Česká Skalice-Česká Skalice 552 03	

VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. b) a písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), eviduje v Registru zdravotnických prostředků ke dni 29.01.2020 následující údaje:

Registrační číslo	003623
IČ	63219107
Název	PROMA REHA, s.r.o.
Sídlo	Riegrova 342
Kontaktní osoba	Ing. Michal Janecký , qm@promareha.cz, +420775776056

Seznam činností:

- výrobce obecných zdravotnických prostředků – sériově vyráběných
 - Zdravotnické prostředky:
 - 00004271, PLE pečovatelské lůžko
 - 00004298, Hrazda
 - 00004300, PLN nemocniční lůžko
 - 00004319, INVENT s váhou
 - 00004327, Standardní pasivní matrace LUX S
 - 00004335, VISION s váhou
 - 00004343, Hrazdička plastová včetně popruhu
 - 00004351, PLN pečovatelské lůžko
 - 00004378, Standardní pasivní matrace SENDVIČ
 - 00004386, Elektrické lůžko - PLX
 - 00004394, Infúzní stojan nasazovací do držáku hrazdy
 - 00007130, ABE nemocniční lůžko
 - 00007157, Elektrické lůžko - PLS
 - 00007165, PLX
 - 00007173, Elektrické polohovací lůžko TRITON
 - 00007181, Elektrické polohovací lůžko TRITON PLUS
 - 00007229, Elektrické polohovací lůžko CALYPSO STYLE
 - 00007237, Elektrické polohovací lůžko CALYPSO CLASSIC
 - 00007245, Elektrické polohovací lůžko APOLLO 3C
 - 00007253, APOLLO 2C nemocniční

- 00007261, HESTIA 3C s váhou
- 00007288, HESTIA 2C s váhou
- 00007296, Elektrické polohovací lůžko EXCELLENT ICU
- 00007309, Elektrické polohovací lůžko EXCELLENT 2C
- 00007317, PLE nemocniční lůžko
- 00007325, Elektrické polohovací lůžko PLA
- 00008651, PLEX "EXCELLENT" nemocniční
- 00008678, Elektrické lůžko - PLA
- 00008686, ABE pečovatelské lůžko
- 00008694, Elektrické polohovací lůžko PLS
- 00008707, PLH pečovatelské lůžko
- 00008715, PLH nemocniční lůžko
- 00008723, PLL pečovatelské lůžko
- 00008731, PLL nemocniční lůžko
- 00008758, PLB pečovatelské lůžko
- 00008766, PLB nemocniční lůžko
- 00008774, ABL
- 00008782, ABB
- 00008790, Standardní pasivní matrace LUX N
- 00008803, MONOBLOK
- 00008811, Brigita
- 00008838, Standardní pasivní matrace Latex
- 00008846, Standardní pasivní matrace Extra
- 00008854, Standardní pasivní matrace Elastic
- 00008862, Standardní pasivní matrace Eucatherm
- 00008870, Matrace Comfort
- 00008889, Standardní pasivní matrace Hospital
- 00008897, Standardní pasivní matrace Flex
- 00132345, PREMIO
- 00094609, VISION
- 00094617, TITAN
- 00184743, VISCO LUX
- 00184145, SENDVIČ
- 00184495, LUX N
- 00184663, FLEX
- 00184508, LUX P
- 00184516, LUX S
- 00184671, SOFT FLEX
- 00184604, EXTRA
- 00184567, COMFORT
- 00184719, Pasivní matrace TITAN
- 00187784, Polohovací pomůcka
- 00149788, PRIMO nemocniční lůžko
- 00149809, PRIMO pečovatelské lůžko
- 00123879, GENE0
- 00123887, GRANO
- 00241445, Lehátko (vozík) transportní s odnímatelnými nosítky
- 00241453, Lehátko (vozík) transportní s koženkovou ložnou plochou
- 00241189, Elektrické sprchovací lehátko LS
- 00247791, Infúzní stojan pojízdný

- 00247804, Infúzní držák závěsný na hrazdu lůžka
- 00243352, Lehátko transportní URGENT
- 00491479, Hydraulické sprchovací lehátko LS
- 00008918, Standardní pasivní matrace Soft Flex
- 00008926, Standardní pasivní matrace Top Flex
- 00008934, Standardní pasivní matrace Visco LUX
- 00008942, Standardní pasivní matrace Visco LUX ERGO
- 00008950, BUDDY
- 00008969, Dětská polohovací postýlka BUDDY M-T
- 00008977, Dětská polohovací postýlka BUDDY L-0
- 00008985, Dětská polohovací postýlka BUDDY M-0
- 00008993, DPL
- 00009005, Dětská polohovací postýlka DPL-55-T
- 00009013, Dětská polohovací postýlka DPL-70-0
- 00009021, Dětská polohovací postýlka DPL-55-0
- 00009048, KP-50
- 00009056, NP-60
- 00009064, BABY (NP-50)
- 00009072, KBLW
- 00009080, KBL
- 00009099, KBL
- 00009101, KB
- 00010428, PLUTO
- 00010436, ELEVA STYLE
- 00010444, Mechanické vyšetřovací lehátko ELEVA M
- 00010452, Hydraulické vyšetřovací lehátko ELEVA H
- 00010460, Dětské ocelové chodítko U-2 d
- 00010479, ELEVA
- 00010487, Vyšetřovací lehátko - LUX
- 00010495, Chodítko U-1
- 00010508, CLASSIC
- 00010516, Madlo úhlové s více zalomeními
- 00010524, Madlo úhlové se dvěma zalomeními
- 00010532, Madlo úhlové s jedním zalomením
- 00010540, Madlo D-3
- 00010559, Madlo rohové
- 00010567, Madlo pevné krakorcové DS-1
- 00010575, Ocelové chodítko U-2A
- 00010583, Madlo sklápňné na WC DS-1
- 00010591, Chodítko U-2
- 00010604, Madlo univerzální D-
- 00010612, Chodítko ZPT-3211
- 00010620, Dětské ocelové chodítko U-2A d
- 00010639, Chodítko ZPT-3521
- 00010647, Ocelové chodítko s výškově nastavitelnou podpěrnou deskou ve tvaru "U" U-2B
- 00010655, Skládací ocelové chodítko U-3
- 00010663, Dětské ocelové chodítko s výškově nastavitelnou podpěrnou deskou ve tvaru "U" U-2B d
- 00010671, Ocelové chodítko U-2B XXL

- 00094588, INVENT
- 00026454, Infúzní stojan teleskopický
- 00134770, HESTIA 2C
- 00226560, Chodítko U-2A
- 00226579, Chodítko U-2B
- 00226587, Chodítko U-2B XXL
- 00134789, HESTIA 3C
- 00232127, PLEX "EXCELLENT" pečovatelské
- 00232290, APOLLO 2C pečovatelské
- 00081621, TITAN s váhou
- distributor obecných zdravotnických prostředků
 - Zdravotnické prostředky:
 - 00654258, DOMUS 3
 - 00654215, DOMUS 1
 - 00655525, DOMUS AUTO
 - 00655357, DOMUS 4
 - 00654207, DOMUS 2
 - 00743445, Pro-Care Auto
 - 00743437, Pro-Care 4
 - 00743429, Pro-Care 3
- osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků
 Výrobce: 003623 - PROMA REHA, s.r.o.
 Výrobce: Apex Medical Corp.

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie autorizace od výrobce pro osobu, která doklad o školení odborné údržby vydala	Certificate - Trainer of service ingeneers CermakS	
Kopie dokladu o školení odborné údržby	Certifikat AST pro APEX - všichni PR ZPTech_podpis ŠČ	