
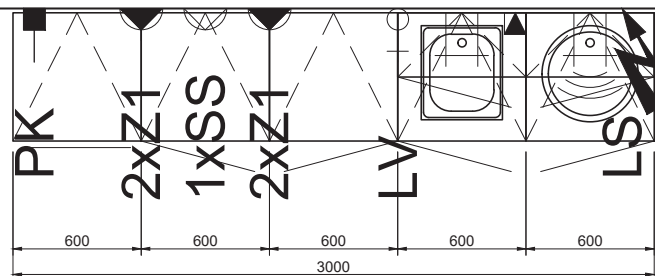


# L126: Pracovní linka dl. 3000mm

POHLED M1:25

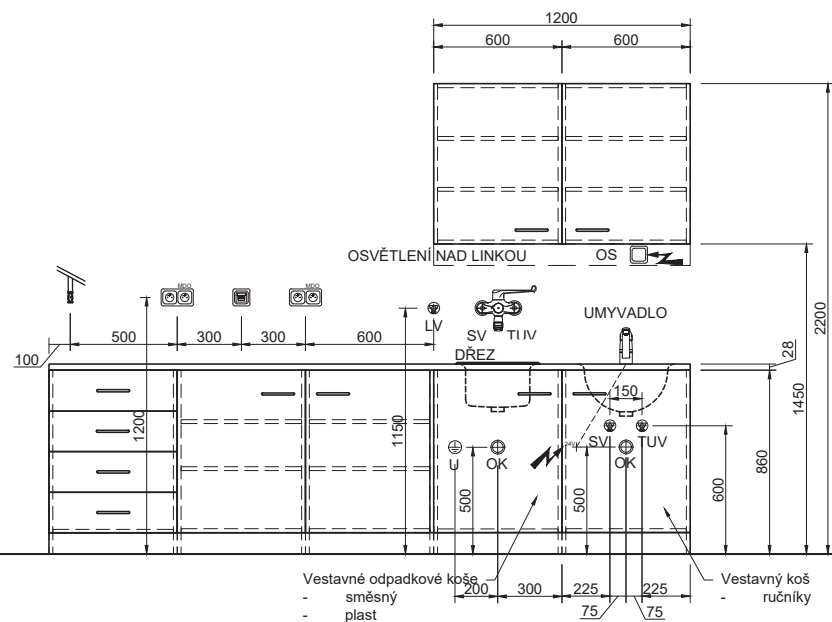

TUV  
SV  
OK  
24V  
TUV  
SV  
OK

PŮDORYS M1:25

## LEGENDA:

PŮDORYS POHLED



TUV - Teplá užitková voda  
SV - Studená voda  
DV - Demineralizovaná voda  
OK - Odpad  
MP - Technické a medicínální plyny  
PK - Zemní plyn

VZT - Ventilace

HV - Hlavní vypínač

EE - Pevný přívod elektrické energie  
24V - Elektrický přívod 24V DC  
OS - Vypínač osvětlení  
230V - Elektrická zásuvka 230V  
400V - Elektrická zásuvka 400V  
SS - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě  
AV - Zásuvka TV / R / SAT  
U - Uzemňovací svorka  
PA - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů  
MT - Monitorování teploty

## POZNÁMKA:

KORPUSY SKŘÍNĚK: viz. specifikace

PRACOVNÍ LINKA: viz. specifikace

DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK: viz. specifikace

Pro instalaci vestavných / podstavných zařízení dodržovat pokyny konkrétního dodavatele / výrobce. Nutno dodržet minimální světelné rozměry nik pro zařízení (připojení na rozvody, odvětrání, atd.) !!!

Všechny rozměry je potřeba průběžně ověřovat na stavbě, v případě nesouladu projektové dokumentace s reálným stavem nebo nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.

Výkres slouží pro zhotovitele nábytkových prvků jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace. Tato bude v předstihu předložena investorovi, technickému a autorskému dozoru.