



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA č. 75/130/2023

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

F medical s.r.o.

se sídlem: Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové

IČ: 02464454

DIČ: CZ02464454

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33057

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 70022002/2700

zastoupená: Ing. Jasminem Draganovičem

(dále jen „**prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202 pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.



Preambule

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016262 s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Náchod“ (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, „Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“ (dále jen „Dotační program“).
2. Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Dotační pravidla“).
3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží.Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.
4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na části, název části č. 5: **1 ks skiagrafického RTG systému** veřejné zakázky: „Pořízení RTG přístrojů pro ONN II.“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s vlastními Technickými podmínkami zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a Technickými podmínkami zadavatele, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.



I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k:

1 ks skiografického RTG systému VISION C,

(dále jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Technické podmínky zboží prodávajícího) a v příloze č. 2 této smlouvy (Technické podmínky požadované kupujícím). Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2. 2. této smlouvy.

- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.3. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost dle čl. V této smlouvy. Po dobu záruky bude rovněž poskytován servis zboží v souladu s čl. V, odst. 5.1 této smlouvy. Celková doba plného servisního pokrytí od okamžiku instalace a převzetí zboží dle této smlouvy tedy činí 24 měsíců záručního servisu.
- 1.5. Účel užití zboží kupujícím bude **diagnostika zdravotního stavu pacientů**.

II.

Doba a místo dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **do 20 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy** na místo dodání:
- Radiodiagnostické oddělení (urgentní příjem), Oblastní nemocnice Náchod, IČ: 26000202, sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod.
- 2.2 O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.



Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Ing. Radomír Pospíšil, tel.: +420 603 222 396, email: radomir.pospisil@fmedical.cz.

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:
 - Lucie Říhová, tel: 720 948 972, email: rihova.lucie@nemocnicenachod.cz; nebo
 - Ing. Tomáš Bernard, tel: 608 317 759, email: bernard.tomas@nemocnicenachod.cz, nebo
 - Bc. Michaela Kapustová, tel.: 727 986 414, email: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz.
- pověřená osoba z příslušného oddělení, kam se bude / - ou přístroj / -e dodávat: Štěpán Wágner, email: wagner.stepan@nemocnicenachod.cz, tel.: 491 601 380.

2.3 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrevize, výchozí zkoušky dlouhodobé stability, provedení přijímací zkoušky ionizujícího záření ve stanoveném rozsahu, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky, apod.) dle platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů, dodávka musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky;
- c) instruktáž zdravotnického personálu kupujícího (dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotnických prostředcích), příp. dle § 61 z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotnických prostředcích in vitro)) včetně vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, přičemž osoba provádějící instruktáž je povinna zároveň předložit doklad vydaný výrobcem zboží prokazující její oprávnění k provádění takového instruktáže;
- d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích, příp. zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;
- e) předávací protokol, záruční a dodací list, protokol o přijímací zkoušce zdroje ionizujícího záření;



- f) je-li součástí dodávky výpočetní technika, musí být na faktuře (dodacím listu) uvedeny verze dodaných operačních systémů. Součástí dodávky musí být licenční ujednání pro veškerý dodaný SW, který není freeware;
- g) poskytování komplexního záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních dílů po dobu 24 měsíců;
- h) garance zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje;
- i) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran;
- j) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle z. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, či z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v z. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, či z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční doby;
- k) likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno;
- l) protokol o ověření připojení a správné funkčnosti připojení zboží k PACS, NIS, RIS minimálně 3 pracovní dny před uvedením zboží do provozu, zajištění kompatibility zboží s informačním systémem používaným kupujícím pro sběr dat nutných pro stanovení diagnostických referenčních úrovní (DRÚ);
- m) poskytování pravidelných bezpečnostně technických kontrol i po uplynutí záruční doby za podmínek popsanych v příloze č. 5 této smlouvy – Servisní smlouva.

(vše dále též jako „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v



souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.4 Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.5 Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balicí materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.
- 2.7 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena za 1 ks zboží je 3 819 700 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 802 137 Kč, tj. 4 621 837 Kč včetně DPH.
- 3.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kupujícího, protokolární předání zboží kupujícímu a dalších náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží kupujícímu a plněním povinností prodávajícího dle této smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu.
- 3.3. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.



3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:

- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na tuto smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh,
- číslo Projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016262 s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Náchod“, atd.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. Faktura bude kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz.

3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře. Lhůta splatnosti faktury je sjednána z důvodu nastavených vnitřních schvalovacích pravidel.

3.8. Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).

3.9 V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této



smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.

- 3.10. Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3. 8. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost, Odpovědnost za vady a Servis

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **24 měsíců**.

Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců (záruka za jakost) zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití ke smluvenému (jinak obvyklému) účelu.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než za 24 měsíců ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a



odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí. Proávající je dále povinen provádět během záruční doby bezúplatně a bez vyzvání:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro,
- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 67 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro,
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona,

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží od požadovaných technických podmínek, nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Proávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčností, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

- 5.3. Pro součásti zboží, které mají vlastní záruční listy je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.4. Proávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 46 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 66 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
- 5.5. Reklamace zboží a kontakty prodávajícího:



5.5.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamáce“). I reklamáce učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na jednom ks zboží nejméně podruhé nebo vznikne-li na jednom ks zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového ks zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

5.5.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat požadavky na reklamaci a servis: servisní informační systém na tel. č.: +420 498 019 588, e-mail: servis@fmedical.cz. Za okamžik uplatnění reklamáce se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.

5.5.3. V případě uplatnění reklamáce zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 48 hodin od uplatnění reklamáce vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech.

5.6. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající vadu odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika na opravu dle předchozího odstavce 5. 5. 3. v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě kupujícího nebo prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do **120** hodin počítaných od nástupu servisního technika na opravu.

5.7. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.



- 5.8. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží nejpozději však do 6 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.

Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.9. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.10. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.11. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.12. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména § 2 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.13. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.



VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši celkové kupní ceny včetně DPH na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
Potvrzení o pojištění bude tvořit přílohu kupní smlouvy.
- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).



VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě změny poddodavatele bez předchozího souhlasu kupujícího zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 7.3. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5. 5. 3., 5. 7. a 5. 8. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5. 6. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.
- 7.5. Prodávající je povinen v případě nedodržení podmínek pojištění dle odst. 6. 6. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení, a to do doby než budou podmínky pojištění prodávajícím obnoveny v souladu s touto smlouvou.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.7. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.8. Kupující se zavazuje, pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Další ujednání

- 8.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.



- 8.2. Prodávající je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude ve vztahu k zaměstnancům zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů, disponovat veškerými potřebnými oprávněními apod. Prodávající se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Kupujícího předložit či zajistit předložení příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Vše v rámci tohoto odstavce uvedené platí i pro případné poddodavatele.
- 8.3. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí. Prodávající je dále povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 8.4. Prodávající se dále zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.
- 8.5. Nedílnou součástí této smlouvy je Servisní smlouva, která tvoří přílohu č. 5 a upravuje podmínky provádění komplexního pozáručního servisu prodávajícím pro kupujícího ve vztahu k předmětu koupě, přičemž platnost této smlouvy je podmíněna paralelním uzavřením Servisní smlouvy. Pokud k uzavření Servisní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím z jakéhokoli důvodu nedojde, je tato smlouva bez dalšího neplatná.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.5.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;



- b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
- c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 7. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
- d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
- e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
- f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.

9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.

9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou za předpokladu, že byla splněna podmínka stanovená v čl. VIII odst. 8.5 této smlouvy.
- 10.2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že



vyklučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.

- 10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 10.10. Tato smlouva je vyhotovena v 1 (jednom) vyhotovení formou elektronického originálu opatřeného platnými elektronickými podpisy smluvních stran.



10.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínky a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.

10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky zboží prodávajícího;

Příloha č. 2 – Technické podmínky zboží požadované kupujícím;

Příloha č. 3 – Závazný vzor Předávacího protokolu;

Příloha č. 4 - Potvrzení o pojištění odpovědnosti;

Příloha č. 5 – Servisní smlouva;

Příloha č. 6 - Pravidla pro zřízení a používání vzdáleného přístupu do počítačové sítě kupujícího;

Příloha č. 7 - Pravidla součinnosti s úsekem IT oddělení kupujícího.

Prodávající:

V Hradci Králové dne

Ing. Jasmin Draganovič

jednatel

Kupující:

V Náchodě dne

RNDr. Bc. Jan Mach

předseda správní rady

3. ***VISION C – STACIONÁRNÍ RTG PŘÍSTROJ S PŘÍMOU DIGITALIZACÍ***

VYSOCE PRODUKTIVNÍ PLNĚ AUTOMATICKÝ SYSTÉM PŘÍMÉ
RADIOGRAFIE POSKYTUJÍCÍ VYNIKAJÍCÍ KVALITU OBRAZU



Vision C je **plně digitální RTG systém** s rentgenkou na stropním závěsu, elevačním vyšetřovacím stolem a sklopným vertigraferem, ke kterému dále patří tři digitální detektory a akviziční stanice Avanse DR plně integrovaná s generátorem, zajišťující automatické zpracování snímků.

Vision C je **plně automatické řešení**, ideální pro provozy s vysokým počtem vyšetření a požadavkem na zvýšení celkové propustnosti pracoviště. Umožňuje provádět veškeré skiagrafické techniky, vyhoví tudíž i těm nejnáročnějším požadavkům.

Velkou výhodou systému je využití **vysoce kvalitních digitálních detektorů** se scintilátory CsI a vysokým DQE, které spolu s **propracovaným post-processingem snímků** zajišťují vynikající kvalitu snímků, čímž zvyšují diagnostickou efektivitu a umožňují snížit dávku na pacienta.

- Moderní, inovativní a robustní konstrukce
- Plně automatický systém vč. funkcí **auto-tracking** (automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče pro stůl i vertigraf.) a **auto-positioning** (automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do požadované pozice pro předdefinované typy vyšetření).
- Maximální pohodlí pro pacienta i obsluhu
- Intuitivní rozhraní akviziční stanice Avanse DR, velmi snadná obsluha celého systému s ovládáním v českém jazyce
- **DICOM** připojitelnost do PACS, HIS/RIS

3.1 Motorizovaný stropní závěs rentgenky

Vision C disponuje stropním teleskopickým závěsem rentgenky s **plnou motorizací** (horizontální i vertikální) a velmi snadnou obsluhou.

Všechny pohyby disponují **elektromagnetickými brzdami**, které lze všechny uvolnit pro umožnění manuální manipulace. Bezpečnost pro pacienta i celý systém zajišťuje **antikolizní systém**.



Délka podélných kolejnic / rozsah pojezdu	425 cm / 365 cm
Délka příčných kolejnic / rozsah pojezdu	375 cm / 315 cm
Vertikální pohyb	180 cm
Rotace rentgenky – vertikální osa	±180°
Rotace rentgenky – horizontální osa	±150°
Možnost snímání mimo stůl či vertigraf	
Dotykový 10,1“ LCD panel – zobrazuje	Expoziční údaje (vč. nastavení)
	Zvolený orgánový program
	SID, úhel náklonu rentgenky
	Kolimace
	Zvolená filtrace
	Identifikační údaje pacienta
	Náhled na snímek (fast Preview)
Pohyby plně motorizované, možnost manuální manipulace	
Elektromagnetické brzdy všech pohybů	
Antikolizní systém (bez nutnosti přítomnosti obsluhy v ovladovně)	
Zabezpečovací systém v případě poruchy lana zabrání pádu rentgenky	
Výška stropu místnosti 278 cm	

3.2 Elevační vyšetřovací stůl

Stacionární stůl se čtyřcestnou plovoucí deskou stolu a elevačním pohybem se pohodlně ovládá pomocí pedálových spínačů na straně stolu.

Ergonomický návrh spolu s velmi pevnou a solidní konstrukcí o nosnosti 300 kg zajišťují pohodlí pro pacienta i obsluhu.



Rozměry desky stolu	240 × 80,6 cm
Nosnost desky stolu ve všech pozicích	300 kg
Podélný posun desky stolu	101 cm (±50,5 cm)
Příčný posun desky stolu	26 cm (±13 cm)
Vertikální pojezd	33,7 cm (51,5 – 85,2 cm)
Podélný pohyb bucky	50 cm
Vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou	10:1, SID 110 cm
Expoziční automatika – AEC	5-doménový senzor
Elektromagnetické brzdy	
Držák detektoru/kazety pro laterální expozice	

3.3 Sklopný vertigra

Elevační sklopný vertigra s motorizovanými pohyby a elektromagnetickými brzdami umožňuje pohodlné snímkování stojících i invalidních pacientů. Optimalizované vyvážení pro snadné polohování. Pohodlí pro pacienta zajišťují madla.

Motorizované sklápění	-20° až +90°
Motorizovaný vertikální pojezd	152 cm
Min./max. výška středu detektoru	28 – 180 cm
„Smart“ bucky jednotka pro detektor	43×43 cm s automatickým rozpoznáváním typu RTG mřížky
Vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou	10:1, SID 110 cm a 180 cm
Expoziční automatika – AEC	5-doménový senzor
Madla pro úchop pacienta	PA i LAT
Elektromagnetické brzdy	



3.4 Vysokofrekvenční generátor 80 kW

Technologie vysokofrekvenčních RTG generátorů řízených mikroprocesory zvyšuje obrazovou kvalitu a snižuje dávku na pacienta.

Maximální výkon	80 kW
Rozsah kV	40 – 150 kV (krok 1 kV)
Rozsah mA	10 – 1 000 mA
Rozsah mAs	0,1 – 1 000 mAs
Rozsah expozičních časů	1 ms – 10 s
APR – anatomické programy	Více než 500 předvoleb
Expoziční automatika – AEC	5-doménový senzor pro stůl i vertigra
Automatické i ruční řízení parametrů expozice	
Mikroprocesorové řízení s autodiagnostikou a chybovými kódy	
Automatická kompenzace kolísání sítě ±10 %	
Ochrana rentgenky proti přetížení	
Počítadlo expozic rentgenky	
Ruční ovladač pro přípravu a expozici	
Světelná a akustická indikace probíhající expozice	

3.5 Rentgenka 800 kHU Siemens SV 150/40/80HC-100LF

Kvalitní a výkonná rentgenka s rotační anodou a dvěma ohnisky.

Velikosti ohnisek	0,6 / 1,0 mm
Maximální napětí	150 kV
Úhel anody	12°
Tepelná kapacita anody	800 kHU
Celková tepelná kapacita zářiče	2 484 kHU

3.6 Automatický kolimátor vč. DAP

Automatická primární clona umožňující jak motorické, tak manuální nastavení. Podporuje automatickou kolimaci dle zvoleného orgánového programu (**APR**). Obsahuje kolejničky pro příslušenství (kužele, filtry apod.)

Integrovaný měřič plošné dávky – **DAP metr**

Automatická přídavná filtrace	
Rotace	±45°
Světelná indikace	230 lux
Velikost pole	až 48 × 48 cm (pro SID 100 cm)

3.7 Ploché fixní detektory pro přímou digitalizaci 1717 (2 ks)

Digitální detektor **43×43 cm** s kabelovým napájením a komunikací ve **formátu 43×43 cm** s konverzní plochou **CsI**.

Aktivní plocha detektoru	424,8 x 425,4 mm
Konverzní plocha	CsI
Pixel pitch (rozteč bodů)	100 μm
Rychlý náhled na snímek	2 s
Plné rozlišení snímku	3 s
Hloubka rozlišení	16-bit



3.8 Bezdrátový digitální detektor 1417

Digitální přenosný detektor s **Wi-Fi** komunikací ve formátu 35×43 cm.

Aktivní plocha detektoru	350 × 430 cm
Konverzní plocha	CsI
Pixel pitch (rozteč bodů)	100 μm
Rychlý náhled na snímek	2 s
Plné rozlišení snímku	3 s
Hloubka rozlišení	16-bit
Automatická detekce expozice (AED)	
Vnější rozměry	ISO 4090 (384 × 460 × 15 mm)
Hmotnost vč. akumulátoru	3,0 kg
Nosnost plošně/bodově	300 / 150 kg
Součástí dodávky je i nabíječka se dvěma kusy akumulátorů	




3.9 Skládání snímků – Image stitching modul

Volitelný doplněk umožňující **automatický stitching** neboli automatickou tvorbu obrazu celých končetin a páteře pro stůl i vertigrafi s možností manuální korekce. Tato funkce se využívá pro snímání dlouhých anatomických struktur (páteř, dolní končetina). Stitching zachovává plnou kvalitu digitálních snímků.

Software pro automatickou tvorbu snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatiky posuvu RTG zářiče a detektoru spojením jednotlivých snímků do výsledného obrazu.

Modul obsahuje řešení jak SW (doplňková licence), tak i HW (stojan k vertigrafu).

Stitching u vertigrafu	- Skládání ze 2-5 snímků - Pokrytí pacienta až 150 cm
Stojan ze 4 kolečky a RTG kontrastním metrem	- Brzdy kol - Rozměry: 860×950×2 000 mm - Nosnost: 250 kg

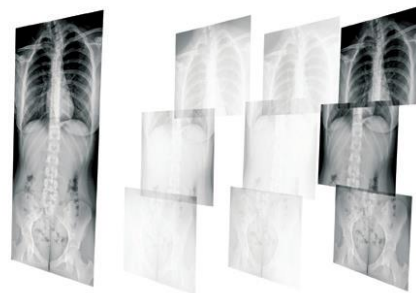

3.10 Akviziční stanice Avanse DR

Akviziční stanice umožňující ovládání všech hlavních funkcí DR systému (nastavení expozičních hodnot, volba typu vyšetření, práce s worklistem apod.) s **intuitivním** grafickým rozhraním kompletně **v českém jazyce**.

Unikátní vysoce propracovaný SW pro zpracování snímků zajišťuje vynikající kvalitu digitálních snímků.



Monitor	LCD monitor 23“ full HD
Jazyk rozhraní	Kompletně v českém jazyce
Platforma	Windows 10
Zrcadlení disků pro vyšší bezpečnost	RAID1
Operační paměť	8GB RAM
Kapacita interní paměti	Až 5 000 snímků průměrné velikosti
Záloha napájení	Externí – UPS
CD/DVD mechanika	Interní
Automatická komunikace s RTG generátorem a třemi detektory	
Podpora formátu DICOM 3.0 :	- Export/Storage
	- Store & Storage Commitment,
	- Modality Worklist (MWL)
	- Print
	- Query/retrieve
	- MPPS
	- Media
	- Dose Report
Možnosti identifikace pacienta:	- DICOM MWL (načtení z RIS/NIS)
	- ruční zadání
	- načtení z vlastního seznamu pacientů
Možnost vyhledávání vyšetření podle:	- načtení ze seznamu historie
	Možnost editace dat přijatých z MWL
	- jména pacienta
	- ID pacienta
	- čísla vyšetření
Rychlý náhled na snímek (Fast Preview)	- data vyšetření
Plné rozlišení snímku	- typu vyšetření
Připojení do NIS/RIS, PACS kupujícího	- 3 s
Možnost exportu snímků:	- 7 s
	Konektivita Ethernet, rychlost 1 Gbps
	- v DICOM formátu na CD/DVD (vč. DICOM prohlížeče)
Možnost nastavit automatické odesílání snímků na předdefinované destinace (PACS, DICOM tiskárna, diagnostická stanice apod.) po expozici	
Automatický export snímků do PACS vč. expozičních parametrů (hodnoty v DICOM hlavičce)	
Ovládání nastavení generátoru z akviziční stanice, systémová funkcionality.	
Orgánová automatika. Možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky	
Možnost konfigurace a uložení vlastních anatomických programů	
Spojení demografických dat pacienta a typu vyšetření s DR snímkem je možné před i po expozici	
Možnost zadávat jméno laboranta provádějícího vyšetření	
Automatická detekce a ořez exponované plochy s možností manuální korekce (SW kolimace)	

Automatická detekce clon na snímku

Studie obsahuje: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční parametry (kV, mAs), popisky operátora, ID a jméno pacienta.


Optimalizovaný postprocessing snímku pro jednotlivé anatomické struktury - Pokročilé funkce zpracování obrazu: kontrastně vyvážený obraz v celé ploše, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru

Základní nástroje pro úpravy snímků:

- anotace, libovolné umístění značek L/P a poznámek (volný text)
- otáčení snímku L/P ($\pm 90^\circ$), překlopení snímku (flip), posuv
- změna Window/Level snímku
- výběr anatomického pohledu
- kontrola saturace
- zvětšení a posun snímku (zoom & roaming, reset zoom), lupa
- pravoúhlá kolimace, aktivace/deaktivace kolimace, inverze kolimačních hranic, elektronická kolimace
- filtrace, inverze, ořezávání, zvýraznění hran
- nástroje pro měření
- odmítnutí snímku pro další zpracování (neodešle se do PACS /na tisk)
- uložení upraveného snímku jako nového snímku

Možnost využití DICOM Store s bezztrátovou kompresí

Vzdálený servis (TeamViewer)

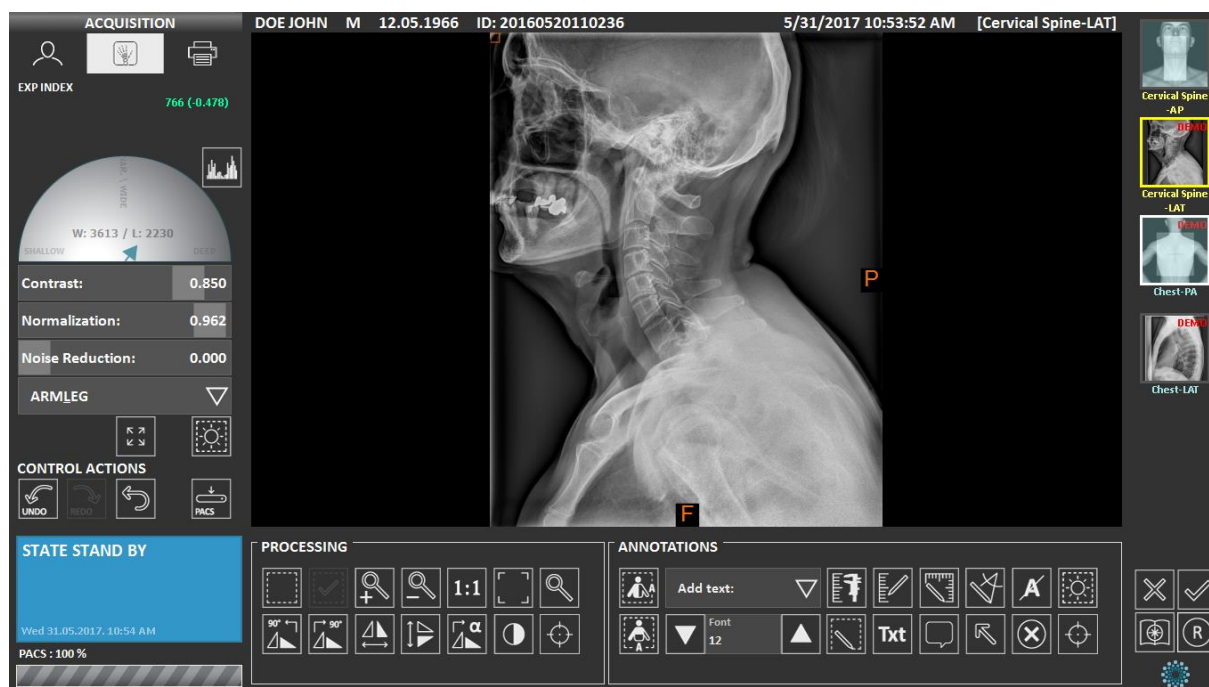



3.11 Příslušenství

- Vysokonapěťové kabely
- Kotevní prvky, rámy, rozvody od rozvaděče, jističe
- Interkom – Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou
- 4 ks ochranných zástěr různých velikostí a 1 ks ochranný límec.
- CD s dokumentací „DICOM Conformance Statement“

Vyplněná příloha č. 2_5 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: 1 ks skiagrafického RTG systému

Část veřejné zakázky: 5

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

číslo	specifikace	požadavky	Splněno parametrem nebo ANO / NE
<u>Obecné požadavky</u>			
Stacionární plně digitální skiagrafické RTG zařízení se stropním závěsem pro snímkování ležících, sedících a stojících pacientů, včetně akviziční stanice – 1 ks			
<u>Stropní závěs</u>			
1.1	Antikolizní systém – bez nutnosti přítomnosti obsluhy v ovladovně.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.2	Stropní teleskopický závěs s RTG zářičem s plnou motorizací (horizontální a vertikální).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.3	Výška stropu místnosti: 278 cm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	278 cm
1.4	Podélný pohyb (v ose stolu) po kolejnici dlouhé 420 cm a příčný pohyb (k ose stolu) po kolejnici dlouhé 360 cm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	kolejnice podélná 425 cm a příčná kolejnice 375 cm
1.5	Vertikální pohyb min. v rozsahu 160 cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	180 cm
1.6	Automatická tvorba obrazu celých končetin a páteře (AutoStitching) pro stůl i vertigrať min. ze tří snímků.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.7	Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (AutoTracking) pro stůl i vertigrať.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.8	Automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do požadované pozice pro předdefinované typy vyšetření (Autopozice).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.9	Snímkování i mimo stůl či vertigrať.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Stacionární vyšetřovací stůl</u>			

1.10	Bucky stůl s plochým detektorem, vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 110 cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	10:1, 215 LPI, SID 110 cm
1.11	Úložná deska plovoucí ve 4 směrech, umožňující celotělové vyšetření.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.12	Podélný pohyb stolu min. +/- 48cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	+/- 50,5 cm
1.13	Příčný pohyb stolu min. +/- 12cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	+/- 13 cm
1.4	Motorizované nastavení výšky desky min. v rozsahu 55 – 85 cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	51,5 – 85,2 cm
1.15	Nosnost stolu min. 300 kg ve středové poloze stolu a 230 kg v každé poloze stolu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	300 kg v každé poloze stolu
1.16	Automatické řízení expozice (AEC).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.17	Elektromagnetické brzdy.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Vertigrafi</u>			
1.18	Motorický výškový posun.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.19	Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 33,5 cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	28 cm
1.20	Nejdelší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 170cm.	Požadavek je absolutní (musí být splněn)	180 cm
1.21	Sklopný min. v rozsahu -20° až +90°.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	-20° až +90°
1.22	Držáky pro úchop pacienta.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.23	Elektromagnetické brzdy.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.24	Vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 110 cm a 180cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	SID 110 cm a 180cm
1.25	Automatické řízení expozice (AEC).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>RTG generátor</u>			
1.26	Výkon RTG generátoru min. 65 kW	Hodnocený parametr (musí být splněn)	Uved'te hodnotu* 80 kW
1.27	Minimální rozsah kV min. 40 – 150 kV.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	40 – 150 kV
1.28	Minimální rozsah mAs min. 0,5 – 500 mAs.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	0,1 – 1 000 mAs
1.29	Minimální rozsah mA: min. 10 – 600 mA.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	10 – 1 000 mA
1.30	Nejkratší expoziční čas min. 1 až 4000 msec.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	1 až 10 000 msec

1.31	Automatické a ruční řízení parametrů expozice.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>RTG zářič</u>			
1.32	S rotační anodou a dvěma ohnisky max. 0,6 mm / 1,2 mm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	0,6 mm / 1,0 mm
1.33	Tepelná kapacita anody min. 300 kHU	Hodnocený parametr (musí být splněn)	Uveďte hodnotu* 800 kHU
1.34	Celková tepelná kapacita min. 2000 kHU.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	2 484 kHU
1.35	Rotace rentgenky min. $\pm 150^\circ$ okolo vertikální osy.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	$\pm 180^\circ$
1.36	Rotace rentgenky min. $\pm 120^\circ$ okolo horizontální osy.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	$\pm 150^\circ$
1.37	Elektromagnetická aretace pohybu rentgenky	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.38	Automatický kolimátor s možností manuálního nastavení	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.39	Automatická přídatná filtrace	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.40	Otáčení kolimátoru $\pm 45^\circ$.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	$\pm 45^\circ$
1.41	Světelný či laserový zaměřovač	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.42	Integrovaný DAP metr	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Ovládání</u>			
1.43	Ovládání základních funkcí z ovladovny i od vyšetřovacího stolu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.44	Barevný dotykový displej o velikosti min. 10" a ovládání na krytu primární clony pro volbu nastavení/zobrazení expozičních parametrů, úhlu náklonu, kolimace, SID, zvoleného orgánového programu, zvolené filtrace apod.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.45	Možnost uvolnění brzd všech pohybů a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Akviziční stanice</u>			
1.46	Ovládání pomocí plnohodnotné klávesnice a myši nebo dotykové obrazovky velikosti min. 21".	Požadavek je absolutní, musí být splněn	23"
1.47	Operační paměť min. 8 GB RAM	Požadavek je absolutní, musí být splněn	8 GB RAM
1.48	CD/DVD mechanika.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.49	Napájecí záložní zdroj UPS.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.50	Automatická komunikace s RTG generátorem a třemi detektory.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

1.51	Možnost manuálního zadávání patientských dat a editace patientských dat přijatých z Worklistu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.52	Možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, orgánová automatika.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.53	Možnost uživatelského přednastavení anatomických programů.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.54	Automatická detekce a ořez exponované oblasti s možností ruční úpravy (SW kolimace).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.55	Studie musí obsahovat: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční parametry (kV, mAs), popisky operátora, ID a jméno pacienta.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.56	Standardní software pro úpravu obrazu (změna jasu a kontrastu, zoom, inverze snímku, posuv, rotace, výřez, výběr anatomického pohledu, měření úhlů a vzdáleností, anotace – popisky, atd.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.57	Ovládání nastavení generátoru z akviziční stanice, systémová funkcionality.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.58	Pokročilé funkce zpracování obrazu: kontrastně vyvážený obraz v celé ploše, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru atd.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.59	Software pro automatickou tvorbu snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatiky posuvu RTG zářiče a detektoru spojením jednotlivých snímků do výsledného obrazu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.60	Náhled snímku na monitoru maximálně do 5 s.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	do 3 s
1.61	Dostupnost plně zpracovaného snímku maximálně do 10 s.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	do 7 s
1.62	Nástroje pro měření.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.63	Rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Print, Dose Report.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.64	Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, rychlost min. 1Gbps.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.65	Automatické odesílání snímků do PACS po expozici.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.66	Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.67	K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Ploché fixní detektory pro přímou digitalizaci pro snímkování na stole (1 ks) a na vertigrafu (1 ks)</u>			
1.68	Velikost aktivní plochy detektoru min. 42x42 cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	424,8 x 425,4 mm
1.69	Typ konverzní vrstvy Csl.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.70	Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 160 µm.	Hodnocený parametr (musí být splněn)	Uveďte hodnotu* 100 µm

1.71	Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 14 bitů.	Hodnocený parametr (musí být splněn)	Uved'te hodnotu* 16 bitů
1.72	Rychlý náhled na snímek max. 3,5 s.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	do 2 s
1.73	Plné rozlišení snímku max. 6 s.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	do 3 s
<u>Plochy bezdrátový (přenosný) detektor pro přímou digitalizaci (1 ks)</u>			
1.75	Velikost detektoru 35x43 cm nebo větší.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	430 x 350 mm
1.76	Typ konverzní vrstvy Csl.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.77	Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 160 µm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	100 µm
1.78	Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 14 bitů.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	16 bitů
1.79	Rychlý náhled na snímek max. 2 s.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	do 2 s
1.80	Plné rozlišení snímku max. 6 s.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	do 3 s
1.81	Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,5 kg.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	3 kg
1.82	Mechanické zatížení vahou pacienta plošně/bodově min. 150kg/100kg.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	300 kg/150 kg
1.83	Automatická detekce expozice (AED).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.84	Náhradní baterie pro detektor a dobíjecí stanice.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Další příslušenství</u>			
1.85	Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou (Interkom).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.86	Stojan pro vyšetření celých končetin a páteře stojícího pacienta.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.87	Držák pro uchycení volného detektoru ke stolu (horizontální projekce).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.88	4ks ochranných zástěr různých velikostí a 1ks ochranný límec.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.89	Kotevní prvky, rámy, rozvody od rozvaděče, jističe.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Ostatní požadavky</u>			
1.90	Životnost přístroje min. 8 let, garance dodávky náhradních dílů min. 10 let	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.91	Možnost dalšího technického zhodnocování přístroje v průběh jeho života (update, upgrade, dovybavení novými technologiemi)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

1.92	Záruční doba min. 2 roky	Požadavek je absolutní, musí být splněn	2 roky
------	--------------------------	---	--------

* Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických podmínek (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK a zkoušky dlouhodobé stability prováděny zdarma;

cena pozáručních BTK v Kč bez DPH za 1 ks zdravotnického přístroje (cena zahrnuje veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, vč. výměny dílů, kontrolu elektrické bezpečnosti, veškeré mzdové a cestovní náklady servisního technika, vystavení protokolů a dokumentace)

	9 600 Kč /ks (tj. 115 200 Kč /6 let)
- frekvence provádění BTK	2× ročně

ceny za servisní práce v pozáruční době:

o hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)	1 710 Kč/hod
o cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km	12 Kč/km

Zadavatel na základě předcházejícího průzkumu trhu stanovil maximální možné ceny za výše uvedené servisní práce v pozáruční době následovně:

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)	max. 1 710,00 Kč/ hod
cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km	max. 12,00 Kč/ km

Výše stanovené ceny doplněné dodavatelem jsou pro vybraného dodavatele závazné, maximální možné a nepřekročitelné po celou dobu plnění na základě Přílohy č. 3_5 - Kupní smlouva včetně jejích příloh (zejména pak po celou dobu plnění na základě Přílohy č. 5 Kupní smlouvy – Servisní smlouva). Překročení výše stanovených maximálních cen za jednotlivé položky je důvodem pro vyloučení takového účastníka ze zadávacího řízení ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ostatní požadavky:

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s technikou útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování služeb v oblasti zdravotnictví (§ 2 písm. i) bod 5. ZKB).

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:										
Zástupci kupujícího:	1. pracovník technického úseku: 2. pověřená osoba zdravotnického oddělení (<i>primář/zástupce primáře</i>):									
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav zboží	obalů	Výsledek montáže, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	školení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího, včetně vystavení protokolu a protokolu opravňujícího provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE	

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

V _____, dne _____

zástupce prodávajícího

(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 1.

(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 2.

(jméno, razítko a podpis)

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Pojištění podnikatele a právnických osob

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4181771744

Pojistník

Název firmy	F medical s.r.o.
Adresa	Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	02464454

Pojištění podnikatele a právnických osob

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištění oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění movitých věcí – Živel

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2018.

Pojištění odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	20 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5000 Kč



Počátek a doba pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 4. 2022

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

PŘÍLOHA Č. 5 KUPNÍ SMLOUVY – SERVISNÍ SMLOUVA

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“):

F medical s.r.o.

se sídlem: Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové

IČ: 02464454

DIČ: CZ02464454

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 33057

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č.ú.: 70022002/2700

zastoupená: Ing. Jasminem Draganovičem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202 pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel a Objednatel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pořízení RTG přístrojů pro ONN II.“ vedené ve u zadavatele pod ev. č. VZ07/5.

čl.I.

Účel smlouvy

1. Objednatel je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „**zákon o ZP**“) a další související platné legislativy.

2. Účelem této smlouvy je zajištění povinností Objednatele dle zákona o ZP a jeho prováděcích předpisů, souvisejících s provozováním a používáním zdravotnického prostředku, a to dodavatelským způsobem.

3. Pro účely této smlouvy je stanoven obsah následujících pojmů takto:

- **zdravotnický prostředek** – nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, určený výrobcem pro použití u člověka; provozování zdravotnického prostředku podléhá zejména zákonu o ZP a jeho prováděcím předpisům (dále jen „**ZP**“);
- **doba odstranění závady** – doba od započetí činnosti směřujících k odstranění závady do obnovení správné funkce ZP u Objednatele;
- **instruktáž obsluhy** – úvodní nebo periodické instruktáže obsluhujícího personálu v souladu s § 41 zákona o ZP s cílem zabezpečení kvalifikovaného a bezchybného používání ZP v souladu s pokyny výrobce;
- **oprava** – soubor úkonů, jimiž se poškozený ZP vrátí do původního nebo provozuschopného stavu, přičemž nedojde ke změně technických parametrů nebo určeného účelu (§ 46 zákona o ZP);
- **PBTK** – pravidelné (pozáruční) bezpečnostně-technické kontroly a další úkony k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku dle definice v § 45 zákona o ZP prováděné v souladu s předpisem výrobce ZP
 - periodické ověřování parametrů a funkčnosti ZP, vykonání předepsaných funkčních kontrol ZP, kontrola funkce, kontrola přesnosti, vyčištění nepřístupných částí, kontrola chybových událostí a dalších činností v návaznosti na předpis výrobce nebo technickou dokumentaci (dále jen „**PKV**“);
 - periodické ověřování metrologického charakteru (metrologické ověření, kalibrace, atd.) v případě ZP s měřicí funkcí, na něž se vztahují ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**PKM**“)
 - periodické zkoušky elektrické bezpečnosti dle ČES 33.03.95 v případě ZP, které jsou napájeny elektrickou energií (dále jen „**ZEB**“);
 - periodické tlakové zkoušky/revize v případě ZP, jenž je současně tlakovým zařízením (dále jen „**ZTL**“)
 - periodické plynové zkoušky/revize v případě ZP, jenž je současně plynovým zařízením (dále jen „**ZPL**“)

Výsledek PBTK musí být Objednateli sdělen Zhotovitelem písemně i elektronicky formou protokolu o provedení PBTK, obsahujícího naměřené hodnoty, další zjištěné skutečnosti a výsledek kontroly v podobě doporučení pro další použití ZP.

- **preventivní údržba** – preventivní činnosti zajišťující stabilitu funkce ZP a předcházení vzniku závad, jako např. seřizování, kalibrace technických parametrů, nastavování nebo update HW a SW;
- **reakční doba** – doba od nahlášení závady do započetí činnosti směřujících k její analýze a odstranění;
- **servisní událost** – událost vedoucí k nutnosti vykonat servisní zásah, tj. vznik závady, nebo časově periodicky vzniklá potřeba vykonat preventivní údržbu, PBTK nebo školení obsluhy;
- **servisní zásah** – je soubor činností Zhotovitele provedených při výkonu PBTK, preventivní údržby nebo při odstranění závady, včetně dodávek a montáže náhradních dílů, dopravy a dalších doprovodných činností vedoucích k obnovení funkčnosti ZP;
- **závada** – porucha způsobující nefunkčnost ZP nebo odchylka parametrů ZP větší, než jakou stanovuje výrobce pro správnou funkci a provoz ZP, vyžadující následný servisní zásah Zhotovitele, zahrnující případně dodávku náhradních dílů, nastavení a kalibraci jeho parametrů a uvedení ZP do provozu.

4. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek pro plné servisní zabezpečení ZP v rozsahu specifikovaném v **článku II.** a vymezení vzájemných vztahů smluvních stran.

čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je Zhotovitelem poskytovaný soubor služeb a dodávek u ZP, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**smluvní ZP**“), a to zejména v tomto rozsahu:
 - 1.1 Provádění autorizovaného servisu a odborné údržby v souladu se zákonem o ZP a příslušnými předpisy+ výrobce ZP;
 - 1.2 Provádění instruktaží obsluhy v souladu se zákonem o ZP, příp. dle potřeby objednatele (max. rozsah instruktaží 2 prac. dny/ rok);
 - 1.3 Pravidelná organizace a provádění všech potřebných druhů PBTk přístroje dle zákona o ZP, a to 1x ročně, pokud výrobce nestanovil jinak;
 - 1.4 Provádění servisních zásahů ve smluvních časových limitech;
 - 1.6 Dodávky všech náhradních dílů potřebných pro bezchybný provoz ZP (včetně rentgenky/rentgenek);
 - 1.7 Provádění elektrické revize dle ČSN;
 - 1.8 Provádění zkoušek dlouhodobé stability;
 - 1.9 Provádění softwarových upgradů na ZP;
 - 1.10 Spolupráce s Objednatelům na zajištění řádného chodu zdravotnického prostředku (dále jen „**komplexní servisní zabezpečení**“)
2. Předmět smlouvy je dán:
 - a) touto smlouvou,
 - b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na dodávky: „**Pořízení RTG přístrojů pro ONN**“ vedené u zadavatele pod ev. č. VZ07/5 (dále jen „**ZD**“) a
 - c) písemnou nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky.
3. Doplnění nebo vyjmutí smluvních ZP je možné pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět výše uvedené činnosti v rozsahu potřebném pro zajištění plné provozní bezpečnosti a maximální funkčnosti ZP - rozsah a způsob realizace servisních služeb je dán touto smlouvou a platnou legislativou.
5. Zhotovitel prohlašuje a v rámci plnění předmětu smlouvy doloží kopiemi příslušných dokumentů, že z hlediska platné legislativy splňuje požadavky na kvalifikaci servisních pracovníků, požadavky na věcné vybavení i další požadavky a podmínky dané zákonem o ZP nutné pro výkon servisních činností vyplývajících ze zákona o ZP, tj. že mimo jiné:
 - má i příslušné oprávnění a registraci k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje
 - má i dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým závazkům, vyplývajícím z této smlouvy.
6. Pokud Zhotovitel nebude moci plnit některý ze závazků sám, je povinen zajistit jeho plnění na své náklady třetí stranou, oprávněnou k dané činnosti. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za činnosti, provedené třetí stranou a jím sjednané, a současně se zavazuje za třetí stranu povinně Objednateli doložit splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ZP.
7. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré škody, které by mohl Objednatel utrpět jako následek skutečnosti, že Zhotovitel (případně třetí strana) není schopen prokázat splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ZP nebo že dokumenty, prokazující splnění zákonných povinností, se ukáží býti nepravdivými.
8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu za prováděné dílo za podmínek ujednaných v této smlouvě.

čl. III. Místo plnění

1. Zhotovitel bude komplexní autorizované servisní zabezpečení u smluvních ZP provádět v prostorách Objednatele v místě provozování a používání smluvních ZP, případně ve vlastních prostorách Zhotovitele, bude-li to nezbytně nutné z technických důvodů.
2. V případě provádění činností v prostorách Objednatele se Zhotovitel zavazuje po ukončení činností předat prostory ve stavu, v jakém je převzal.

čl. IV. Doba plnění, lhůty plnění

1. Komplexní servisní zabezpečení bude Zhotovitelem poskytováno na základě této smlouvy po celkovou dobu **6 roků**, která začne běžet dnem uplynutí záručního servisu sjednaného na základě souběžně uzavírané kupní smlouvy mezi smluvními stranami na dotýčný smluvní ZP.
2. Servisní zabezpečení na smluvních ZP bude realizováno a organizováno Zhotovitelem takto:
 - PBTk a periodická údržba budou vykonávány organizačně a časově průběžně z iniciativy Zhotovitele, v termínech dle provozních potřeb jednotlivých ZP,
 - odstranění závad bude prováděno operativně na výzvu Objednatele.
3. Servisní zásahy typu **PBTk** a preventivní údržby bude Zhotovitel provádět u ZP v periodách určených výrobcem, a to v mírném časovém předstihu, nejpozději však k datu expirace validity předcházející PBTk daného typu.

Kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele (uvedené v čl. VII odst. 8 a 9 této smlouvy) dohodnou nejpozději do dvou týdnů po podpisu této smlouvy harmonogram provádění PBTk. Pokud k dohodnutí harmonogramu nedojde vinou nedostatečné součinnosti na straně Objednatele, vytvoří Zhotovitel tento harmonogram sám a dá jej bez prodlení na vědomí Objednateli.

Při nedodržení periodického termínu PBTk ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn vyřadit/odstavit smluvní ZP z provozu a vymáhat na Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 1 této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání ZP.

4. Servisní zásahy za účelem odstranění **závad** a obnovení funkčnosti ZP se Zhotovitel zavazuje provádět u smluvního ZP v následujících časových relacích:
 - **reakční doba Zhotovitele: do 48 hodin od nahlášení závady;**
 - **nástup servisního technika na opravu bude maximálně do 48 hodin od nahlášení závady Zhotoviteli, a to do místa umístění smluvního ZP. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 7.30 hod. do 16.30 hod. v pracovních dnech;**
 - **Lhůta k odstranění závady za předpokladu, že není k odstranění závady a zprovoznění smluvního ZP zapotřebí použití náhradních dílů, činí 24 hodin od nástupu servisního technika na opravu;**
 - **Lhůta k odstranění závady za předpokladu, že je zapotřebí použití náhradních dílů k odstranění závady a zprovoznění smluvního ZP, činí 48 hodin od okamžiku, kdy Objednatel schválí cenovou nabídku na náhradní díl;**
 - **Lhůta k odstranění závady za předpokladu, že je zapotřebí použití náhradních dílů k odstranění závady a zprovoznění smluvního ZP, přičemž tyto náhradní díly je bezpodmínečně nutné dodat ze zahraničí, činí 120 hodin od okamžiku, kdy Objednatel schválí cenovou nabídku na náhradní díl.**

Při nedodržení výše uvedených lhůt pro odstranění závady ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vymáhat na Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 2 této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání ZP.

5. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.

čl. V.

Cena díla a způsob placení

1. **Cena za dílo – poskytování komplexního servisního zabezpečení** bude Objednatelům Zhotoviteli hrazena za jednotlivé dílčí úkony vykonávané v rámci komplexního servisního zabezpečení, a to na základě cenových nabídek uvedených v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pořízení RTG přístrojů pro ONN II.“, konkrétně pak na základě cen uvedených v krycím listu nabídky a ve vyplněné příloze č. 2_5 – Technické podmínky, která tvoří nedílnou součást nabídky Zhotovitele.

Rozpisy ceny díla za komplexní servisní zabezpečení jsou pro všechny dodávané smluvní ZP ujednány dle výše uvedeného následovně:

Náklady na pravidelnou pozáruční bezpečnostní technickou kontrolu			
Zahrnuje veškeré náklady při provádění PBTk (tzn. cena zahrnuje veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, vč. výměny dílů, kontrolu elektrické bezpečnosti, veškeré mzdové a cestovní náklady servisního technika, vystavení protokolů a dokumentace)			
Pozn.: četnost PBTk uvést dle doporučení výrobce			
Název položky	Cena bez DPH za 1 PBTk (Kč/PBTk)	Četnost PBTk (rok/y)	Cena bez DPH za 6 let (Kč/6 let)
RTG systém VISION C	9 600 Kč	2 x za 1,00 rok/y	115 200 Kč

– **cena za úkony v rámci pozáručního servisu:**

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)	1 710,00 Kč
cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km	12,00 Kč

Tyto ceny jsou konečné, maximální a nepřekročitelné po celou dobu platnosti této smlouvy a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s poskytováním komplexního servisního zabezpečení dle této smlouvy Objednateli.

2. Cena za komplexní servisní zabezpečení pro smluvní ZP nezahrnuje servisní události způsobené nevěcnou manipulací, úmyslem či nedbalostí, zásahy třetích osob, vyšší moci nebo vnějšími okolnostmi, jako např. nedodržení předepsaných podmínek prostředí uvedených v návodu k obsluze ZP, vypovězení klimatizace, výpadek elektrického proudu.
3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohové platby.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit vůči Objednateli daňový doklad za účelem úhrady položkových měsíčních paušálních smluvních cen díla k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Zhotovitel zašle daňový doklad Objednateli elektronicky na e-mail: fakturace@nemocnicenachod.cz.
5. K daňovému dokladu Zhotovitele bude, v případě provedení servisního zabezpečení v daném – fakturovaném měsíci, jako příloha přiložen pracovní výkaz a dodací list (ze strany pracovníků Objednatelů potvrzený), dokladující konkrétní servisní zásah Zhotovitele v daném měsíci.

6. Daňový doklad vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitostí obchodní listiny podle § 435 odst. 1 občanského zákoníku, musí obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, doklad osvědčující zdanitelné plnění (zejména kopie oboustranně potvrzeného předávacího protokolu), číslo daňového dokladu, datum splatnosti a případné další zákonné náležitosti. Faktura musí být opatřena razítkem zhotovitele a podpisem zaměstnance objednatel je vystavit.
7. Objednateli vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu díla pouze na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem v souladu s ustanoveními této smlouvy. Pokud by daňový doklad nebyl zaslán Zhotovitelem se všemi přílohami dokladujícími časově a věcně výkon servisního zabezpečení v celém aktuálním rozsahu daného měsíce, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli daňový doklad vrátit v celém jeho rozsahu jako neoprávněně vystavený. Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění nedostatků vystavit doklad nový. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo.
8. Objednatel zaplatí smluvní cenu za dílo bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. Splatnost daňových dokladů se sjednává dohodou na dobu **30-ti dnů** od vystavení daňového dokladu Zhotovitelem.
9. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Objednatel je plátcem DPH.
10. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
11. Smluvní strany se dohodly, že pro období počínaje 1.1.2023 – 31.12.2023 a dále pro období od 1.1. – 31.12. každého následujícího roku je možné cenu za dílo jednostranným úkonem Poskytovatele navýšit o procento přírůstu průměrného ročního indexu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem (za předchozí rok). Poskytovatel tuto skutečnost oznámí písemně Objednateli. Nová smluvní cena potom platí zpětně od 1.1. toho kterého roku. Nebude-li výše uvedený index nadále uveřejňován nebo nebude-li možné jej z jakéhokoli důvodu použít, bude automaticky nahrazen takovým indexem, který se mu co nejvíce podobá a jehož vývoj se v předcházejících letech co nejvíce přiblížil vývoji dosud používaného indexu, přičemž přednostně bude užit index vyhlášený pro území České republiky.
12. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
13. Dodávky a služby, zajištěné Zhotovitelem prostřednictvím třetí strany, jsou zahrnuty ve smluvní ceně a nemohou být Zhotovitelem Objednateli přeúčtovány.
14. Za zaplacení ceny díla se považuje podání neodvolaného příkazu Objednatel k bankovnímu převodu příslušné částky ve prospěch účtu Zhotovitele.
15. Poskytování komplexního servisního zabezpečení dle této smlouvy v délce trvání 6 let od ukončení záručního servisu zboží bude Objednatel hrazeno z jeho vlastních nákladů, nikoli z finančních prostředků poskytnutých v rámci dotace, z níž je hrazeno servisované zboží.
16. V situaci, kdy cena náhradních dílů přesáhne částku 10.000,- Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen s předstihem alespoň 3 pracovních dnů informovat Objednatel o ceně náhradních dílů a tuto si nechat jednatel osobou Objednatel schválit (v konkrétnostech viz ustanovení Kupní smlouvy).

čl. VI. Předání a převzetí díla

1. Předáním díla se pro potřeby této smlouvy rozumí:

- prokazatelné předání ZP Objednateli do užívání po provedení zásahu v rámci komplexního servisního zabezpečení, a to včetně předání všech dokumentů specifikovaných v článku VIII. odst. 6 této smlouvy.
- v případě PBTK předání protokolů o výsledcích PBTK kontaktní osobě Objednatele.

čl. VII.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro plnění předmětu této smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel své závazky z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatel, není v prodlení s plněním svých závazků a neodpovídá za případnou škodu vzniklou Objednateli.
2. Objednatel je povinen na základě dohodnutého harmonogramu PBTK dle článku IV. odst. 3 této smlouvy předat předmět smlouvy Zhotoviteli v dohodnutých termínech za účelem provedení PBTK.
3. Prostory Objednatele určené k provádění PBTK a oprav Zhotovitelem jsou přístupné na vyžádání pouze pracovníkům Zhotovitele. Jiné osoby mají přístup jen v přítomnosti pracovníků Zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje respektovat výsledky PBTK a provést navržená opatření, uvedená Zhotovitelem v protokolu o provedení PBTK.
5. Hlášení závad je Objednatel povinen provádět telefonicky a zároveň písemně emailem na kontaktní údaje Zhotovitele (čl. VIII odst. 2 této smlouvy); Zhotovitel je následně povinen Objednateli vhodným způsobem potvrdit doručení hlášení závady.
6. Objednatel je povinen v zájmu zachování technických vlastností ZP dodržovat instrukce výrobce o používání ZP, používat vhodný spotřební materiál a provádět uživatelskou údržbu jen prostřednictvím pracovníků proškolených oprávněnou organizací.
7. Objednatel zodpovídá za způsob a rozsah vedení evidence zdravotnických prostředků dle zákona o ZP.
8. Kontaktní údaje Objednatele ve věcech vyplývajících z této smlouvy:
adresa: Purkyňova 446, 547 01 Náchod (sídlo Objednatele)
tel.: 491 601 940
email: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
9. Kontaktní údaje radiologického oddělení Objednatele:
adresa: Purkyňova 446, 547 01 Náchod (sídlo Objednatele)
tel. 491 601 380
email: wagner.stepan@nemocnicenachod.cz

čl. VIII.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen sledovat termíny pro provádění PBTK a plánovaných servisních zásahů u smluvního ZP v časových intervalech uvedených v čl. V odst. 1 této smlouvy a vykonávat všechny činnosti v rámci komplexního servisního zabezpečení bez výzvy Objednatele, avšak s poskytnutím jeho součinnosti.
2. Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech vyplývajících z této smlouvy:
F medical s.r.o.
adresa: Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 498 019 588
email: servis@fmedical.cz
3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování stanovených časových intervalů PBTK u jednotlivých smluvních ZP dle dojednaného harmonogramu.

4. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci před zahájením činností, souvisejících s komplexním servisním zabezpečením, v dostatečně přiměřeném předstihu uvědomili Objednatelům určené kontaktní osoby.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění PBTk a oprav ZP osobou odborně způsobilou dle zákona o ZP i dalších předpisů, a to v rozsahu, naplňujícím smysl **článku II.** této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vyhotovit o provedení a výsledcích každého servisního zásahu pracovní výkaz (písemný protokol), který potvrdí obsluha zařízení. Kopie protokolu bude předána obsluze zařízení, originál bude předán na kontaktní místo Objednatel. Kopii protokolu Zhotovitel též zašle Objednateli spolu s daňovým dokladem dle **čl. V. odst. 5.**

Pracovní výkazy musí obsahovat standardní údaje o povaze, průběhu a rozsahu prováděných činností a dále též musí obsahovat závěrečné konstatování provozního stavu zařízení, v němž se nacházelo při předání pracovníkům Objednatel, a to buď

„Zařízení (ZP) je / není funkční a bezpečné pro použití k výrobce určenému účelu při poskytování zdravotní péče.“

V případě nefunkčnosti musí obsahovat popis závad a doporučení dalšího postupu k dosažení funkčního stavu ZP. Doba nápravy nefunkčního stavu ze strany Zhotovitele je dána smluvní dobou odstranění závady **dle čl. IV. odst. 4** této smlouvy.

Je-li u zařízení Objednatel veden provozní deník, provede pracovník Zhotovitele do deníku též krátký zápis o provedeném servisním zásahu a jeho výsledku (např. „Provedena PBTk, zařízení provozuschopné – datum, podpis).

7. Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku Objednatel. Pokud Zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek Objednatel, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
8. V rámci plnění předmětu smlouvy Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání s odpady. Při realizaci předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat předpisy ve smyslu ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty ceně za dílo. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, ekologie apod.
9. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré škody, které utrpí jako následek skutečnosti, že Zhotovitel nedostojí svým závazkům z této smlouvy vyplývajícím.
10. Zhotovitel neodpovídá za vedení evidence ZP, předepsané poskytovatelům zdravotních služeb dle zákona o ZP.
11. Odborné posudky rozsáhlejšího charakteru jsou Zhotovitelem prováděny na objednávku ze strany Objednatel.
13. Po celou dobu plnění předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen mít uzavřené řádné pojištění pro případ odpovědnosti za škody vzniklé z jeho činnosti u Objednatel.
12. Zhotovitel se zavazuje při každém novém softwarovém upgradu zařízení v rámci jeho funkcionality provádět pravidelné upgrady po celou dobu účinnosti této smlouvy.

čl. IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta pro provedení PBTk dle článku IV. odst. 3 této smlouvy, má Objednatel kromě práva na náhradu škody možnost požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta dle článku IV. odst. 4 této smlouvy, má Objednatel kromě práva na náhradu škody možnost požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny či její části, má Zhotovitel možnost požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení o mlčenlivosti dle čl. XII této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
5. Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škod, které vzniknou smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Od výše náhrady škody bude odečtena již zaplacená smluvní pokuta či úrok z prodlení.

čl. X.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Zánikem smlouvy nezanikají nároky ze smlouvy již vzniklé, ani nárok na náhradu vzniklé škody a smluvní pokuty.

čl. XI

Ukončení smlouvy

1. Od této smlouvy lze jednostranně **odstoupit** pouze v případě hrubého porušení této smlouvy. Za hrubé porušení je považováno:
 - a) ze strany Zhotovitele neplnění předmětu smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a nezjednání nápravy, přestože bude Zhotovitel na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od doručení upozornění;
 - b) ze strany Objednatele prodlení s úhradou faktury delší než 60 dnů po splatnosti a nezjednání nápravy, přestože bude Objednatel Zhotovitelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od doručení upozornění;Odstoupení má právní účinky dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, ve kterém bude uveden důvod odstoupení.
2. Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy z důvodů uvedených výše v odst. 1 je odstupující smluvní strana oprávněna požadovat náhradu škody.
3. Tato smlouva může být před uplynutím sjednané doby plnění ukončena Objednatelem výpovědí i bez udání důvodu.
4. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Výpovědní doba činí 3 (slovy: tři) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva může být také ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

čl. XII

Mlčenlivost

1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může Zhotovitel přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se Objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů
 - mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích Objednatele,
 - které Zhotovitel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.
3. V případě pochybností sdělí Objednatel na žádost Zhotovitele, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li Zhotovitel o toto sdělení, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.
4. Zhotovitel zajistí zachování mlčenlivosti o veškerých důvěrných informacích a zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu k objednateli, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.
5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, přičemž objednatel je správcem osobních údajů osobních údajů a citlivých osobních údajů pacientů. Zhotovitel není pro účely této smlouvy v pozici zpracovatele osobních údajů.
6. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.

čl. XIII. Zvláštní ustanovení

1. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel se nemůže dovolávat svých obecných dodacích, servisních či jiných obchodních podmínek nebo obdobných podmínek subdodavatelů.
2. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejbližší původnímu záměru ve věcném i ekonomickém smyslu.
3. Obě strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné soudy země Objednatele, jejichž rozhodnutí bude konečné.
4. Závazky i pohledávky vyplývající z této smlouvy může Zhotovitel převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
5. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o informacích, které o sobě navzájem získaly v průběhu plnění předmětu této smlouvy, které nejsou obchodního charakteru a pokládají se za důvěrné.

Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti Objednatele zveřejnit obsah této obchodní smlouvy. Souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto smluvního vztahu a náležitostí z jeho plnění reálně vyplývajících nebo s ním obchodně a věcně souvisejících.

čl. XIV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem, přičemž žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za nepřiměřené či znevýhodňující kteroukoli ze smluvních stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jejich členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny prostřednictvím věcně příslušných soudů. Smluvní strany se dále dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném

znění, dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy je místně příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem Objednatele.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy případně i podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Přílohy v této smlouvě uvedené jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a podléhají jejímu právnímu režimu.
7. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Osvědčení prokazující způsobilost provádět komplexní autorizované servisní zabezpečení dle platné legislativy;

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů.

V Náchodě dne

V Hradci Králové dne

.....
RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady

.....
Ing. Jasmin Draganovič
jednatel

ADRESÁTF medical s.r.o.
Ing. Simona Kulhánková**ADRESA**Jana Krušinky 1737/6
Hradec Králové-Pražské Předměstí
500 02

VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. b) a písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), eviduje v Registru zdravotnických prostředků ke dni 28.03.2022 následující údaje:

Registrační číslo	031384
IČ	02464454
Název	F medical s.r.o.
Sídlo	Jana Krušinky 1737, 50002 Hradec Králové, Česká republika
Kontaktní osoba	Ing. Simona Kulhánková, obchod@fmedical.cz , +420733 622 418

Seznam činností:

- dovozce obecných zdravotnických prostředků
 - Zdravotnické prostředky:
 - 00506597, Vision C
 - 00203481, Visaris Avanse DR
 - 00235926, Vision V
 - 00919439, EPX-Series Diagnostic X-ray System
 - 00958921, Vision U
 - 00587139, iQ-X
 - 01023183, xCAT
- distributor obecných zdravotnických prostředků
 - Zdravotnické prostředky:
 - 00266773, XCELLENCE
 - 00266781, TRANSPORTIX BATT
 - 00266810, DX-D 100
 - 00266829, DR 400
 - 00266837, DR 600
 - 00266845, CR 10-X
 - 00266853, CR 15-X
 - 00266861, DX-M
 - 00266888, NX
 - 00266896, SE Suite
 - 00266909, CR MD1.0 GENERAL SET

- 00266917, CR MD4.0x GENERAL SET
- 00266925, CR MD4.0x GENERAL PLATE
- 00266933, CR MD1.0 GENERAL PLATE
- 00266941, CR MD4.0R GENERAL SET
- 00266968, CR MD4.0R GENERAL PLATE
- 00266976, TRANSPORTIX MLP
- 00301436, POLYRAD PREMIUM
- 00301444, POLYRAD S
- 00301452, POLYRAD SE
- 00587171, Nio 3MP LED Display (MDNG-3220)
- 00587200, Coronis 3MP LED Display
- 00587163, Nio Color 5MP (MDNC-6121)
- 00587120, Enterprise Imaging
- 00587243, CR 30-Xm
- 00587147, Nio 2MP LED Display (MDNC-2221)
- 00587198, Nio 5MP LED Display (MDNG-5221)
- 00587227, Coronis Fusion 4 MP (MDCC-4330)
- 00587219, Coronis 5MP LED Display
- 00587235, Coronis Fusion 6MP (MDCC-6430)
- 00587155, Nio 3MP Led Display (MDNC-3421)
- 00744958, CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X
- 00744974, DX-G, DX-M
- 00744931, DR Generator Sync Box, DR Retrofit Solution
- 00744923, DX-D 600
- 00744966, CR 30-X, CR 30-Xm
- 00706206, X-Ray Generator RST
- 00744982, MUSICA Acquisition Workstation - NX
- 00744878, DR 600
- 00744907, DX-D 100
- 00744886, DR 400
- 00744915, DR 100e
- 00744894, DX-D 300
- 00850021, SKR 4000
- 00852633, ddRAura OTC_APS
- 00608550, Imagepilot
- 00972264, DR 800
- 01006885, DR 100s
- 01006893, FXRD-2530VAW
- 01006906, FXRD-3643VAW
- 01006914, FXRD-4343VAW

- osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků

Výrobce: **Visaris d.o.o. Beograd**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	Visaris - Training Certificates FOMA signed	
Další - specifikujte	Visaris - Training Certificates FOMA signed_V3	

Výrobce: **VacuTec Mestechnik GmbH**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Další - specifikujte	VacuTec-FOMA authorization	Kopie dokladu o autorizaci servisu

Výrobce: **SEDECAL S.A.**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	SEDECAL	

Výrobce: **RADIOLOGIA S.A.**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	RADIOLOGIA	

Výrobce: **Agfa HealthCare N.V.**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	Agfa - training proof	

Výrobce: **Colenta Labortechnik GmbH & Co KG**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	Colenta-training	

Výrobce: **Swissray Medical AG**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Další - specifikujte	Swissray_Authorization letter SRM-FOMA_12.2017	
Další - specifikujte	Swissray_Authorization letter SRM-FOMA_11.2018	Autorizace
Další - specifikujte	DoC Swissray	Prohlášení o shodě jako důkaz, že pro Swissray je výrobcem

		Visaris d.o.o.
Další - specifikujte	Visaris - Training Certificates FOMA signed_V3	Kopie dokladu o školení odborné údržby (2020)

Výrobce: **KONICA MINOLTA, INC.**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	BEU_SE_FOMA- Pospisil_X50_20190404	
Kopie autorizace od výrobce pro osobu, která doklad o školení odborné údržby vydala	Letter of authorization_Konica Europe	
Další - specifikujte	SUKL-Prohlášení_adresa Konica	

Výrobce: **Agfa NV**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	Agfa NV - training proof	

Výrobce: **SonoScape Medical Corp.**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	Training certificates_SonoScape	

Výrobce: **ECOTRON Co.,Ltd.**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Další - specifikujte	Ecotron_Authorization letter	Kopie dokladu o autorizaci k dovozu a servisu

Seznam poddodavatelů

<i>Zadavatel:</i>	Oblastní nemocnice Náchod a.s.				
<i>sídlo zadavatele:</i>	Purkyňova 446, 547 01 Náchod				
<i>zastoupený:</i>	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady				
<i>IČO:</i>	26000202				
<i>název VZ:</i>	Pořízení RTG přístrojů pro ONN II., část VZ č.: 5 s názvem: 1 ks skiografického RTG systému				
<i>druh zadávacího řízení:</i>	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení				
<i>ev.č. VZ ve VVZ:</i>	Z2022-041967				
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	VZ07/5				
PODDODAVATEL			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
	IČ:				
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
	IČ:				
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				

**PŘÍLOHA Č. 6 KUPNÍ SMLOUVY – PRAVIDLA PRO ZŘÍZENÍ A POUŽÍVÁNÍ
VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU DO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD**

a. s.

1. *Kupující* umožní vzdálený přístup/připojení do své počítačové sítě nebo její části *Prodávajícímu* tak, aby mohl *Prodávající* vykonávat veškeré smluvní či *Kupujícím* prokazatelně vyžádané/objednané služby (dále jen „**služba**“).
2. *Kupující* zřídí vzdálený přístup pro *Prodávajícího* na dobu a v rozsahu nezbytně nutnou k plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy a rovněž ze souběžně uzavírané servisní smlouvy.
3. Technické podmínky vzdáleného připojení jsou dohodnuty takto:
 - a) VPN přístup dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel. *Prodávající* poskytne jmenný seznam přístupujících techniků včetně jejich emailů a čísel mobilních telefonů.
 - b) připojení přes SSH protokol VNC dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel
 - c) připojení přes RDP (Microsoft remote desktop klient) dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel
 - d) jiný typ přístupu či autentizace dle individuálně dohodnutých parametrů při podpisu smlouvy.

Předání parametrů přístupu a přístupových hesel zajistí zaměstnanec IT oddělení *Kupujícího* a proběhne při podpisu smlouvy.

4. *Prodávající* se zavazuje zajistit, že osoby, jim pověřené k vykonávání služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu nezneužijí vzdálený přístup do sítě k aktivitám, které nejsou v souladu se smluvním rozsahem poskytovaných služeb, a ani neumožní tyto aktivity třetí osobě.
5. *Prodávající* je povinen vždy předem zajistit, že nedojde k nepředpokládanému narušení chodu počítačové sítě (informačního systému), ani jiných služeb a systémů v síti *Kupujícího*, jakožto i řádného chodu serverů, počítačů a dalších HW komponent sítě. V případě porušení této povinnosti je *Kupující* oprávněn požadovat náhradu způsobené škody.
6. *Kupující* si vyhrazuje právo službu vzdáleného přístupu dočasně pozastavit či omezit bez udání důvodu. V tomto případě bude o rozhodnutí *Kupujícího* *Prodávající* neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.
7. V případě, že *Kupující* zjistí použití vzdáleného přístupu v rozporu s těmito pravidly, je *Kupující* oprávněn vzdálený přístup *Prodávajícímu* zcela zrušit. O tomto rozhodnutí *Kupujícího* bude *Prodávající* neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.
8. Kontaktní osoby pro účely poskytování služby a předávání informací dle bodů této přílohy:

Za Kupujícího:			
Jméno	Pozice	Telefon	Email
Ing. Bohuslav Hrabčuk	Vedoucí útvary ICT	491 601 659	hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz

Za Prodávajícího:			
Jméno	Pozice	Telefon	Email
Ing. Radomír Pospíšil	Vedoucí servisního oddělení	603 222 396	radomir.pospisil@fmedical.cz

PŘÍLOHA Č. 7 KUPNÍ SMLOUVY – PRAVIDLA SOUČINNOSTI S ÚSEKEM IT ODDĚLENÍ KUPUJÍCÍHO

V případě, že předmět smlouvy (zdravotnický přístroj) či jeho části vyžadují zapojení do počítačové sítě Kupujícího, musí být tato činnost prováděna se souhlasem zaměstnance IT oddělení Kupujícího (dále také jen jako „IT“). Zaměstnanec IT musí být o realizaci předmětu smlouvy, resp. záměru jeho zapojení do počítačové sítě Kupujícího, informován Prodávajícím s dostatečným předstihem, a to minimálně 10 kalendářních dnů před termínem vlastního plnění v místě plnění (podrobnosti viz níže).

Předmět smlouvy v rámci jeho instalace dle čl. II smlouvy zahrnuje všechny práce související s instalací dodávaných HW/SW částí do plně funkčního stavu, včetně integrace přístroje s obrazovým serverem Kupujícího (PACS) a modality worklist serverem napojeným na stávající nemocniční informační systém (NIS) Kupujícího. Prodávající provozuje systém Marie PACS od dodavatele OR CZ a.s. Prodávající si v této souvislosti zajistí součinnost dodavatele systému Marie PACS.

Pokud bude vyžadována Prodávajícím součinnost s IT oddělením Kupujícího, je nutné rozsah této součinnosti předem jasně písemně definovat (např. emailem na adresu it@nemocnicenachod.cz) a to minimálně 1 týden (7 kalendářních dnů) před termínem instalace. Za součinnost se považuje např. i zřízení vzdáleného přístupu přes internet.

Pokud požadavek na součinnost s IT oddělením Kupujícího svým rozsahem překročí 3 hodiny práce technika IT nebo bude vyžadovat plnění třetí strany, vyhrazuje si IT právo navrhnout vlastní termíny dle svých kapacitních možností.

Pokud požadavek nebude IT schopen akceptovat z kapacitních, technických či časových důvodů, může požadovanou součinnost celou nebo její část odmítnout, a to do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku. V tomto případě je Prodávající povinen zajistit všechny požadované úkony vlastními technikami nebo externím servisem.

Nemocnice provozuje své informační systémy v doménovém prostředí Microsoft Windows. Z důvodu kompatibility s tímto stávajícím prostředím je třeba, aby operační systémy uživatelských PC byly aktuální verze MS Windows Professional.