

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Kupující	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále také jako „*kupující*“ a

Prodávající **L I N E T spol. s r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 163

IČO	00507814
DIČ	CZ00507814
se sídlem	Želevčice 5, 274 01 Slaný
zastoupen	Bc. Zdeněk Grimm, MBA, ředitel obchodu pro ČR a SR, na základě plné moci
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále také jako „*prodávající*“ a

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preamble

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné zakázky na **dodávky s názvem „BD Hajnice - dodávka lůžek a nočních stolků II“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s vlastními technickými podmínkami předmětu koupě, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy – technická specifikace zboží, a oceněný soupis dodávek, který prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu kupní smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k **následujícímu vybavení** pro dokončenou budovu novostavby ubytovací budovy v areálu BD Hajnice (dále též jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Dodávka zahrnuje **30 ks elektricky polohovatelných postelí, 7 ks elektricky polohovatelných postelí s laterálním náklonem, 36 ks pojízdných nočních stolků k lůžkům a 1 ks patientského stolku**. Součástí dodávky bude provedení instruktáže pro personál.
- 1.2. Přesná specifikace zboží je uvedena v **příloze č. 1, v příloze č. 2, v příloze č. 5, v příloze č. 6 a v příloze č. 7** této smlouvy. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle článku II. této smlouvy.
- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a v souladu s veškerou dostupnou dokumentací (poskytnutou prodávajícím) příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.4. Kupující prohlašuje, že stavební připravenost v době zahájení plnění dle této smlouvy je nastavena jako tzv. výchozí připravenost (dle projektové dokumentace) a bude kupujícím upravena podle konkrétních potřeb a požadavků dodávaného zboží.
- 1.5. Prodávající do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předloží kupujícímu přesné technické parametry určující stavební připravenost pro dodávané zboží (přesné rozměry zboží, stavební připravenost pro napojení na rozvody technických zařízení budov, případně další nezbytné parametry).
- 1.6. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebudou porušovat ani nebudou mít za následek porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.

II.

Podmínky dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu **do 8 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí

účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.

- 2.2 Prodávající je povinen ověřit a následně vizuálně sladit barevný odstín a dekor zboží s dodávkou zastavěného vybavení, již prováděnou zhotovitelem stavby. Prodávající předloží nejpozději do jednoho (1) týdne od doručení výzvy k plnění zástupci kupujícího vzorek barevného odstínu a dekoru budoucí dodávky (tzn. vzorek od každého druhu dodávaného zboží: položky č. Z01, Z02, Z07 a Z08 soupisu dodávek), a to i ve více variantách k zajištění vizuální shody s již dodaným zbožím v místě plnění. Kupující o výběru a schválení barevné varianty a designu rozhodne na základě stanoviska generálního projektanta. Kupující rozhodne o výběru a schválení barevné varianty a designu do tří pracovních dnů od předložení vzorků.
- 2.3 Místem dodání jsou Barevné domky Hajnice, Hajnice 46, 544 66 Hajnice. O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího:

Pověřeným **zástupcem prodávajícího** je: Jiří Provazník, t

Pověřenými **zástupci kupujícího** jsou:

- (i) Ing. Václav Nýč, nebo;
- (ii) Ing. Marek Pavlík;

- 2.4 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na místo dodání specifikované v předchozím odstavci 2. 3. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrevize, atd.) a předepsaných přijímacích zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; a
- c) instruktáž („školení“) zdravotnického personálu (dle zákona č. 89/2021 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o ZP“); a
- d) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži personálu uživatele a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže personálu v používání zboží pro určeného pracovníka; a
- e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že dodávané zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii

prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP, v případě zboží se zdroji ionizujícího záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“) a prováděcích předpisů, zejména „rozhodnutí o povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření, vč. zaplacených správních poplatků; a

- f) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce; a
- g) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů.

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá funkční zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.5 Proávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Proávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.6 Proávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.7 Proávající zajistí na své náklady všechny konstrukce a zařízení novostavby, které by mohly být při dodání zboží poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a toto bezprostředně po dodávce na vlastní náklady odstranit.
- 2.8 Proávající zajistí na svoje náklady **ekologickou likvidaci veškerých obalů** vzniklých v souvislosti s jeho činností při vlastní dodávce a montáži a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
- 2.9 Proávající se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu úklid po provedených instalacích, montážích a jiných činnostech při dodání zboží do místa dodání, včetně případného (mokrého) očištění dotčených povrchů.

- 2.10 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen. Prodávající poskytne potřebnou koordinaci a součinnost s dalšími dodávkami, případně stavebními pracemi v místě plnění dle požadavků pověřených osob na straně kupujícího.
- 2.11 Prodávající se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“, které předal prodávající kupujícímu při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou (oddělenou) této smlouvy. Prodávající se tímto prohlášením zavázal, že:
- bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- 2.12. Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu prodávajícího.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí **2 718 130,00 Kč bez DPH**, přičemž pro položky Z01 a Z07 činí **DPH 15% 346.633,80 Kč**, a pro položky Z02 a Z08 činí **DPH 21% 85 519,98 Kč**, tj. **3 150 283,78 Kč včetně DPH**.
- 3.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, instruktáž a uvedení do provozu.
- 3.3. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.
- 3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle

ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:

- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na tuto smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
- soupis příloh.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 3 této smlouvy.

- 3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře.
- 3.8. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
- 3.9. Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
3. 10. V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.11. Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3. 9. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.

- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátcem či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **60 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce zboží.** Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2.1. a 2.3. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím poskytnuté záruční doby (60 měsíců nebo delší) ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bez vyzvání:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o ZP,
- revize dle § 47 zákona o ZP,

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.
- 5.3. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do zboží kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčností, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

5.4 Reklamáce zboží a kontakty prodávajícího:

- 5.4.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamáce“). I reklamáce učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:
- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
 - dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
 - slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.
- 5.4.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu **následující kontaktní údaje**, na kterých je povinen přijímat **požadavky na reklamaci**: **Ing. Lucie Krátká**, manažerka servisu [REDACTED]. Pracovní doba prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamáce se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.
- 5.4.3. V případě uplatnění reklamáce zboží se prodávající zavazuje, že **doba nástupu servisního technika** na opravu bude maximálně **do 24 hodin** od uplatnění reklamáce vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty skutečně v pracovní den mezi **8.00 – 17.00 hod.** nebo **do 12.30 hod.** následujícího pracovního dne, pokud bude reklamáce uplatněna v době po 17.00 do 8.00 hodin příslušného dne, nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech.
- 5.4.4. Jde-li o vadu odstranitelnou a nevyžadující použití náhradních dílů, zavazuje se prodávající tuto **odstranit** a uhradit veškeré související náklady nejpozději **do 24 hodin**

od nástupu servisního technika na opravu. V případě, že je nutné použití náhradních dílů, které má prodávající k dispozici, zavazuje se prodávající odstranit vadu nejpozději **do 72 hodin** od nástupu servisního technika na opravu. Pakliže je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě **do 10 pracovních dnů** počítaných od nástupu servisního technika na opravu.

- 5.4.5. Pakliže odstranění vady není možné do 72 hodin od nástupu servisního technika, zavazuje se prodávající, že (včetně případů neuznané reklamace), vypůjčí kupujícímu **náhradní zboží** (srovnatelných nebo lepších parametrů), včetně případné nezbytné instruktáže (školení) v rozsahu požadovaném ZOZP, a to tak, aby kupující měl toto náhradní zboží k dispozici a k užívání od 08.00 hodin čtvrtého dne následujícího po dni nástupu servisního technika dle článku 5.4.3. této smlouvy.
- 5.4.6. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.
- 5.4.7. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně **nové bezvadné zboží**, nejpozději však **do 10 týdnů** ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k tomuto novému zboží na kupujícího. Nové zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na nové zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku nového zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.
- 5.4.8. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.4.9. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.5. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

- 5.6. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.7. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činností svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. **Pojištění:** Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží s minimální pojistnou částkou ve výši 2.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k plnění. Prodávající se tato pojištění zavazuje udržovat v platnosti až do skončení záruční doby na zboží a v této době je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o platnosti a rozsahu pojištění.
- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.4.3. a 5.4.6. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.4.4. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6. 6. této smlouvy.
- 7.5. Zjistí-li kupující porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení (čl. 2.11), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 2.7, 2.8, 2.9 nebo 2.10 této smlouvy, a to za každý zjištěný případ a za každou ze zajištěných povinností.
- 7.7. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.8. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě dodání činí 5.000 Kč.
- 7.9. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.10. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a nedopadají na ni ani jiné výjimky, pro které by tato smlouva, či její část, nemohly být v registru smluv uveřejněny. Uveřejnění této smlouvy

v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.4.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně také, pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 6. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) prodávající opakovaně nebo závažným způsobem poruší svůj závazek z prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - f) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymození částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - g) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
- 9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Zvláštní ustanovení

10.1. Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v rámci veřejné zakázky vyhradil možnost změny závazku, a proto si strany ujednávají že, pokud by se do doby dodání stal původně dodavatelem nabídnutý výrobek

nedostupným, nebo dostupným s obtížemi, například v delším časovém intervalu, může být původně nabídnutý výrobek nahrazen jiným funkčně shodným, který bude stejné nebo vyšší kvality, než původně nabídnutý výrobek, nezmění se cena, nebo bude cena nižší, než původně nabídnutá, a výrobek bude nadále splňovat minimální požadavky kupujícího. Pokud navrhne prodávající záměnu výrobku, doloží kupujícímu všechny doklady potřebné k posouzení technických parametrů nabízeného výrobku. Pokud budou splněny všechny v tomto odstavci uvedené podmínky, kupující záměnu odsouhlasí bez zbytečného odkladu. Strany se mohou dohodnout na záměně i části plnění. Pokud bude nabídnut výrobek za nižší cenu, dojde ke snížení kupní ceny adekvátně.

- 10.2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vyloučí jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky nebo osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost

českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.

- 10.10. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po čtyřech vyhotoveních a dodavatel po jednom vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál.
- 10.11. Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží (technické/produktové listy; doklady k demontovatelnosti/opravitelnosti);

Příloha č. 2 – Oceněný soupis dodávek;

Příloha č. 3 – Závazný vzor Předávacího protokolu;

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění vč. seznamu poddodavatelů (budou-li využiti) - (oddělená příloha smlouvy)

Příloha č. 5 - IN.01 Technická zpráva (tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je oběma smluvním stranám dostupná)

Příloha č. 6 - IN.02 Půdorys SO 01 (tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je oběma smluvním stranám dostupná)

Příloha č. 7 - IN.010 Kniha specifikací_lůžka II (tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je oběma smluvním stranám dostupná)

Příloha č. 8 - Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace

Za kupujícího



Mgr. Martin Červíček

Hejtman Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího



Bc. Zdeněk Grimm, MBA

Ředitel obchodu pro ČR a SR

Na základě plné moci

Latera Acute

**LATERA**

Nemocniční lůžko s laterálním náklonem

Latera Acute



Polohování při prevenci proleženin, stlaní lůžka, hygiena pacienta a péče o pokožku, výměna plen, pooperační drenáže – všechny tyto úkony vyžadují přetočení pacienta na bok. Avšak přetočení pacienta na bok tradičním způsobem znamená značnou fyzickou námahu a s ní spojené riziko úrazu s možnými trvalými následky. Linet proto vyvinul elektricky polohovatelné lůžko Latera Acute s laterálním náklonem, s jehož pomocí lze přetočit pacienta s minimální fyzickou námahou.



— Preventivně působí proti některým negativním projevům imobilizačního syndromu. — Zefektivňuje prevenci dekubitů.		Pacient
— Snižuje fyzickou zátěž sester při manipulaci s pacientem. — Šetří čas potřebný na vykonávání rutinních ošetrovatelských aktivit.		Zaměstnanec
— Eliminuje riziko pracovního úrazu a zdravotního poškození. — Pomáhá zvyšovat kvalitu života dlouhodobě nebo trvale imobilních nemocných.		Management

Laterální náklon

Jednoduché a spolehlivé ovládání

Elektrické polohování lůžka obsluhuje zdravotnický personál pomocí ovladačů vhodně umístěných na různých částech lůžka.

Bezpečnostní GO tlačítko

Bezpečnostní koncepce GO tlačítka chrání pacienta před úrazem vzniklým samovolným pohybem lůžka. Pomocí tlačítka GO jsou aktivovány ovladače lůžka po dobu tří minut. Po uplynutí tří minut od posledního stisku tlačítka se ovladače automaticky deaktivují, jsou tak funkční pouze v okamžiku, kdy se s lůžkem polohuje úmyslně. Naopak v nestřežených chvílích jsou ovladače neaktivní a nemůže dojít k nechtěnému spuštění elektromotorů lůžka.




NOŽNÍ OVLADAČ

Nožní ovladače pro laterální náklon a výškové nastavení jsou umístěny na obou stranách lůžka, umožňují tak snadné nastavení náklonu a výšky bez dotyku rukou.



Postup při stlaní lůžka s laterálním náklonem

Stlaní lůžka je jednou z možností, jak efektivně využít laterální náklon.




1. Sestra si může nastavit lůžko do výšky, která jí nejvíce vyhovuje. Nemusí pracovat v předklonu.




2. Sestra pomocí nožního ovladače naklopí lůžko do strany. Lůžko má zvednutou postranici na straně sestry, před postranicí je polštář pro pohodlné opření pacienta.




3. Laterální náklon přebírá podstatnou část práce nutné na přetočení pacienta na bok. Sestra vynakládá desetkrát méně síly. Otočit je tak možné i velmi těžkého pacienta.



4. Pacientova poloha je stabilní a sestra se může plně věnovat výměně ložního prádla na druhé straně lůžka.



5. Sestra pomocí nožního ovladače srovná lůžko do vodorovné polohy, položí pacienta na záda, napřímí druhou postranici a umístí před ni polštář pro pacienta.



6. Pomocí laterálního náklonu je pacient přetočen na druhý bok a sestra může dokončit převlékání druhé části lůžka.

Další benefity lůžka


Lůžko Latera Acute nabízí kromě laterálního náklonu další nadstandardní vlastnosti, které sestrám pomáhají v péči o nemocné a zároveň zajišťují vyšší bezpečnost i pro samotné pacienty.

Brake alarm

Brake alarm je inteligentní systém brždění lůžek, který automaticky aktivuje brzdy lůžka po jeho zapojení do sítě. K zabrždění lůžka dojde po jedné minutě od zapojení lůžka do elektrické sítě. Zamezuje pádům pacientů kvůli nezabržděnému lůžku a zároveň poskytuje jednoduchou kontrolu nad lůžkem pro zdravotnický personál.

Snadná manipulace s lůžkem

Snadná manipulace s lůžkem během transportu pacientů přispívá ke snížení pracovního vytížení sester a ostatního zdravotnického personálu. Centrální 5. kolečko výrazně vylepšuje jízdní vlastnosti lůžka. V místech s nedostatkem prostoru lze manévrovat díky 5. kolečku prakticky na místě bez nutnosti nadjíždění a zpětného popojíždění. Naopak na dlouhých koridorech lze využít schopnosti 5. kolečka vést lůžko bez vychýlení – lůžko dobře drží přímý směr. Manévrování s lůžkem vybaveným 5. kolečkem není komplikované, ani pokud lůžko řídí pouze jedna osoba.

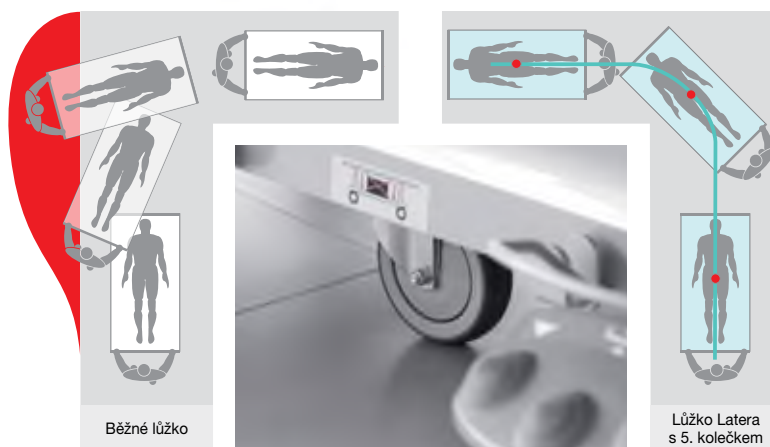



Koncept postranic

Jednodílné sklopné postranice s horním ovládáním.



Protektor

Poskytuje ochranu po celé délce ložné plochy. Je umístěn v nožní části lůžka, a navazuje tak na jednodílnou postranici, jak svými rozměry, tak designem.



Extender

Umožňuje použití aktivní matrace na lůžku a zvyšuje jeho výšku o 10 cm.

Prevence nozokomiálních infekcí

Nozokomiální infekce představují vedle dalšího strádání pacienta také zvýšené náklady na léčbu. Dokonalou a snadnou dekontaminací nemocničního lůžka lze podstatnou měrou těmto komplikacím léčby předcházet. Základní pilíř snadné a kvalitní očisty lůžek Latera Acute tvoří sloupové zdvihové jednotky. Sloupky tvoří hladké hliníkové profily bez těžko čistitelných mezer a spár. Koncept snadné hygieny lůžka se opírá dále o bezspárové technologie plastů, které tvoří značnou plochu lůžka vystavenou infekčnímu znečištění.



Technické parametry

1 Postranice

Jednodílné sklopné postranice lůžka poskytují pacientovi ochranu před pádem a zároveň jej stabilizují v poloze na boku.

2 Čela

Odnímatelná plastová čela umožňují rychlou a snadnou očistu. Zámky čel zabraňují nechtěnému vytažení během jízdy nebo během jiné manipulace. Dekor výplně lze dodat v různých odstínech z nabídky LINETu.

3 Sesterský ovladač Supervisor

Centrálním sesterským ovladačem lze nastavit všechny polohy lůžka, přičemž v paměti ovladače jsou uloženy často používané polohy. Dále obsahuje GO tlačítko, STOP tlačítko a indikátor stavu baterie.

4 Prodloužení lůžka


Integrované prodloužení lůžka umožňuje přizpůsobit délku ložné plochy individuální výšce pacienta.

5 Ložná plocha

Čtyřdílná ložná plocha je polohovatelná pomocí elektromotoru. Její povrch tvoří odnímatelné, snadno omyvatelné plastové díly.

6 Sloupy

Elektrické zdvihové jednotky, umístěné ve třech sloupech, umožňují výškové nastavení ložné plochy a dalších poloh včetně laterálního náklonu. Sloupová konstrukce zajišťuje lůžku dokonalou stabilitu.

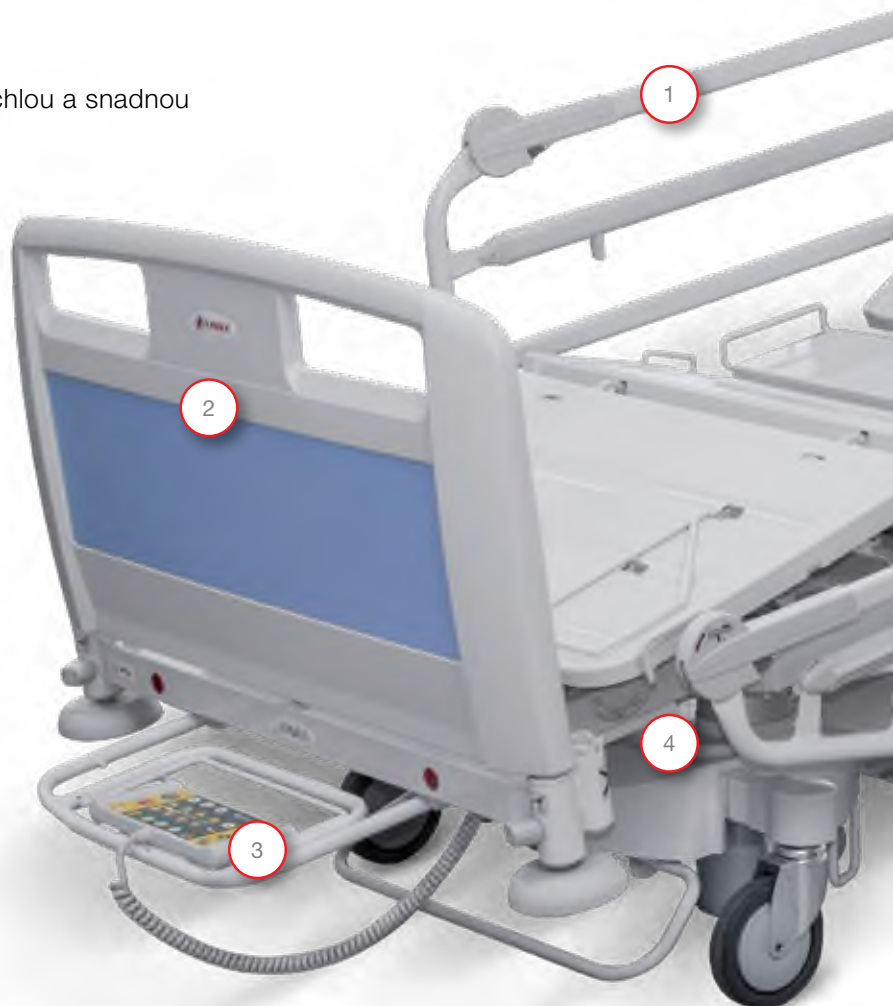



7 Nožní ovladače

Ovladače výšky lůžka a ovladače laterálního náklonu jsou umístěny po obou stranách lůžka. Proti nechtěnému spuštění jsou ovladače chráněny mechanickou zábranou a vybaveny elektrickým zámkem a GO tlačítkem.

8 Kolečka

Kolečka o průměru 150 mm jsou k dispozici ve variantě Tente integral a Tente integral dvojitá kolečka.

9 5. kolečko

5. kolečko, usnadňující manipulaci s lůžkem při jízdě, je ovládáno samostatně nožní pákou.

Technické parametry

Vnější rozměry	219 × 98,5 cm
Prodloužení lůžka	± 12,5 cm
Rozměry matrace	200 × 86 cm
Výškové nastavení ložné plochy	43–81 cm
Laterální náklon	15°
Náklon TR/ATR	± 16°
Náklon zádového dílu	0–60°
Náklon stehenního dílu	0–46°
Podjezdnost	15 cm
Bezpečná pracovní zátěž	200 kg

Certifikáty

Společnost LINET je certifikována podle evropských norem a systémů kvality EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14001.

Výrobky jsou vyrobeny podle evropských norem pro zdravotnickou techniku a nemocniční lůžka: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V, ±10 %
Maximální příkon	max. 1,6 A 370 VA
Krytí proti vniknutí vody a prachu	IPX4
Typ ochrany před elektrickým proudem	třída I

Konfigurace


Základní vybavení

- Plně elektrické lůžko se sloupovou konstrukcí
- Max. pracovní zatížení 200 kg
- Jednodílné spustitelné lakované postranice s ovládacím mechanismem shora
- Autoregrese 11 cm
- Mechanické i elektrické CPR
- Odnímatelná plastová čela v barevném provedení s bezpečnostním zámekem
- Prodloužení lůžka
- Bezpečnostní ovládání pomocí tlačítka GO
- Tlačítko autokontura
- Záložní baterie s inteligentní nabíječkou
- Polička na ložní prádlo
- Kolečka TENTE, 150mm centrální brzda
- Ochranné rohové nárazníky
- Plastové kryty podvozku
- Držáky infuzních stojanů
- Držák síťového kabelu
- Držáky matrací
- Upevňovací držáky Segufix

Volitelné vybavení

- 4dílná plastová ložná plocha z ABS
- Hliníková nebo plastová čela
- 5. kolečko
- Alarm brzd
- Nožní ovládání
- Noční podsvícení
- Pacientský ovladač


Dekory




White (O30)



Pearl white (Co17)



Aquamarine (A014)



Rose givre (R058)



Oslo blue (B048)



Fleur d' anis (F053)



Light grey (G044)



Tangerine (T106)



Maple white (E009)



Beech provence (H027)



Merisier ambre (M091)



Zebra moka (Z002)

Latera Thema

Lůžko Latera Thema s laterálním náklonem, dřevěným obložením a hliníkovými prvky je určeno pro nadstandardní pokoje a moderní kliniky.



Patentové řešení zdvihové jednotky lůžka zajišťuje vynikající stabilitu. Skládá se z hliníkových dílů s vynikající ochranou proti znečištění.



Laterální náklon umožňuje polohování klienta s minimálním fyzickým úsilím, pouze za účasti jedné osoby.

Latera Acute

Pacient

- Preventivně působí proti některým negativním projevům imobilizačního syndromu.
- Zefektivňuje prevenci dekubitů.



- Snižuje fyzickou zátěž sester při manipulaci s pacientem.
- Šetří čas potřebný na vykonávání rutinních ošetrovatelských aktivit.



Zaměstnanec

Management

- Eliminuje riziko pracovního úrazu a zdravotního poškození.
- Pomáhá zvyšovat kvalitu života dlouhodobě nebo trvale imobilních nemocných.



LINET

Members of LINET Group

LINET, spol. s r. o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



www.linet.cz

SENTIDA SC

LINET

Rozmanitost odpovídající vašim potřebám



Univerzální nízké pečovatelské lůžko



Rozmanitost odpovídající vašim potřebám

Sentida sc – univerzální nízké pečovatelské lůžko

Díky lékařskému a technickému pokroku se délka života lidí již několik desetiletí neustále prodlužuje. Vyšší věk, kterého se dnes mnoho lidí dožívá, má řadu důsledků.

Mnozí senioři si přejí, aby mohli trávit svá pozdní léta v důvěrně známém prostředí. Současně se mění vnímání starších lidí ve společnosti. Pro mnoho seniorů dnes již odchod do důchodu neznamená nečinnost, ale je to životní etapa, kdy se věnují různým zájmům a chtějí žít plnohodnotný a aktivní život.

Hledají se nové koncepty kvalitního života ve vyšším věku. Patří mezi ně například touha po vhodném bydlení, které nabízí domácí atmosféru, osobitost, bezpečí, pohodlí a flexibilitu.

Společnost LINET si je těchto požadavků a změn vědoma. Jako mezinárodně působící společnost v oblasti pečovatelských a zdravotnických se této situaci přizpůsobila.

Díky nové lůžkové platformě Sentida sc a konceptům na míru můžeme na rozličné požadavky reagovat ještě pružněji,

efektivněji a s ohledem na konkrétní potřeby. Chceme podporovat zachování a rozvíjení individuální mobility jako zásadního cíle v péči.

Funkční - Inteligentní - Důstojná



Funkční–Inteligentní–Důstojná



Individuální mobilizace

Udržení a podpora mobility jsou hlavní cíle profesionální péče.



Bezpečný spánek

Odpočinek a spánek s funkcemi univerzálního nízkého pečovatelského lůžka zohledňujícími potřeby uživatelů.



Systém senzorů opuštění lůžka

Individuální podpora a bezpečnost díky inteligentní senzorové technologii.



Profesionální digitalizace

Inovativní digitální řešení pro podporu jednotlivých pečovatelských činností a komplexních pečovatelských procesů.



Intelligentně propojené

Připravte se na požadavky budoucí péče.



Péče vycházející z konkrétních potřeb

Optimální a bezpečný přístup ke klientovi.

Koncepty

Objevte vhodné koncepty přizpůsobené různým typům interiéru, potřebám a požadavkům.

Old town



6

Cottage



16

Sunset



22

Seaview



28



Koncept: Old town

Design Dfx | Dekor Norway Maple



Uzpůsobeno pro...

- domovy pro seniory
- bydlení s asistencí
- rehabilitační kliniky
- zvláštní péče pro osoby s vážným fyzickým omezením nebo imobilitou



Individuální mobilizace

Udržování a podpora mobility je klíčovou oblastí profesionální péče

Lidé přikládají vlastní mobilitě velký význam. Mobilita je rozhodujícím faktorem všech činností každodenního života, závisí na ní mnoho dalších věcí.*

Ne nadarmo patří udržování a podpora individuální mobility, zejména starších osob, k základním oblastem péče.

Vhodná ošetrovatelská opatření významně přispívají k prevenci vzniku nových funkčních poruch a onemocnění, které ovlivňují mobilitu, a tím podporují proces, jenž může vést k značné závislosti na pomoci a potřebě dlouhodobé péče.*

Důraz je kladen na osoby a jejich zdroje

Neexistuje žádná standardní mobilizace, která by pomáhala všem klientům a využívala stejné techniky. Podpurná a doprovodná opatření lze proto vždy přizpůsobit pouze individuálně dané situaci a osobě.

Proto ani udržování a podpora mobility nemohou být posuzovány jednotlivě, ale měly by být úzce propojeny s ergonomií a ergonomickými pracovními postupy.

Univerzální nízké pečovatelské lůžko Sentida sc od společnosti LINET je navrženo tak, aby jeho vybavení bylo možné přizpůsobit různým potřebám a specifickým požadavkům.



Na mém lůžku jsem v dobrých rukou, mohu si jej snadno nastavit a také pohodlně vstát – bez pomoci.

Walter Schulte, klient

Řešení 1

Postranice SafeFree®

Bezpečná mobilizace bez ohledu na konstituci těla



Systém SafeFree®

- optimálně navržen pro výstup z lůžka
- individuálně polohovatelný ve 4 výškových úrovních
- snadno uchopitelný
- bezpečná pomůcka pro stání – samostatně nebo s oporou

Řešení 2

SafeLift a MobiStick 2

Mobilizační asistenti



SafeLift

- snadno ovladatelný
- pomůcka při vstávání a mobilizaci
- ovladač pro nastavení výšky a zádového dílu bez baterie nebo kabelu
- individuálně nastavitelný pro každého klienta



MobiStick 2

- rychlý a snadný na instalaci
- chytrý a jednoduchý na použití
- slouží jako opora při vzpřímeném sezení na okraji lůžka
- ergonomický a poskytuje dodatečnou oporu při vstávání



Řešení 3 Ovladač SafeControl®

Přehledný, ergonomický a intuitivní

Systém SafeControl®

- přehledně a ergonomicky řešený
- intuitivní při používání a chráněný proti chybnému použití díky předvolbám
- dobře čitelný i ve tmě díky systému snímače pohybu s podsvícením
- flexibilní a bezpečně umístitelný na postranice SafeFree®
- vybavený funkcemi zvláštní péče
- zabezpečený proti nesprávné manipulaci díky integrované funkci uzamčení

Další PLUS lůžka Sentida sc:

Ovladač SafeControl® lze umístit na levou nebo pravou stranu lůžka bez použití nářadí, rychle a bez velké námahy.



Klientské funkce

- Nastavení zádového dílu
- Autokontura
- Nastavení výšky

Aktivní tlačítka

- Nahoru/dolů
- LED indikátor stavu

Ošetrovatelské funkce

- Automatické komfortní sezení
- Automatická prevence dekubitů

Provozní režimy SafeControl®

Ošetrovatelský režim:

Všechna tlačítka výběru odemčená

Režim uzamčení:

Všechny funkce ovladače zamčené

Klientský režim:

Klient může použít světle šedá tlačítka



Pečovatelská opatření zaměřená na udržení nebo podporu mobility pomáhají zachovávat nezbytné základy samostatného života.

Odborný standard podle § 113a SGB XI „Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege“ (Udržování a podpora mobility v ošetrovatelské péči), aktualizace 2020



Řešení 4 Dvojitá autoregrese ložné plochy


Bezpečná a pohodlná mobilizace na lůžku

— standardní ložná plocha bez autoregrese



Riziko vzniku dekubitů

+ ložná plocha s dvojitou autoregresí

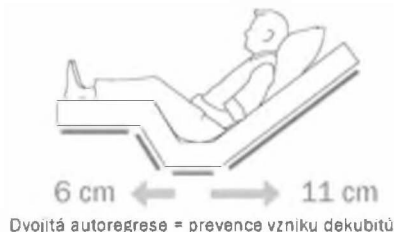

Dvojitá autoregrese = prevence vzniku dekubitů

Dvojitá autoregrese

- optimalizuje opěrnou plochu v oblasti sedací části zvětšením plochy zádového dílu a opěrky stehen
- snižuje tlak na citlivé části těla, jako jsou hýždě a kostrč
- usnadňuje dýchání tím, že v uvolněné poloze vsedě vytváří více prostoru v oblasti hrudníku a břicha
- v kombinaci se zádovým dílem o délce téměř 90 cm umožňuje preventivní a pohodlné polohování imobilních osob

Dvojitá autoregrese = o 17 cm víc prostoru na lůžku!

Řešení 5 Automatické polohy

Rychlé, snadné a ergonomické díky režimu jednoho tlačítka



Sledování televize, nebo čtení na lůžku s automatickým komfortním sezením



Prevence vzniku dekubitů a odlehčení pat prostřednictvím automatické profylaxe

Automatické komfortní sezení a profylaktická poloha

- podporují zdraví zejména imobilních klientů
- zvyšují kvalitu života klientů na lůžku
- doplňují pečovatelské strategie v oblasti prevence dekubitů a ošetrování poranění



Bezpečný spánek

Nízká poloha pro pohodlný odpočinek a spánek

Většina lidí chce zůstat mobilní a nezávislá i ve stáří. V průběhu přirozeného procesu stárnutí se však přirozená pohyblivost snižuje nebo omezuje. Zvyšuje se tak individuální riziko pádu.*

Klienti pečovatelských domů jsou vystaveni zvýšenému riziku pádů. Tyto pády mohou často vést ke zraněním, která vyžadují léčbu, ale i v případě méně závažných pádů je proces hojení často zdlouhavý a sebedůvěra ve vlastní schopnosti klesá.

Navíc pak přichází strach z dalšího pádu.

Ten může být často více stresující než samotný pád. Strach z pádu je u starších lidí běžný.**

Lidé ze strachu z pádu omezují svou pohyblivost. Postupem času dochází k ztrátě nezávislosti a může se zvyšovat míra potřeby péče.***

Strach z pádu přichází častěji v noci.

Tma navíc komplikuje orientaci v místnosti, odhad vzdáleností a bezpečnou chůzi. Aby se tento cyklus přerušil, je třeba

vyvinout cílené úsilí k posílení sebedůvěry, a tím zamezit strachu z pádu, a také poskytnout optimální fyzickou podporu.

Sentida sc od společnosti LINET nabízí řešení, která zohledňují různé stupně péče, individuální možnosti a schopnosti starších klientů pomocí udržitelných a koncepčních možností vybavení pečovatelských lůžek.

Řešení 1 Nízká poloha 23 cm

Bezpečný spánek bez omezení osobních potřeb



Nízká poloha 23 cm nabízí

- domácí vzhled
- bez omezení osobních potřeb
- bezpečné vstávání



Řešení 2 SafeFree®

Zvýšení bezpečí



Orientační poloha postranice na straně hlavy může

- v kombinaci s nízkou polohou 23 cm podporovat bezpečnost
- snížit riziko pádu

Řešení 3 SafeFree® fix a flex

Přizpůsobeno požadavkům



Bez ochrany



3/4 ochrana




Mírná ochrana



Plná ochrana

4 dělené postranice v kombinaci se širokou škálou postranic SafeFree® chrání osoby ohrožené pádem.

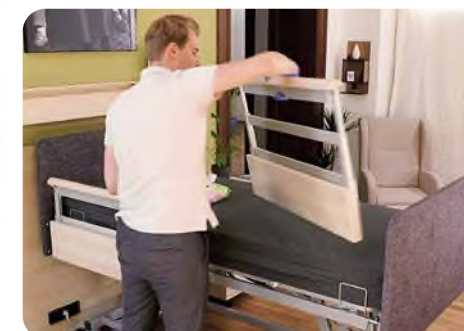

* Research and analysis of care dependency terms and assessment instruments; Copyright © GKV-Spitzenverband 2011 / ISBN: 978-3-7747-2308-5.
Sturzprophylaxe in der Pflege – Expertenstandards leicht verständlich; Stand: leden 2013 S přihlednutím k 1. aktualizované verzi odborného standardu z roku 2013 / Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V.
** S. Schlee: Fall in old age and its consequences – The beginning of the end? ARS MEDICI DOSSIER XI, 2016
*** A. Zegelin: "Being nailed down" – The process of becoming bedridden by gradual place fixation; Pflege 2005; 18:281-288 © by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 2005.



Řešení 4 SafeSense® Bezpečné opuštění lůžka s individuálním upozorněním

Asistenční systém SafeSense®

- signalizuje ošetřujícímu personálu, že se klient chystá opustit lůžko
- pracuje s nastavitelnou funkcí časovače (0–30 min) na principu semaforu
- může být připojen k automatickému systému osvětlení podvozku, které se aktivuje při opuštění lůžka
- může být připojen k systému Nurse call
- je k dispozici jako rádiové a kabelové řešení
- lze ho dodatečně nainstalovat.**

Další PLUS lůžka Sentida sc:

Komplexní řešení prevence pádů: nízká poloha 23 cm + patentované a nastavitelné postranice + inteligentní asistenční systém.

SafeSense® upozorní ošetřující personál, že klient opustil nebo se chystá opustit lůžko. Díky tomu lze pády odhalit dříve než při běžných kontrolách.

Asistenční systém SafeSense® funguje v podstatě jako semafor. Tak lze jasně a velmi jednoduše vysvětlit jeho fungování:



Časovač není aktivován



Časovač je aktivován

→ např. 15 minut na návštěvu toalety v noci



Uplynutí času k návratu na lůžko

→ Signál do systému volání

SafeSense® – asistenční systém

Společnost LINET se při vývoji produktů pro péči o seniory řídí vizí podpory a udržování zdraví ve stáří a také posilování samostatnosti starších lidí v kombinaci se zlepšováním kvality života.

Klíčovou roli hraje bezpečnost ve spojení s inteligentní technologií senzorů pro denní a noční opuštění lůžka a novými technickými možnostmi.




Větší bezpečnost – méně opatření omezujících svobodu (FDM*)

- rychlá reakce v případě pádu
- vysoká míra bezpečnosti při nočních a víkendových směnách
- méně kontrol
- ideální v kombinaci s nízkými pečovatelskými lůžky Sentida a postranicemi SafeFree®



Koncept: Cottage

Design Ts | Průběžné postranice | Dekor Elm Salisbury



Uzpůsobeno pro...

- rodinné příslušníky pečující o osoby s demencí
- komunity s asistovaným bydlením
- rehabilitační kliniky se zaměřením na neurologická onemocnění
- zvláštní péči při mírných tělesných omezeních



Profesionální digitalizace

Inovativní digitální řešení pro podporu individuálních pečovatelských činností a komplexních pečovatelských postupů

Odborníci považují digitalizaci péče o seniory za velkou příležitost, která může díky technickým inovacím odlehčit ošetřovatelskému personálu.

Digitalizace představuje podporu v každodenní péči.

Díky cílenému využití senzorů lze například včas odhalit a ohlásit potenciální nebezpečí pádu a nesprávné pohybové návyky klientů.

Používání mobilních zařízení navíc umožňuje mobilní práci a šetří čas.

Rychlejší přístup k odborným znalostem a informacím týkajícím se péče z jakéhokoli místa.

Pracovní postupy lze vytvářet ještě efektivněji, pokud zařízení poskytující péči systematicky vyhodnocují a slučují data ze své digitální dokumentace. Z těchto výsledků lze odvodit vzájemný vztah mezi provedenými zákroky a požadavky na lepší plánování péče.

Společnost LINET se v současné době zaměřuje na tři témata a s nimi spojená rizika pro klienty: pády, dekubity a inkontinence.

Digitální asistenční systém SafeSense® 3 pomáhá analyzovat data a v případě potřeby podniknout preventivní kroky.

Péče vyžaduje digitalizaci – funkční, inteligentní a důstojnou.



Společnost Vechtetal Pflege GmbH si dala za cíl proměnit klasickou péči o seniory pomocí inovativních technologií. Vybrali jsme si systém SafeSense® 3, protože bezpečnost našich klientů je pro nás nejvyšší prioritou. Rychlejší reakce na pády může často zabránit vzniku vážných následků.

Eike Jonker, generální ředitel Vechtetal Pflege GmbH

Řešení 1 SafeSense® 3

Od asistenčního systému pro opuštění lůžka k digitální pečovatelské platformě

Po více než 6 letech zkušeností s integrovanými systémy senzorů opuštění lůžka nastal čas představit skutečný asistenční systém.

Společnost LINET získává cenné zkušenosti s digitálními produkty již od roku 2014 díky asistenčnímu systému SafeSense® a inteligentnímu pečovatelskému lůžku Sentida 7-i.

Během této doby systém SafeSense® dozrál v asistenta péče s dalšími podpůrnými funkcemi a je doporučován jako platforma pro digitalizaci, která obstojí i v budoucnosti. Tento koncept lze snadno dovybavit ještě dalšími funkcemi, které přinesou ošetřovatelům další úlevu.



Inteligentně propojené

SafeSense® 3



1

Mobilní zařízení

Všechny údaje neustále na očích



2

Monitor péče

s vizualizací dat

Prevence **dekubitů**
prostřednictvím monitorování pohybu

Prevence **pádů** s monitorováním
opuštění lůžka

Bezpečnost
Ochrana údajů o klientech
díky šifrovanému přenosu
a decentralizovanému zpracování dat



3

Připojení k systému Nurse call

Bezpečnostní výhoda pro noční
a víkendové směny



4

Asistenční systém





Koncept: Sunset

Design C | Dekor Nordic Teak



Uzpůsobeno pro...

- Hospice
- Oddělení paliativní péče
- Zvláštní péče s vysokým stupněm imobility



Péče vycházející z konkrétních potřeb

Optimální a bezpečný přístup ke klientovi

Mobilizační činnosti a každodenní péče o klienty mohou být pro ošetřující personál velmi náročné a stresující. Může se stát, že ošetřovatelka musí za jednu směnu zvednout celkem až 1,8 tuny.*
Fyzický stres a napětí ošetřovatelů mohou mít další nepříznivý vliv na osobu, o kterou pečují.

Následné úzkostné reakce ze strany klienta mohou značně omezit vlastní motivaci a mobilitu.

Sentida sc dokáže podpořit ošetřovatelský personál i klienty.



Ergonomická optimalizace důležitých pracovních úkonů a optimální poloha pečovatelského lůžka, používání integrovaných pomůcek a externích ošetřovatelských pomůcek, to vše snižuje fyzickou zátěž.

Koen de Doncker, fyzioterapeut, osteopat a ergonom

Řešení 1 Strategie 4-stop

Situační a na potřebách založená péče a podpora

Komfortní rozsah nastavení od 23 do 80 cm umožňuje:

- ergonomickou pečovatelskou polohu ve výšce 80 cm
- v kombinaci se samostatně nastavitelnými opěrkami steh a lýtek poskytuje dostatečnou volnost pohybu, např. při základní péči nebo ošetřování ran
- snadný přesun z lůžka na židli a zpět s mobilizační úrovní ve výšce židle – 41 cm
- výška 31 cm poskytuje vhodnou mobilizační výšku pro menší klienty
- s bezpečnou polohou na spaní 23 cm.


80 cm

Optimální ošetřovatelská poloha




41 cm

Bezpečná mobilizace ve výšce židle

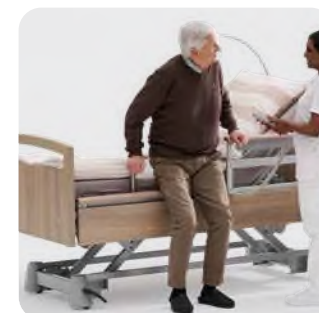

31 cm

Bezpečná mobilizace pro menší klienty

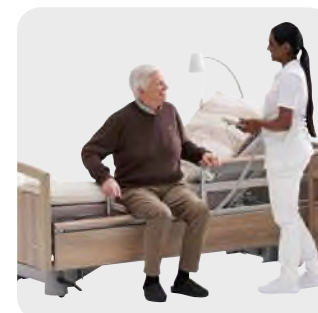

23 cm

Prevence pádů ve fázích spánku



Řešení 2 Centrální brzda

nohou ovládaná centrální brzda lůžka



Sentida sc má volitelně centrální brzdu na straně nohou, která je snadno a bezpečně přístupná. Přemístění lůžka uvolněním centrální brzdy – např. při úklidu – je tak jednoduché a rychlé.

“

”



Řešení 3


Komfortní ložná plocha větší bezpečnost pro imobilní klienty



Komfortní ložná plocha je vybavena 55 pružinami, které poskytují vysokou úroveň pohodlí při ležení a napomáhají odlehčit tlak, aby nedošlo ke vzniku dekubitů.

Řešení 4

Integrované prodloužení lůžka bez použití nářadí a flexibilně nastavitelné

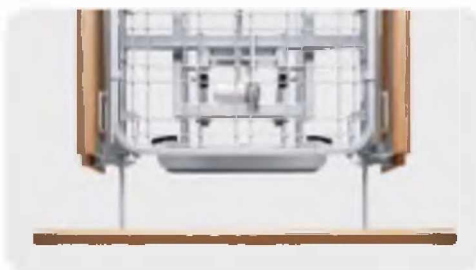

210 cm

Prodloužení lůžka 210 cm: s delšími postranicemi na konci nohou bez příslušenství a bez mezery > 318 mm*

220 cm

Prodloužení lůžka 220 cm: dočasně nastavitelné pomocí dělené postranice

Sentida sc má standardně integrovaný nástavec na lůžko, který splňuje normativní požadavky IEC 60601-2-52 v jakékoli konfiguraci.

Řešení 5

Distanční zarážka chrání lůžko před poškozením




K dispozici jsou distanční zarážky umístitelné na boku a v hlavové části lůžka, které chrání lůžko před poškozením při manipulaci.





Koncept: Seaview

Design G | Dekor Italian Oak



Uzpůsobeno pro...

- domovy pro seniory
- bydlení s asistenční pomocí
- zvláštní péči při mírných tělesných omezeních
- rodiny pečující o osobu s demencí



Technické údaje

Podle přílohy VII č. 13 směrnice o zdravotnických prostředcích (MDD) 2017/745
je pečovatelské lůžko Sentida zdravotnickým prostředkem třídy I.

Vnější rozměr lůžka (min./max.**)	205 × 103 / 208 × 104 cm
Vnitřní rozměr lůžka	90 × 200 cm – vhodné pro matrace o šířce 87–90 cm
Nastavení výšky	23–80 cm (v závislosti na typu koleček)
Úhel nastavení zádového dílu	70° ± 5°
Úhel nastavení stehenního dílu	30° ± 5°
Náklon TR/ATR	17° / 17°
Bezpečné pracovní zatížení*	270 kg (235 kg hmotnost klienta, 35 kg matrace + příslušenství)
Hmotnost lůžka	Přibliž. 115 kg podle modelu
Podjezdnost podvozku	15 cm
Dvojitá autoregrese	o 17 cm více prostoru na lůžku
Příprava na SafeSense 1+3	je součástí



* **Doporučení výrobce:** Maximální hmotnost klienta může být navýšena v závislosti na hmotnosti matrace a použitého příslušenství. Příklad:
Bezpečné pracovní zatížení 250 kg - matrace 10 kg - příslušenství 10 kg = max. hmotnost uživatele 230 kg. Při použití těžších matic/příslušenství je třeba odpovídajícím způsobem přizpůsobit hmotnost klientů.



** V závislosti na zvolené konstrukci hlavového/nožního čela






Barvy a dekory

Barvy | Dekory*

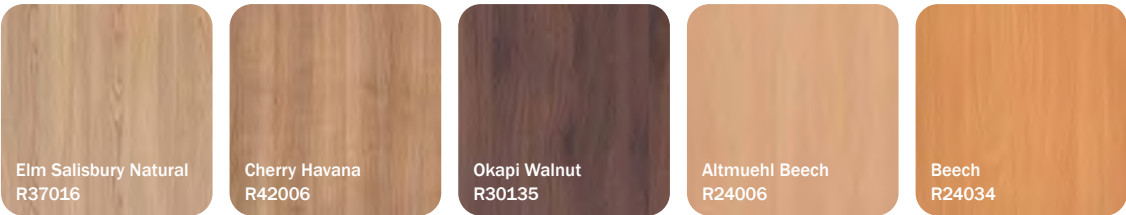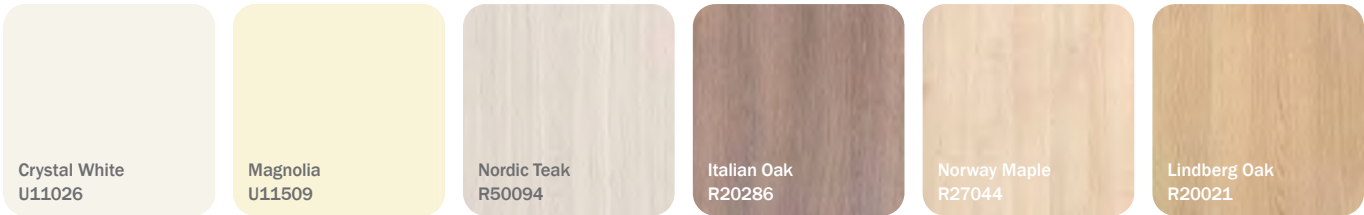

Možné kombinace



Syntetická kůže | měkký potah nebo hotel design pro hlavové / nožní čelo Df*



Tkanina | měkký potah nebo hotel design pro hlavové / nožní čelo Df*



Syntetická kůže: Smoke
Dekor: Nordic Teak

Tkanina: Sand
Dekor: Norway Maple



Design

Design | hlavová / nožní čela



Design A
Hlavové / nožní čelo



Design Ak
Hlavové / nožní čelo



Design Df
Hlavové / nožní čelo



Design Dfx
nožní čelo



Design C
Hlavové čelo



nožní čelo



Design G
Hlavové čelo



nožní čelo



Design Gx
nožní čelo



Design O
Hlavové / nožní čelo



Design Ox
nožní čelo



Design Ts
Hlavové čelo



nožní čelo



Design Tsx
nožní čelo

Měkký potah nebo hotelový design

Všechny vyobrazené dekory z látky a syntetické kůže jsou k dispozici buď v trvalém provedení jako hotelový design, nebo jako potahy, které si můžete sami snadno připevnit k hlavovému a nožnímu čelu* pečovatelského lůžka. Měkké potahy jsou extrémně odolné proti vlhkosti a nečistotám, odpuzují vodu a jsou prodyšné.



Výběr z modelů – domácí nebo extramobilní

Lůžko Sentida sc je k dispozici ve dvou modelových variantách – domácí nebo extramobilní.

Manipulace s ním je snadná – zejména v extramobilní variantě s většími kolečky pro ještě větší komfort při jízdě. To znamená, že i těžce postižení a imobilní klienti se mohou během pobytu na pečovatelském lůžku zapojit do života u sebe doma nebo v pečovatelském zařízení.

Obě modelové varianty mají centrální brzdu koleček a k ovládní stačí jeden pohyb nohou.



domácí – brzda na nápravě



extramobilní – centrální brzda

K dispozici také s průběžnými postranicemi nebo 4 postranicemi SafeFree®





Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika
tel.: +420 312 576 400 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



www.linet.cz

LINET

Eleganza Mano



Pacientský stolek k lůžku

Unikátní konstrukce patientského stolku umožňuje plné využití všech funkcí pacientem bez nutné asistence sestry. Díky tomu je Eleganza Mano efektivním prostředkem pro zvyšování samostatnosti pacienta, a zároveň pro snížení pracovní zátěže zdravotnického personálu.



- RUČNÍ OVLÁDÁNÍ KOLEČEK
- SAMOSTATNOST PACIENTA
- SNADNÝ PŘÍSTUP DO STOLKU
- ÚSPORA ČASU SESTRY
- SNADNÁ ČISTITELNOST

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ KOLEČEK

- Představuje patentované řešení společnosti Linet, které dovoluje snadné ovládání stolku pacientem z lůžka, a to s použitím jedné ruky.
- Pootočením ručního ovládání lze stolek zabrzdit či odbrzdit, pacient tak může se stolem snadno manipulovat a nastavit ho do vyhovující polohy.
- Vhodná pozice stolku umožňuje pacientovi plné a samostatné využití jídelní desky, zásuvek, poličky na podložní misku, držáku ručníku a všech odkládacích míst stolku.



Pootočením ručního ovládání lze stolek zabrzdit či odbrzdit.

SAMOSTATNOST PACIENTA

- Umožňuje pacientům vykonávat většinu denních potřeb samostatně.
- Posiluje sebedůvěru pacienta a jeho pocit soběstačnosti.
- Dovoluje pacientovi uspokojovat jeho bezprostřední potřeby bez nutnosti čekání na ošetřující personál.
- Snižuje počet případů, kdy je sestra přivolána pacientem.
- Snižuje fyzickou zátěž sester a redukuje množství stresujících situací způsobených častým voláním pacientů.



Spodní velká zásuvka je vybavena praktickým držákem lahví.



Pacient může jídelní desku využít také jako podložku pro čtení a psaní.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry:	48 x 57,5 cm
Výška horní desky	88,5 cm
Výška (včetně madla)	94,5 cm
Rozměry jídelní desky	60 x 33,5 cm
Výška jídelní desky (kolečka 7,5 cm)	72 – 109 cm
Maximální zatížení ve středu jídelní desky	9 kg
Kolečka	7,5 cm
Hmotnost	33 kg

Combinea



Pacientsky stolek k lůžku

Combinea – varianty podle přání

- MODULÁRNÍ ŘADA STOLKŮ
- ZABUDOVANÁ ZÁSUVKA NA TELEFON U NĚKTERÝCH MODELŮ
- 5. KOLEČKO PROTI PŘEVŘHNUTÍ U VELKÉ ZÁSUVKY
- SNADNÁ ÚDRŽBA
- ŘADA BAREVNÝCH VARIANT

Pacientské stolky Combinea tvoří variabilní řadu šesti modelů, které umožňují široké použití. Zaoblené rohy a hrany jsou bezpečné pro každodenní používání a ideální pro běžné čištění.

▪ *Plastová odnímatelná horní deska z ABS plastu pro snadnou údržbu*

▪ *Ochranné nárazové lišty okolo celého korpusu chrání stolek při transportu*

▪ *Dvojitá kolečka s průměrem 50 mm.*



Díky odnímatelným plastovým vložkám do zásuvek je možné tyto prostory snadno čistit.



Zásuvky i korpus stolu jsou vybaveny zaoblenými madly pro snadné uchopení.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Možnost výběru mezi dvířky nebo velkou zásuvkou; dvířka jsou vybavena závěsy otočnými o 270°.
- Zásuvka na telefon bez bočních vlysů je snadno přístupná z obou stran stolu.
- Čtyři dvojitá kolečka a páté kolečko u zásuvky.
- Držák na tři lahve integrovaný do vložky velké zásuvky.
- Odnímatelná horní ochranná deska.
- Snadno omyvatelná konstrukce.
- Pevná hliníková madla s atraktivní povrchovou úpravou.



Plastová ochranná krycí deska se zvýšenými okraji proti pádu předmětů s příjemným zaobleným tvarem.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- Stolek je také možné vybavit zámkem horní zásuvky.
- Na rozdíl od běžného nábytku je korpus stolků Combinea vyroben z desek s povrchovou vrstvou laminátu, což významně zvyšuje odolnost a usnadňuje hygienu stolu.
- Páté kolečko u dolní zásuvky stolu zajišťuje jeho stabilitu a chrání ho proti překlacení.
- Pacient má snadný přístup ke všem úložným prostorům stolu, čímž se zvyšuje samostatnost pacienta.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška – nízký stolek	80 cm
Výška – vysoký stolek	90 cm
Šířka – vč. ochranných lišt	48 cm
Šířka – korpus	41cm
Hloubka – vč. ochranných lišt	50 cm
Hloubka – korpus	45 cm
ABS díly	RAL 9002
(Horní krycí deska i ve variantě RAL 9006.)	

PASIVNÍ MATRACE

Portfolio

LINET

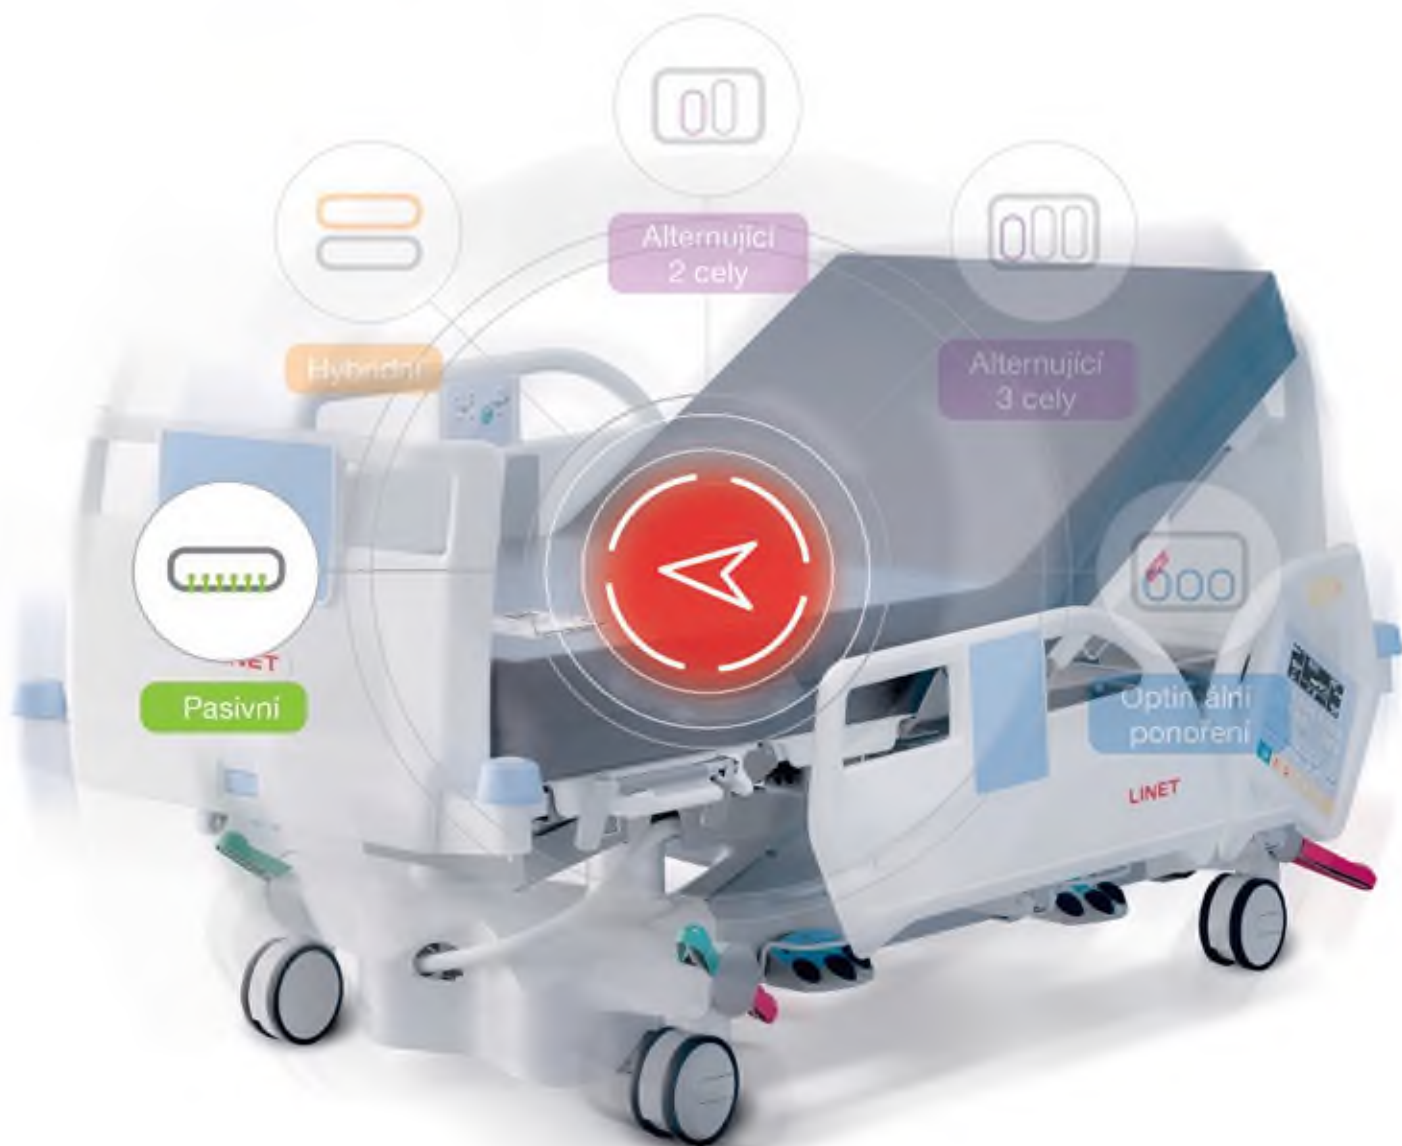

Pro pohodlí a bezpečnost

Matrace LINET podle vašich potřeb




Široký výběr



Široké spektrum pěn a provedení matrací pro různé potřeby nemocničních oddělení a domovů pro seniory. Na následujících stránkách si můžete vybrat vhodnou matraci pro své pacienty/klienty.


Vysoká kvalita materiálů

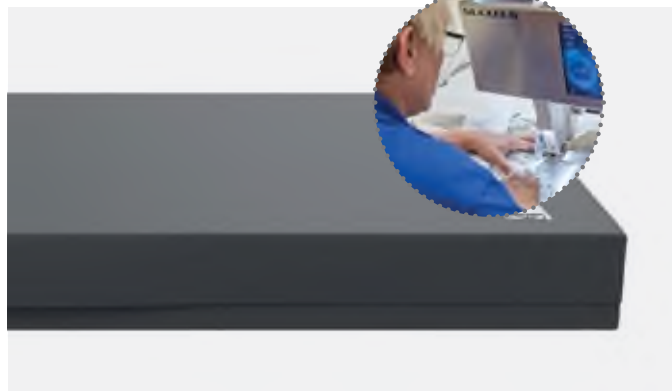

Pro výrobu matrací se používají ty nejvyšší kvality materiálů a celý proces splňuje mezinárodní normy. Systém řízení kvality certifikovaný podle DIN EN ISO 9001 a 13485. Systém environmentálního managementu certifikovaný dle DIN EN ISO 14001.




Hygiena a antibakteriální ochrana

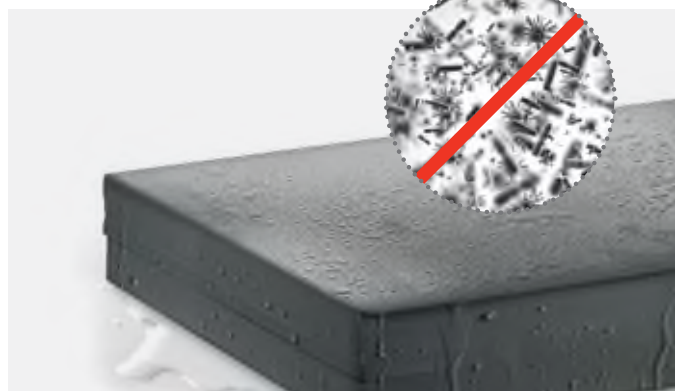

Matrace LINET jsou chráněny voděodolným a paropropustným potahem. Potah je antibakteriální, s dlouhou životností a stabilitou. Ložná plocha a boky jsou vyrobeny ze špičkového materiálu PERLASTIC® Silber* v souladu s normami pro hygienu lůžek v nemocnicích a pečovatelských zařízeních.

Bezpečí a pohodlí

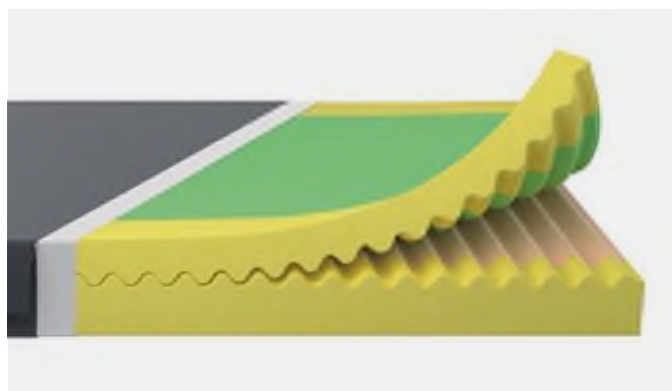

Matrace jsou navrženy tak, aby zlepšovaly redistribuci tlaku pomocí mechanismů zanoření a obklopení. Nabízejí také vysoký komfort při spánku a pobytu na lůžku.

* Platí pro MediMatt 30, ViskoMatt 10, 30, 50.

Zvolte vhodnou matraci

DEKUBITY		MÍRA		
		Zaměření této brožury		
		Mobilní		
Kategorie existujících dekubitů	III. – IV.			
	I. – II.			
	Vysoká			
	Medium		Progresivní řada pasivních matrací MediMatt	Prémiová řada pasivních matrací ViskoMatt
	Low	Základní řada pasivních matrací EffectaCare, PrimaCare		
Úroveň rizika				

MOBILITY PACIENTA

Částečně mobilní

Imobilní

Hybridní matrace

CliniCare 100HF

2celové alternující aktivní matrace

Air2Care

Progresivní 3celové alternující aktivní matrace

Virtuoso

Prémiové 3celové alternující aktivní matrace

Virtuoso

Aktivní matrace
s optimálním
zanořením

Opticare,
Opticare X

Tři segmenty pasivních matrací

Oblasti využití

Funkce


PRÉMIOVÉ

- Pacienti s vysokým rizikem vzniku dekubitů
- Částečně mobilní pacienti
- Standardní oddělení
- JIP a ARO (ViskoMatt 50)



Kombinace pěn nejvyšší kvality, určená speciálně pro intenzivní péči.

- **Účinná profylaxe dekubitů**
- Vynikající komfort při ležení a spaní
- Speciální studená pěna v pánevní oblasti pro mimořádně dlouhou životnost – i při vyšší hmotnosti pacienta

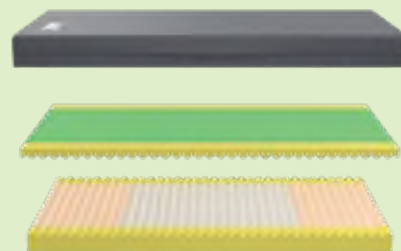

viskoelestická pěna



zpevněné okraje

PROGRESIVNÍ

- Pacienti se středním rizikem vzniku dekubitů
- Mobilní pacienti
- Standardní oddělení
- Domovy pro seniory
- Dlouhodobá péče



Kombinace studené a standardní PU pěny pro odlehčení tlaku.

- S vyztuženými okraji pro samostatnou mobilizaci pacienta
- **Dobrá redistribuce tlaku a vysoký komfort**
- Bezpečnost pro pacienta



studená pěna



zpevněné okraje

ZÁKLADNÍ

- Pacienti s nízkým rizikem vzniku dekubitů
- Mobilní pacienti
- Standardní oddělení
- Domovy pro seniory
- Dlouhodobá péče



Monoblokové pěnové matrace, určené pro pacienty s nízkým rizikem vzniku dekubitů.

- **Profilování pro lepší zanoření a obklopení**
- Vysoký komfort při spánku
- Dlouhá životnost



profilace pěny

Pěna


Viskoelastická pěna je často označovaná jako „**paměťová**“. Reaguje na tělesné teplo a hmotnost. Tělo se tak může do matrace mírně zanořit, což zajišťuje **optimální oporu a přizpůsobení** konturám těla. Výsledné odlehčení tlaku je nejlepší volbou pro prevenci dekubitů.



Studená pěna je materiál nejvyšší kvality díky více otevřeným pórům. **Zajišťuje vysokou prodyšnost** a příjemné podmínky pro spánek. Rychle se vrací do původního tvaru bez trvalé deformace.




Profilace standardní pěny snižuje její povrchové napětí a zvyšuje schopnost přizpůsobit se tvaru těla.




Potah

Potah PERLASTIC® Silber

- Vysoká profylaxe infekcí
- Dva úchopy pro optimální manipulaci
- Skrytý, extra silný zip
- Bielastický a tvarově stálý, dlouhá životnost
- Extra silný PU povlak, odolný proti bakteriím a virům
- Prodyšný
- Antimikrobiální
- Neobsahuje latex



Potah dokonale padne: bez záhybů pro vynikající prevenci dekubitů.



voděodolný



antibakteriální

Potah matrace těsně přiléhá k pěnovému jádru a chrání matraci i pokožku pacienta. Potah obsahuje řadu technických prvků, které tuto dvojí funkci podporují.

- Voděodolný
- Multistrečový
- Paropropustný
- Odolný proti plísním a mikrobakteriím




voděodolný



antibakteriální

Portfolio pasivních matrací

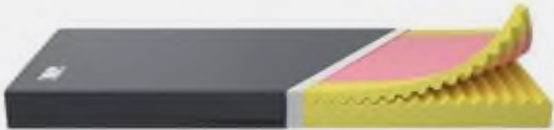		ZÁKLADNÍ			PROGRESIVNÍ
		EffectaCare 10 — Monobloková pěnová matrace s vlnovou profilací na obou stranách, díky čemuž lze pěnu obrátit uvnitř potahu.  šité švy 110 kg oboustranná	EffectaCare 20 — Monobloková pěnová matrace. Jádru má příčnou profilaci v sakrální oblasti. Spodní prořezání matrace usnadňuje její polohování.  šité švy 150 kg	PrimaCare 10 — Jednovrstvá matrace s příčným a podélným profilováním v horní části. Plně prořezaná pro ještě lepší konturování.  šité švy 200 kg	MediMatt 30 — Dvouvrstvá matrace s vysoce elastickou pěnou pro vysoký komfort. Horní vrstva je tvořena polyetherovou studenou pěnou a spodní, podpůrná část standardní polyetherovou pěnou.  šité švy 150 kg
		Monobloková pěna			2vrstvá pěna
Pěna matrace	Horní vrstva	14 cm, monoblok polyetherové pěny 28 kg/m³	14 cm, monoblok polyetherové pěny 33 kg/m³	14 cm, monoblok polyetherové pěny 41 kg/m³	5 cm, studená pěna 50 kg/m³
	Spodní vrstva				9 cm, polyetherová pěna 41 kg/m³
Vyztužené okraje		×	×	×	✓
Zip		180°	180°	180°	180°
Seříznuté rohy		×	×	✓	✓
Ergoframe		×	×	×	✓
Profilování horního povrchu		Svinutý	Částečně	Úplně	×
Max. hmotnost pacienta		110 kg	150 kg	200 kg	150 kg
Min. hmotnost pacienta		40 kg	40 kg	40 kg	30 kg
Záruka (roky)	Potah	2	2	2	4
	Pěna	1	1	2	4
2 transportní úchyty		×	×	×	✓
Evakuační potah (volitelně)		×	×	×	✓
Úroveň požární ochrany (pěna, potah)		Crib 5	Crib 5	Crib 5	Crib 5

PRÉMIOVÉ

ViskoMatt 10

— Základní model pro prevenci dekubitů s dobrou redistribucí tlaku. Viskoelastická horní část a polyetherová nosná vrstva.




svařované švy



150 kg

ViskoMatt 30

— Velmi dobré rozložení tlaku. Vysoce elastická a odolná matrace s horní antimikrobiální viskoelastickou pěnou a spodní vrstvou ze studené pěny.

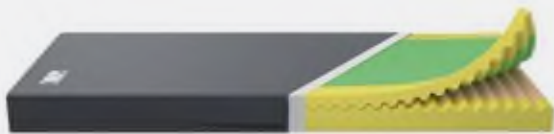


svařované švy



165 kg

ViskoMatt 50

— Vynikající odlehčení tlaku. Vysoce elastická a odolná matrace s horní antimikrobiální viskoelastickou pěnou a spodní vrstvou ze studené pěny.

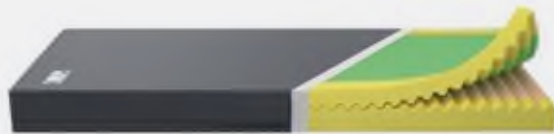

svařované švy



190 kg

Viskoelastická pěna

5 cm, viskoelastická pěna 52 kg/m³

9 cm, polyetherová pěna 41 kg/m³



180°



150 kg

30 kg

4

4



Crib 5

5 cm, viskoelastická pěna 85 kg/m³

9 cm, studená pěna 50 kg/m³ & 33 kg/m³



180°



165 kg

30 kg

4

6



Crib 5

7 cm, viskoelastická pěna 85 kg/m³

9 cm, studená pěna 80 kg/m³ & 33 kg/m³



180°



190 kg


30 kg

4

7



Crib 5



Spojení pěn bez lepených švů

- Rovnoměrné rozdělení tlaku bez tvrdých švů
- Maximální odlehčení tlaku



Zpevněné okraje

- Silné 10cm zpevnění v okrajích matrace:
- Snadná mobilizace pro pacienta
 - Výborná ochrana proti pádu



Značení

- Označení v souladu s UDI
- Podle požadavků MDR
 - Označení potahu i pěny pro snadnou dohledatelnost

Prémiové matrace ViskoMatt


ViskoMatt 50

Vrchní vrstva matrace ViskoMatt 50 je vyrobená z viskoelastické pěny, která zajišťuje vysokou míru pohodlí a zabraňuje vzniku dekubitů. Matrace

má také zesílenou pánevní oblast, což brání vzniku dekubitů způsobeným polohováním zádového dílu lůžka.

Oblast hlavy ze studené pěny (33 kg/m³)

Ložná plocha s antimikrobiální viskoelastickou pěnou (7 cm, 85 kg/m³)

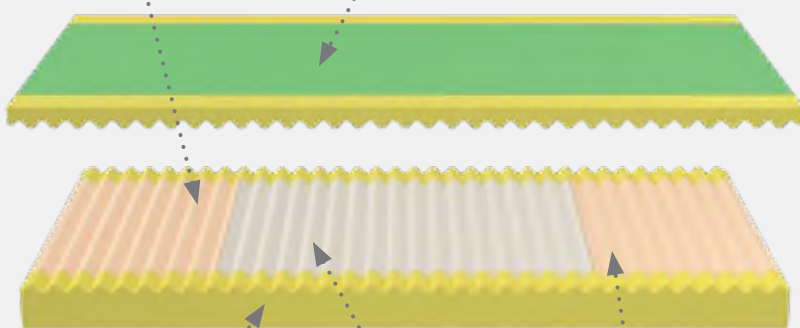

10 cm široké zesílené okraje


Oblast nohou ze studené pěny (33 kg/m³)

Spodní vrstva ze studené pěny v pánevní oblasti (9 cm, 80 kg/m³)

ViskoMatt 30

Matrace ViskoMatt 30 nabízí v průměru o 35 % vyšší odlehčení tlaku. Vysoce kvalitní pěny zajišťují

Oblast hlavy ze studené pěny (33 kg/m³)

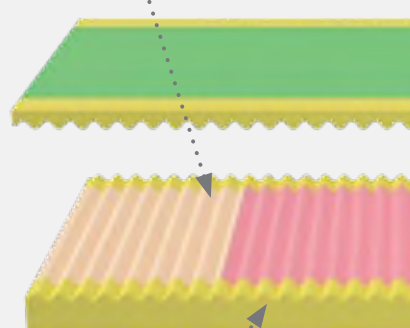

10 cm široké zesílené okraje


Proč viskoelastická = paměťová pěna

- Materiál si „pamatuje“ zátěž, a když člověk vstane, obrysy těla jsou stále viditelné.
- Jádro viskoelastických matrací se v závislosti na teplotě a hmotnosti individuálně přizpůsobí každé postavě.
- Tlak je rovnoměrně rozložen a tělo je ideálně odlehčeno = princip účinku profylaxe dekubitů.



Matt 30


vysokou stabilitu a vynikající odolnost. Kromě toho brání vzniku lokálních tlakových bodů.

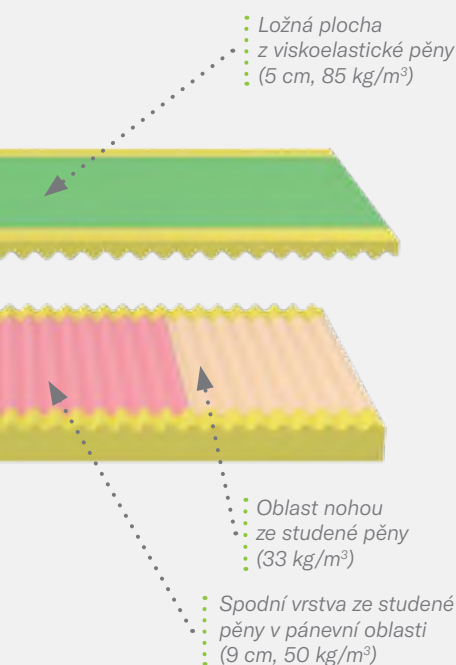

ViskoMatt 10

Matrace ViskoMatt 10 zajišťuje díky viskoelastické pěně optimální rozložení tlaku na všechny části těla, které jsou

v kontaktu s matrací, a výrazně tak snižuje riziko vzniku dekubitů.

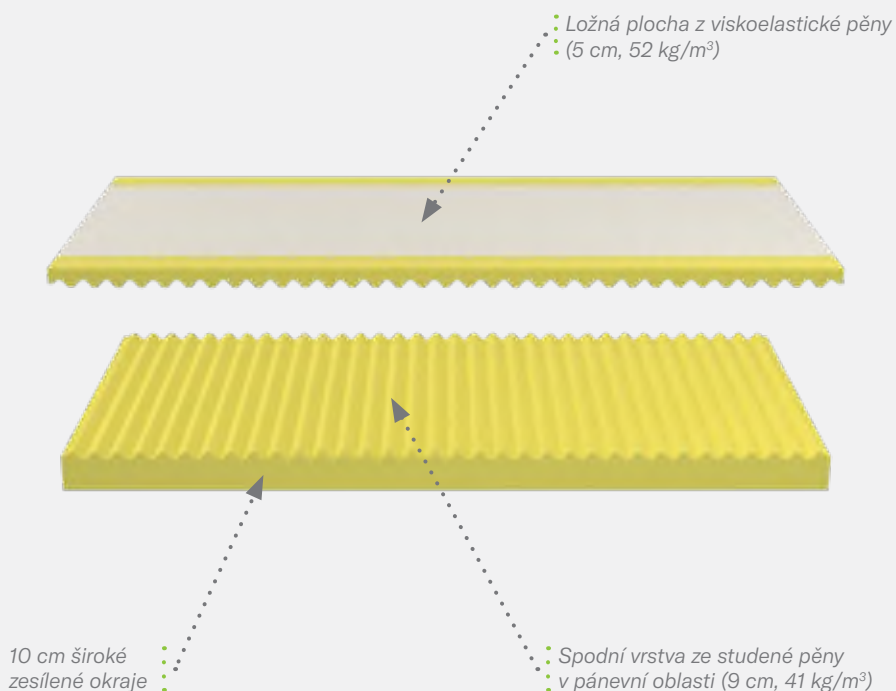

Proč studená pěna

Studená pěna vzniká technologickou úpravou standardní polyuretanové pěny. Vyrábí se při nižších teplotách, aby bylo dosaženo vynikajících vlastností.

- Studená pěna má více otevřené póry, a je díky tomu lépe prodyšná.
- Je odolná, pružná a tvarově stálá s vysokou úrovní elasticity.



Kvalita definovaná hustotou



Čím vyšší je hustota pěny, tím je:

- Vyšší obnovovací síla a větší uvolnění tlaku;
- Delší životnost matrace.

Hustota udává, kolik kilogramů pěny připadá na metr krychlový.


Příklad: hustota 60 = 60 kg/m³

Potah PERLASTIC® Silber

Pro MediMatt 30, ViskoMatt 10, 30 a 50. Celková gramáž 230 g/m².


Trikotová vložka mezi
potahem a jádrem pro
dlouhou životnost matrace

Potah se skládá ze dvou částí:
vnější PU potah a vnitřní
polyesterová textilie

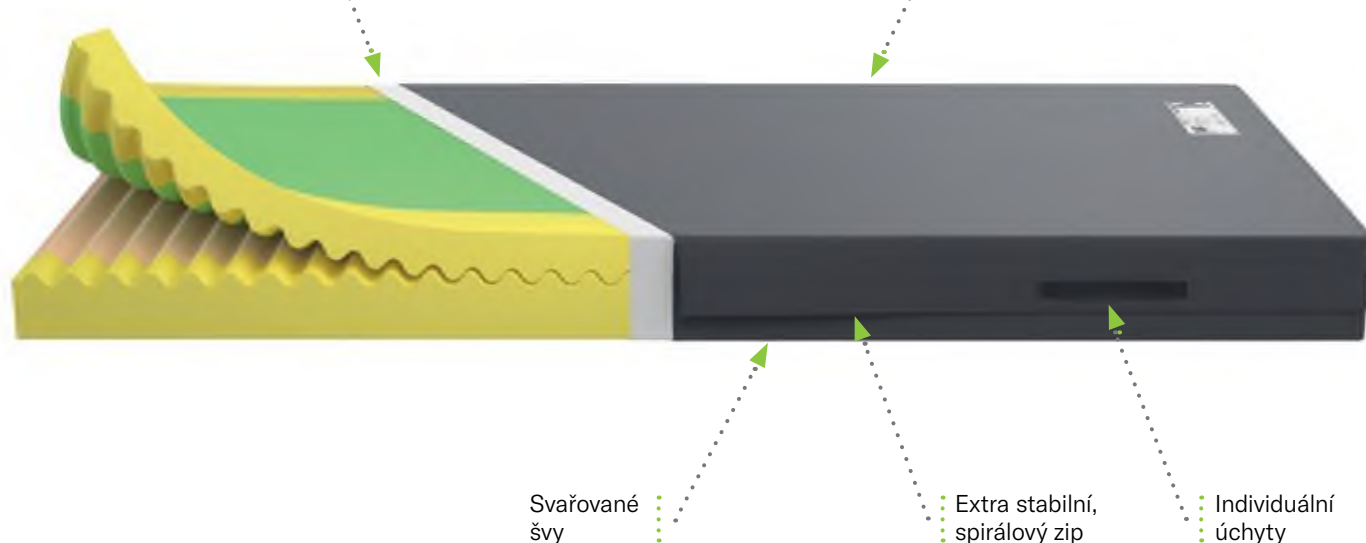

PU potah

- Extrémně odolný a oděruvzdorný. Trojitý potah s gramáží 90 g/m²
- Odolný proti bakteriím a virům (odolnost proti kapalinám podle ISO 1420 > 200 cm)
- Odolný proti tekutinám a stálý proti moči, krvi a olejům
- Antimikrobiální, obsahuje ionty zinku, které zabírají vzniku plísní
- Prodyšnost (propustnost vodních par podle ASTM 96-66 550 g/m² za 24 hodin při 38 °C)

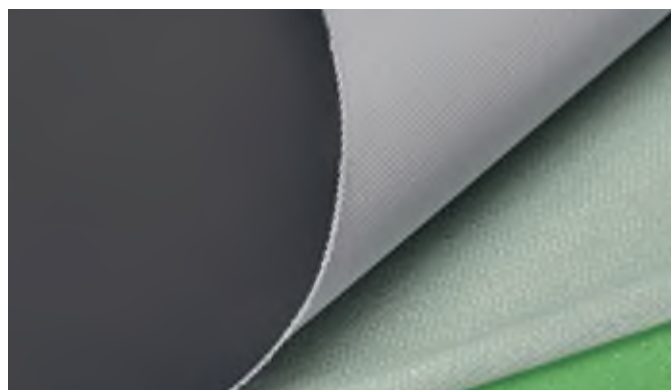

Díky trikotové vložce, která je mezi potahem a jádrem, lze potah snadno vyměnit. Snižuje třecí a střižné síly, čímž se prodlužuje životnost matrace.

Textilie zajišťuje

stabilitu a funkci PU potahu. Textilie je jemně tkaná s úzkými stehy, což zajišťuje vysokou odolnost, omezuje elasticitu a snižuje tvorbu záhybů. Vysoká gramáž 140 g/m².

Volitelné: Evakuační potah PRO

Nejlepší řízení rizik: jednoduchá a rychlá evakuace v kombinaci s nejvyššími hygienickými standardy.



Hygiena

- Plná ochrana potahu: ložná plocha a boky jsou vyrobeny z materiálu PERLASTIC® Silber
- Zasunuté popruhy: ochrana proti bakteriím na těžko přístupných místech



Mimořádně široký okraj po celém obvodu chrání nosný systém před znečištěním.

Bezpečná evakuace

- 2 optimálně umístěné popruhy pro fixaci pacienta
- Široké přezky pro optimální nastavení pásu
- Vhodné pro pacienty o hmotnosti do 250 kg



Dlouhé popruhy v hlavové a nožní části lze rychle rozložit. Umožňují jednoduchou evakuaci jednou osobou.

Rozměry matrací (cm)

EffectaCare 10	200 × 86 × 14	190 × 86 × 14
	200 × 90 × 14	190 × 90 × 14
EffectaCare 20	200 × 86 × 14	190 × 90 × 14
	200 × 90 × 14	142 × 70 × 10
	190 × 86 × 14	137 × 70 × 10
PrimaCare 10	200 × 86 × 14	190 × 86 × 14
	200 × 90 × 14	190 × 90 × 14
MediMatt 30	200 × 86,5 × 14	208 × 96 × 14
	200 × 90 × 14	208 × 96 × 14
	190 × 86,5 × 14	208 × 88 × 14
	190 × 90 × 14	200 × 114 × 14
	200 × 100 × 14	200 × 79 × 14
ViskoMatt 10	220 × 86,5 × 14	190 × 79 × 14

ViskoMatt 10	200 × 90 × 14	208 × 88 × 14
	190 × 86,5 × 14	142 × 70 × 10
	190 × 90 × 14	137 × 70 × 10
	208 × 96 × 14	200 × 114 × 14
	200 × 100 × 14	200 × 79 × 14
ViskoMatt 30	220 × 86,5 × 14	190 × 79 × 14
	200 × 86,5 × 14	208 × 96 × 14
	200 × 90 × 14	208 × 96 × 14
	190 × 86,5 × 14	208 × 88 × 14
	190 × 90 × 14	200 × 114 × 14
ViskoMatt 50	200 × 100 × 14	200 × 79 × 14
	220 × 86,5 × 14	190 × 79 × 14
	200 × 86,5 × 16	208 × 96 × 16
	200 × 90 × 16	208 × 96 × 16
	190 × 86,5 × 16	208 × 88 × 16
	190 × 90 × 16	220 × 86,5 × 16
	200 × 100 × 16	200 × 114 × 16



wissner-
bosserhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



www.linet.cz


ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

** Evakuační podložka Vám zajistí možnost rychlého přesunu částečně nebo plně imobilních uživatelů v případě potřeby (požár, zakouření místnosti či budovy, povodeň atd.)*

** Evakuaci je schopen provádět každý člen Vašeho pracovního týmu, již po prvním zaškolení. Evakuační podložka je nehořlavá a velmi odolná, v běžném provozu prakticky nezničitelná*

** Evakuační podložku dodáváme s návodem na použití a samolepkou, kterou si můžete označit lůžko, případně pokoj vybavený tímto záchraným systémem.*

** Podložka je kompatibilní s následujícími rozměry matrací:
(200 X 75 - 95 cm)*

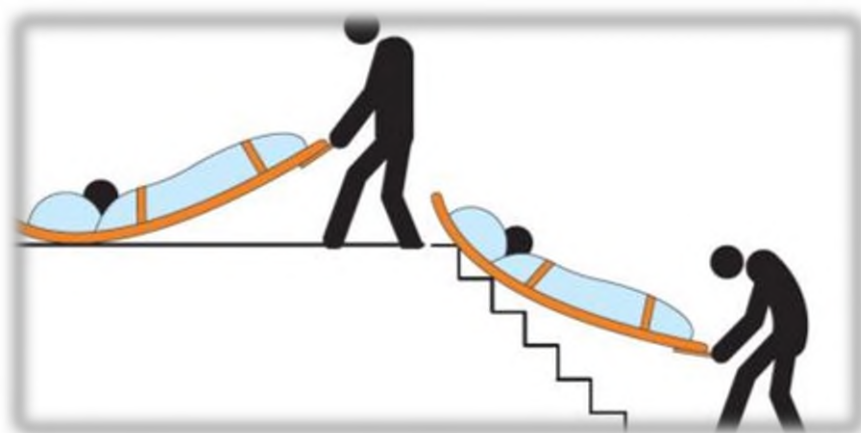



Companion^{mini pro}

Bezdrátový monitorovací systém příznaků
epileptického záchvatu



www.aposbrno.cz

Obsah

Obsah.....	2
Informace o výrobku.....	3
<i>Prvky Companion Mini Pro</i>	<i>3</i>
Obsah balení	4
Instalace přístroje	5
<i>Zapnutí Companion mini^{pro} (Monitor)</i>	<i>5</i>
<i>Vypnutí Companion^{mini pro} (Monitor)</i>	<i>5</i>
Pager P137 (dodáván samostatně)	6
<i>Zapnutí pageru</i>	<i>6</i>
<i>Hlášení poplachu/alarmu na pageru.....</i>	<i>6</i>
<i>Vypnutí pageru</i>	<i>6</i>
<i>Pokyny k párování zařízení.....</i>	<i>7</i>
<i>Resetovací tlačítko.....</i>	<i>8</i>
<i>Umístění a nastavení.....</i>	<i>9</i>
Provoz systému	10
<i>Režim alarmu.....</i>	<i>10</i>
Tabulka záznamů o pravidelné funkční kontrole	11
Pokyny k údržbě	12
<i>Pravidelné přezkoušení.....</i>	<i>12</i>
<i>Čištění přístrojů.....</i>	<i>12</i>
<i>Výměna baterie u Companion^{mini} nebo v resetovací jednotce</i>	<i>12</i>
<i>Program pro úpravu nastavení.....</i>	<i>13</i>
<i>Použití programu</i>	<i>13</i>
<i>Specifikace resetovacího tlačítka.....</i>	<i>14</i>
<i>Specifikace Companion Mini</i>	<i>14</i>
Důležité informace	15

Informace o výrobku

Companion Mini Pro přináší pocit bezpečí pečovatелům i pacientům trpícím epilepsií.

Tento výrobek je určen k diskrétnímu sledování aktuálního stavu uživatele za pomoci vysoce výkonných senzorů, které rozpoznávají pohyby, jež by mohly souviset se záchvatem.

Monitor dokáže pomoci při následujících typech záchvatů:

- tonicko-klonický
- parciální
- generalizovaný

V takových případech výrobek upozorní pečovatele prostřednictvím bezdrátového systému Alert-it Safelink®. Ten za použití rádiového přijímače 2. třídy spolehlivě detekuje neporušenost rádiového signálu. V případě jeho selhání zazní alarm, na který pečovatel musí zareagovat, neboť uživatel nebude až do vyřešení problému chráněn.

Prvky Companion Mini Pro

Klíčové prvky senzoru Companion Mini:

- Naše spolehlivá bezdrátová technologie Safelink®
- Rádiový dosah min. 450 m
- Digitální senzor pohybu
- Životnost baterie min. 1 rok
- Antimikrobiální plastový kryt Biomaster®
- Tepelně odolný
- Zabezpečení proti zásahům zvenčí

Obsah balení

A.



B.



C.



D.



E.



F.



- A. 1x P176 Companion Mini (Monitor) + 2x náhradní baterie AAA (LR03)
- B. 1x P176B resetovací tlačítko + 2 ks AAA baterií
- C. 2 ks stahovací pásy a 2 ks podložek pro fixaci monitoru
- D. 2 ks samolepek na fixaci resetovacího tlačítka
- E. USB kabel
- F. Molitanová kostka s lepícími kolečky

Instalace přístroje

Zapnutí Companion mini^{pro} (Monitor)

Monitor Companion mini pro je dodáván v energeticky úsporném režimu. Monitor je nutno aktivovat a uvést do zkušebního režimu. Aktivujte stiskem tlačítka "Test" na přední straně pomocí ostrého předmětu, např. propisovací tužkou (obrázek 1), obvykle hrotem tužky. Uvnitř se rozsvítí a bliká zelená dioda, která signalizuje, že jednotka je nyní zapnutá a nachází se ve zkušebním režimu. Nyní po dobu 60 sekund lze snímací jednotku umístit na vhodné místo pod matraci (viz kapitola o umístění snímací jednotky). Po ukončení zkušební fáze kontrolka zhasne a začne blikat až poté, co jsou detekovány příslušné pohyby



Obr 1.

Vypnutí Companion^{mini pro} (Monitor)

Monitor může pracovat déle než rok za plného provozu. Pokud je potřeba monitorování z nějakého důvodu vypnout na delší dobu, stačí stisknout a podržet po dobu cca 8 sekund tlačítko "Test". Červená kontrolka bude cca jednu sekundu rychle blikat a pak zhasne, zařízení je vypnuto.

Upozornění:

Pokud monitor Companion mini vypnete, tak se na spárovaných zařízeních (pagerech) po dvou minutách objeví alarmové hlášení "RF Chyba". Je to z toho důvodu, že pager nepřijímal v intervalech 8 sekund pravidelné signály Safelink tak, jak by předpokládal. Aby k tomuto varovnému hlášení nedocházelo, je třeba zrušit párování nebo deaktivovat hlášení na pageru.

Pager P137 (dodáván samostatně)

Zapnutí pageru

Upozornění: Přestože pager je dodáván s částečně nabitými bateriemi, doporučujeme jej před použitím nabít.

Podržte tlačítko MENU po dobu 3 sekund, displej se rozsvítí a zobrazí se zpráva „Baterie“ s vyznačením stupně nabití

Pokud je monitorovací zařízení Companion Mini Pro aktivní a v radiovému dosahu, objeví se každých 8 sekund jeho jméno na displeji



Hlášení poplachu/alarmu na pageru

Pokud monitor vyšle signál poplachu je na displeji pageru zobrazeno:

Jméno uživatele/umístění a „NOUZE 01“

Vypnutí pageru

Vstupte do nabídky podržením tlačítka MENU po dobu cca 3 sekund. Po zobrazení „Seznam“ zmáčkněte 2x šipku doprava až na funkci „Vypnout“. Stiskněte tlačítko SEL /šipka nahoru a vypnete pager.

Poznámka: Baterie pageru má výdrž cca 3 dny v závislosti na počtu alarmů. Pokud bude kapacita baterie méně než 10%, na displeji pageru se objeví zpráva „Bat<10%“. Pokud bude kapacita minimální, objeví se varování doprovázené zvukovým signálem. Nabití do plné kapacity trvá cca 8-12 hodin. Více informací najdete v samostatném stručném návodu na pager. Více viz příručka k ovládání pageru (dodávána s pagerem jako samostatný návod pro uživatele)

Pokyny k párování zařízení

Systém je dodáván již funkční, tj. spárovaný (snímací jednotka s pagerem), pokud tomu tak není, postupujte následovně:

Nejprve se přesvědčte, že je snímací jednotka zapnuta.

Přepněte pager do módu AutoPrid (automatické přidání jednotky) a to tak, že stisknete tlačítko "Menu" po dobu 3 sekund a tím se dostanete do nabídky "Nastav&Uprav". Pak pravou šipkou rolujte vpravo až na požadavek hesla (Pass=0000). Nastavte heslo **1900** pomocí šipek nahoru resp. Dolů, čímž změníte požadovanou hodnotu na dané pozici, pak šipkou vpravo přejděte na druhou pozici a poté potvrďte nastavené heslo levým tlačítkem (OK).

Dále je třeba v nabídce na displeji rolovat šipkou vpravo na funkci "AutoPrid", pomocí šipky nahoru vybrat tuto funkci a pak potvrdit levou šipkou (OK).

Během cca 10 sekund by měl pager zapípat a opustit volbu AutoPrid. Na displeji se zobrazí továrně nastavený název spárovaného monitoru. Název lze přejmenovat stejným způsobem, jako se nastavovalo nové heslo.

Resetovací tlačítko

Resetovací tlačítko je určeno k resetu volání /zrušení volání/ na pager, který byl aktivován signálem monitoru.

Doporučuje se umístit tlačítko Resetu co nejbližší k monitoru a zafixovat buď pomocí vrutů (nejsou součástí dodávky) nebo samolepek (dodány).

Vlastní zrušení/reset je proveden zmáčknutím v místě tlačítka „Press“. Tím je volání/Alarm z monitoru na pager(y) zrušeno. Pokud je záchvat nadále detekován, tak volání na pagery je znovu aktivováno.

Resetovací tlačítko je napájeno dvěma AAA bateriemi, které by se měly měnit zároveň s bateriemi v monitoru (viz návod k údržbě).

Přípevnění resetovacího tlačítka



Na obrázcích je znázorněno přípevnění zadního krytu resetovacího tlačítka pomocí samolepek. Nejprve je třeba přilepit samolepky na sejmutý zadní kryt tlačítka a pak smontované tlačítko přilepit na vhodné místo.

Umístění a nastavení

Krátkým stisknutím tlačítka „test“ na monitoru spustíte 60-ti sekundový zkušební režim.

Zkušební režim znamená, že je na dobu 60 sekund vyčleněn čas pro hledání vhodného umístění monitoru. Pokaždé, kdy monitor detekuje pohyb, tak je vyslán na pager testovací kód. To umožňuje najít nejvhodnější umístění. Postupujte přitom následovně:

Provizorně umístěte monitor pod matraci bez jakéhokoliv upevnění.

Při simulaci pohybu nebo chvění vydává pager alarm Pomoc 01 a příslušný tón.

Monitor funguje nejlépe, je-li umístěn pod uživatelem. Avšak vzhledem k různým typům matrací a postelí je vhodné, abyste před upevněním přístroje na konkrétní místo vyzkoušeli různá umístění.

Postel poplácejte rukou nebo na ni zatlačte, k simulaci pohybů při záchvatu.

Pokud jste spokojeni s tím, jak monitor reaguje na každé zatlačení/poplácání matrace, můžete jej upevnit na místo za pomoci dodaných suchých zipů nebo stahovacích pásek.

Pomocí oboustranných lepících koleček přilepte pěnový hranol na dolní plochu senzoru. A umístěte pod matraci.

Pro použití stahovacího pásu musíte nejprve sejmut základnu. Hrot plochého šroubováku zasuněte do otvoru vedle USB konektoru, mírně zatlačte a otočte.

Základna se tím uvolní. Stahovací pásek pak provlékněte otvory dle obr. 3 a 4.



Obr. 3 Obr. 4



V případě potřeby lze základnu přišroubovat k posteli přes otvory v základně (šrouby nejsou součástí balení).

Je možné shlédnout video o připevnění na youtube kanálu:

https://www.youtube.com/watch?v=mc-6aQtSvdk&ab_channel=Alert-iTCareAlarms

Pro více informací se spojte se zákaznickou podporou APOS Brno s.r.o.

www.aposbrno.cz, tel. 541 217 516

Provoz systému

V tuto chvíli byste měli mít monitor připevněný k posteli, pager by měl být zapnutý a každých 8 vteřin přijímat signál Safelink®, což signalizuje, že se objeví každých 8 sekund jeho jméno na displeji pageru.

Nyní, pokud monitor zachytí nadměrný pohyb v posteli po dobu delší 15 sekund, přejde do režimu alarmu.

Režim alarmu

Při zaznamenání déle trvajících pohybů se v důsledku signálu z monitoru se rozsvítí červené světlo (LED) alarmu na pageru, zazní zvukový signál a přístroj začne vibrovat (pokud není vibrace vypnuta).

Stisknutím tlačítka SEL dočasně na cca 5 minut ztišíte zvukový signál a zastavíte vibrace pageru.

Tabulka záznamů o pravidelné funkční kontrole

Výrobní číslo:

Test	Podpis	Datum
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

Pokyny k údržbě

Pravidelné přezkoušení

Doporučujeme systém každý týden přezkoušet napodobováním pohybů při záchvatu po dobu 15 sekund (předem nastavená doba, pokud nebyla přeprogramována) a ujistit se, že došlo k vyslání alarmu na pager.

Čištění přístrojů

Dále doporučujeme pravidelně čistit obě jednotky utřením navlhčenými vatovými tampony (dokonale vyždímanými) a slabým čisticím roztokem (0,5 % saponátu na mytí nádobí) nebo alkoholem, případně dětskými čisticími ubrousky. Dbejte, aby do mikro-USB konektoru nevnikla žádná tekutina.

Výměna baterie u Companion^{mini} nebo v resetovací jednotce

Sejměte základnu monitoru dle obr. 3 výše nebo obr. 7 a 8 níže. Při výměně 2 baterií AAA věnujte pozornost znaménkům + a - na krabičce (obr. 5). Po výměně baterie je NEZBYTNÉ monitor znovu zapnout stisknutím TESTovacího tlačítka a vyčkat 60 sekund do konce zkušebního režimu.



Obr. 5.



Obr. 6.

Otevření jednotky na místě

Pokud je jednotka přišroubovaná k rovnému povrchu, k sejmutí krytu zasuňte hrot plochého šroubováku do otvoru vedle konektoru USB, mírně zatlačte a otočte. Viz obr. 7 a 8.



Obr. 7.



Obr.8.

Program pro úpravu nastavení

Změna nastavení na Companion Mini

Všechna zařízení Companion Mini jsou dodávány se základním nastavením:

Střední senzitivita /Medium sensitivity/

Zpoždění signálu 15 sekund (signál bude vyslán 15s po detekci)

Program Profile Editor (Alert-iT Profile Editor v2.0.4.zip) lze stáhnout volně z webových stránek:

<https://alert-it.co.uk/reseller/profile-editor/>

Instalace dle instrukcí (v anglickém jazyce), připojení pomocí USB kabelu.

Použití programu


Připojte zařízení pomocí USB kabelu k počítači, uvedete do testovacího módu.

Spustíte program na můžete nastavit

Citlivost (Sensitive) -2 velmi vysoká, 4 nejmenší citlivost

Zpoždění v sekundách lze nastavit po 05 sekundách

Uložení do zařízení (save to device), na disk nebo obnova nastavení z disku (restore from disc)

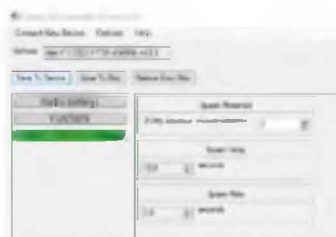

Specifikace resetovacího tlačítka

Konektor	B-Micro USB 2.0
Hmotnost:	54 g
Materiál:	Bílý ABS Antimikrobiální
Rozměry (mm):	100 x 45 x 15 (v x š x h)
Baterie:	2x AAA nenabíjecí
Životnost baterie:	3 roky
Provozní teplota:	5 - 35°C
Vlhkost:	max. 90% Nekondenzační
Frekvence:	434.075Mhz @ 10mW

Specifikace Companion Mini

Spoje:	B-Micro USB 2.0
Hmotnost:	54 g
Materiál:	Bílý ABS Antimikrobiální
Rozměry (mm):	100 x 45 x 15 (v x š x h)
Baterie:	2x AAA (LR03) nedobíjecí
Životnost baterie:	12 měsíců
Provozní teplota:	5 - 35°C
Vlhkost:	max. 90% Nekondenzační
Frekvence:	434.075Mhz @ 10mW

- Systém vyhovuje směrnici 93/42/EHS jako zdravotnický prostředek 1. třídy pro domácí použití
- Systém splňuje normu EN60601 pro bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů 2. třídy a nevyžaduje ochranné uzemnění, dále splňuje normu EMC pro bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů 1. skupiny a třídy B k domácímu použití
- Systém obsahuje rádiové zařízení splňující normu EN300-220, pracující v kmitočtovém rozsahu 434.075MHz, o výkonu 10mW (třída 8), činitel využití méně než 1 % (třída 2) a kompatibilní přijímač 2. třídy



Žádná ze součástí zařízení, včetně baterií, nesmí být zlikvidována jako odpad z domácnosti. Pro více informací k likvidaci kontaktujte APOS Brno s.r.o.

Důležité informace



Tento symbol označuje, že na použití tohoto zařízení se vztahují jistá upozornění a varování. Než začnete přístroj používat, je nutné, abyste si pozorně přečetli a pochopili tento návod k použití.

1. Zkontrolujte vedení kabelu, aby nedošlo k nebezpečí klopýtnutí.
2. Pravidelně kontrolujte zdroje napájení, zda nejsou poškozené a neohrožují nebezpečí elektrického šoku.
3. Zkouškou zkontrolujte funkčnost alarmu v místě pobytu pečovatele.
4. Každou součást pravidelně čistěte a dezinfikujte dle pokynů uvedených v Pokynech k údržbě
5. Pravidelně přezkoušejte senzory dle pokynů uvedených v tomto návodu.
6. Používejte pouze doporučené zdroje napájení a baterie.
7. Při nabíjení musí být pager nezakrytý a manipulace se zdroji napájení musí probíhat mimo dosah zdrojů přímého tepla.
8. Jako u všech zdravotnických elektronických zařízení je možné, že zařízení bude narušovat fungování jiného elektrického nebo elektronického zařízení, případně jiné elektrické nebo elektronické zařízení může narušovat fungování tohoto zařízení. Proto se vyvarujte umístění monitoru, senzoru nebo spojovacího kabelu v blízkosti citlivých elektronických přístrojů nebo přístrojů vyzařujících silné elektromagnetické pole, jako jsou např. rozhlasová vysílací zařízení, mobilní telefony nebo elektrické kabely.
9. Monitor používejte pouze s doplňky schválenými k používání společně s tímto výrobkem a pouze v souladu s pokyny.
10. V případě provedení jakýchkoli úprav na zařízení je nezbytné zařízení náležitě zkontrolovat a přezkoušet, k zajištění jeho dalšího bezpečného používání.
11. Pečovatel musí posoudit rizika a určit, zda je spolehlivost monitoru na dostatečné úrovni, nebo zda je potřebné další sledování. Spojte se s výrobcem a požádejte o pomoc při vyhodnocování rizika za pomoci Nástrojů k vyhodnocení rizika.
12. Některé poruchy si mohou vyžadovat další úroveň mechanické ochrany. Pro radu se obraťte na výrobce.
13. Pečovatel nikdy nesmí rušit alarm bez zkontrolování zdravotního stavu uživatele.
14. Některé doplňky jsou připevněny malými šroubky a nacházejí se v plastových sáčkích. Zajistěte, aby se nedostaly do rukou zranitelným osobám, jimž by hrozilo riziko udušení.

Systém Alert-it byl navržen s náležitým ohledem na spolehlivost a neporušenost. Přestože nabízí vysoce spolehlivý způsob sledování, vždy může z různých důvodů (včetně poruchy) dojít k situaci, že stav nouze zůstane nezaznamenaný. V život ohrožujících situacích doporučujeme používat systém Alert-it společně s dalšími monitorovacími technikami (např. videem). Výrobce ani jeho zástupce nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za dodání systému, jenž je neomylný. Pečovatel je povinen vyhodnotit rizika spojená s používáním tohoto přístroje a veškerých s ním souvisejících zařízení.



APOS Brno s.r.o.
Kotlanova 3a
628 00 Brno

Tel. 541 217 516

www.aposbrno.cz



Uživatelský návod pro Companion mini Pro rev 1.1.0

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Barevné domky Hajnice

Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova

Soupis:

SO 01-008 - Interiér

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 718 130,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 238,00	21,00%	85 519,98
DPH snížená	2 310 892,00	15,00%	346 633,80

Cena s DPH

v CZK

3 150 283,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Barevné domky Hajnice
Objekt: SO 01 - Ubytovací budova
Soupis: SO 01-008 - Interiér

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel:

Datum: 6. 5. 2020
Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 718 130,00
D1 - SO-01: Ubytovací budova	2 718 130,00
D3 - Zdravotnické vybavení	2 718 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Barevné domky Hajnice
Objekt: SO 01 - Ubytovací budova
Soupis: SO 01-008 - Interiér

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel:

Datum: 6. 5. 2020
Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 718 130,00

D D1 SO-01: Ubytovací budova 2 718 130,00

D D3 Zdravotnické vybavení 2 718 130,00

64	K	Z01	Postel polohovatelná	ks	30,000	51 196,00	1 535 880,00	
65	K	Z02	Noční stolek pojízdný	ks	36,000	10 908,00	392 688,00	
70	K	Z07	Postel polohovatelná - laterální náklon	ks	7,000	110 716,00	775 012,00	
71	K	Z08	Pacientský stolek	ks	1,000	14 550,00	14 550,00	

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:								
Zástupci kupujícího:								
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav obalů zboží	Výsledek montáže, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	školení personálu, včetně vystavení protokolu a protokolu opravňujícího provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

V _____, dne _____

zástupce prodávajícího
 (jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 1.
 (jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 2.
 (jméno, razítko a podpis)

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)****Veřejná zakázka: BD Hajnice - dodávka lůžek a nočních stolků II****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, [REDACTED]

Profil zadavatele:https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Z01 Postel polohovatelná - 4 dílná ložná plocha, Parametr - kryt podvozku: Může uchazeč nabídnout lůžko bez krytu podvozku? Námi nabízené lůžko je konstrukčně vyrobené tak, že na podvozku lůžka nemá žádné motory či jiné mechanismy, které by potřebovaly zakrýt.

Odpověď na dotaz č. 1: Ano, uchazeč může nabídnout lůžko bez krytu podvozku.

Dotaz č. 2: Z01 Postel polohovatelná - 4 dílná ložná plocha, Parametr - nastavení výšky (nejnižší poloha do 30cm) - elektricky: Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s elektrickým zdvihem ložné plochy od 40cm? Díky zdvihu od 40cm disponujeme zdvihem 45cm a můžeme zadavateli nabídnout výšku nastavení až do 85cm, která je velmi vhodná pro vyšetření pacienta na lůžku.?

Odpověď na dotaz č. 2: Ne, zadavatel trvá na minimální výšce lůžka 30 cm.

Dotaz č. 3: Z02 Noční stolek pojízdný, Parametr – výška 80 cm: Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek o výšce 88cm?

Odpověď na dotaz č. 3: Ano, uchazeč může nabídnout noční stolek o výšce 88 cm.

Dotaz č. 4: Z02 Noční stolek pojízdný, Parametr – dvojitá kolečka s průměrem 50 mm, dvě brzditelná: Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s dvojitými kolečky o pr.65 mm, všechna kolečka brzditelná?

Odpověď na dotaz č. 4: Ano, uchazeč může nabídnout noční stolek s dvojitými kolečky o pr.65 mm, všechna kolečka brzditelná.

Dotaz č. 5: Z02 Noční stolek pojízdný, Parametr – ochranné nárazové hrany po obvodu: Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek bez ochranné nárazové hrany po obvodu?

Odpověď na dotaz č. 5: Ne, zadavatel požaduje nárazovou hranu, nebo nárazové prvky po obvodu.

Dotaz č. 6: Z08 Pacientský stolek k lůžku, Parametr – kolečka s ručním ovládáním: Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek se čtyřmi samostatně brzditelnými kolečky s nožním ovládáním?

Odpověď na dotaz č. 6: Ano, zadavatel připouští nohou brzditelná kolečka s nožním ovládáním.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 4. 2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. Příloha č. 6 - IN.010 Kniha specifikací lůžka II-rev1 ve znění dodatečné informace č. 1

V Hradci Králové dne 4. 4. 2023



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)****Veřejná zakázka: BD Hajnice - dodávka lůžek a nočních stolků II****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, [REDACTED]

Profil zadavatele:https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Položka Z01 Matrace

Zadavatel požaduje nosnost min. 200 kg. Bude zadavatel akceptovat matrace s minimální nosností 150 kg?

Odpověď na dotaz č. 1: Ano, min. nosnost matrace se snižuje na 150 Kg.

Dotaz č. 2: Položka Z01 Postel polohovatelná - 4 dílná ložná plocha

Zadavatel požaduje postranice proti pádu, dřevěné dělené na půl, bez středového sloupku. Bude zadavatel akceptovat dělené hliníkové postranice s dřevěnými madly?

Odpověď na dotaz č. 2: Ano, postranice mohou být z kovu, ale dále trváme na napůl dělených postranicích bez středového sloupku.

Dotaz č. 3: Položka Z02 Noční stolek pojízdný

Zadavatel požaduje výšku 80 cm, s tolerancí 10 %. Bude zadavatel akceptovat výšku stolku 92 cm?

Odpověď na dotaz č. 3: Ano, změna parametrů výšky stolku: min výška je 80 cm s tolerancí 10%, max výška je 100 cm.

Dotaz č. 4: Položka Z07 Matrace

Zadavatel požaduje nosnost min. 200 kg. Bude zadavatel akceptovat matrace s minimální nosností 150 kg?

Odpověď na dotaz č. 4: Ano, min. nosnost matrace se snižuje na 150 Kg.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 5. 2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. Příloha č. 6 - 010 Kniha specifikací lůžka II-rev2 ve znění dodatečné informace č. 2

V Hradci Králové dne 19. 4. 2023



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření