

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v aktuálním znění

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zástupce ve věcech technických: Jitka Brádlová
(dále jen „**kupující**“)

a

HOSPIMED, spol. s r.o.

se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
IČ: 006 76 853
DIČ: CZ00676853
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 480
jednající prostřednictvím: Ing. Věra Svobodová, jednatelka
Ing. Radim Celecký, jednatel
Jana Doubravová, jednatelka
zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Radim Celecký
zástupce ve věcech provozních a finančních: Ing. Lenka Hesová
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 4, č.ú.: 5274852/0800
(dále jen „**prodávající**“)
(prodávající a kupující dále také společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění, a v návaznosti na výsledek veřejné zakázky dohodly na uzavření této

kupní smlouvy (dále jen „smlouva“)

Preamble

Kupující realizuje projekt „Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje“. Reg.č. CZ.1.13/2.2.00/39.01376. Tento projekt je realizovaný v rámci Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst.

Tato smlouva je uzavírána s prodávajícím jako vítězem veřejné zakázky organizované kupujícím, nazvané **Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – lůžka pro specializovaná lůžková pracoviště**.

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu vybavení, které je specifikováno podmínkami veřejné zakázky s názvem **Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – lůžka pro specializovaná lůžková pracoviště.**

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodání níže specifikovaných movitých věcí včetně příslušenství prodávajícím kupujícímu. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že movité věci jsou na základě níže uvedené specifikace dostatečně a srozumitelně určeny, zejména co do druhu a kvality.
- 1.2 Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu za podmínek v této smlouvě stanovených zdravotnické prostředky blíže specifikované v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy a to v rozsahu dle cenové nabídky prodávajícího, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dodané přístroje musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží.

(dále jen „**předmět koupě**“).

- 1.3 Součástí dodávky předmětu koupě je:
- dodání předmětu koupě do místa plnění, kterým jsou nemocnice Královéhradeckého kraje dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2
 - instalace a uvedení do provozu v místě plnění
 - odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů
 - demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávající obměňované techniky kupujícího, dodání protokolu o ekologické likvidaci
 - provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle příslušné platné legislativy
 - provedení výchozí elektrické revize, pokud je u přístroje nutná
 - předání funkční instalace bez vad a nedodělků zástupci kupujícího
 - seznámení obsluhy s činnostmi jednotlivých přístrojů a její protokolární zaškolení
 - vystavení písemného předávacího protokolu
 - předání uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě kupujícímu, zahrnující minimálně návody k obsluze v českém jazyce, kopie prohlášení o shodě vystavené výrobcí a kopie jejich překladů do českého jazyka, protokoly o zkouškách a revizích
 - další služby a činnosti, specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
 - bezplatné provádění pravidelných preventivních prohlídek instalovaného předmětu koupě během záruční doby, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů
- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že prodávající je po odsouhlasení kupujícím oprávněn dle potřeby dodat modernizovanou verzi přístroje, který je předmětem plnění dle této smlouvy.
- 1.5 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě podle této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující je povinen předmět koupě dodaný bez vad převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle této smlouvy.
- 1.6 Prodávající je vlastníkem předmětu koupě a nese nebezpečí škody na ní do nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícím.
- 1.7 Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě prodávajícímu prodá, kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených od prodávajícího předmět koupě kupuje.

II. Doba plnění

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

- 2.2 Prodávající je povinen oznámit kupujícímu prokazatelným způsobem den dodání předmětu koupě nejpozději pět dnů předem.

III.

Místo plnění

- 3.1 Místem plnění této smlouvy jsou nemocnice v Královéhradeckém kraji dle detailního rozpisu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, nebude-li kupujícím včas určeno a prodávajícímu oznámeno jiné místo. Uvedená místa jsou zároveň místa předání a převzetí předmětu koupě.

IV.

Kupní cena

- 4.1 Kupní cena předmětu koupě je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné, s výjimkou případu uvedeného v odst. 4.3 této smlouvy, překročit, přičemž činí:

4.100.930,00,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto tisíc devět set třicet korun českých) bez DPH,

660.852,90,- Kč (slovy: šest set šedesát tisíc osm set padesát dva korun českých a devadesát haléřů) DPH,

4.761.782,90,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set šedesát jedna tisíc sedm set osmdesát dva korun českých a devadesát haléřů) **celkem s DPH.**

(dále jen „**kupní cena**“).

- 4.2 Kupní cena odpovídá celkové výši nabídkové ceny uvedené v nabídce prodávajícího.
- 4.3 Kupní cenu je možno překročit či snížit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši kupní ceny. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty nejsou smluvní strany povinny uzavírat k této smlouvě dodatek. Platná sazba daně z přidané hodnoty bude k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedena v daňovém dokladu – faktuře.
- 4.4 Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu koupě, např. náklady na materiály, pracovní síly, stroje, přepravu, pojištění, řízení a administrativu, režii prodávajícího a zisk, poplatky a veškeré další náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 4.5 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů prodávajícího, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursů měn po podpisu smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají žádný dopad na výši kupní ceny.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Kupní cena bude uhrazena jednorázově po potvrzeném dodání předmětu koupě, podepsaným předávacím protokolem. V případě, že předmět koupě nebo její příslušenství bude vykazovat vadu či více vad, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech kupující neocitá v prodlení.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystaveného prodávajícím v souladu s touto smlouvou. Splatnost daňového dokladu – faktury bude 60 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání.

- 5.3 Kupující nebude poskytovat zálohy ani závdavek. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v českých korunách na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.
- 5.4 Daňový doklad musí být vystaven ve lhůtě a s náležitostmi stanovenými právními předpisy. V případě, že daňový doklad doručený kupujícímu nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je kupující oprávněn vrátit tento daňový doklad prodávajícímu. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet až doručení opraveného či doplněného daňového dokladu.
- 5.5 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Proávající není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.
- 5.6 Na daňovém dokladu bude dále uveden název projektu („Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje“) a registrační číslo projektu (reg. č. CZ.1.13/2.2.00/39.01376). Na faktuře bude dále uveden variabilní nebo specifický symbol 1376.
- 5.7 Nedílnou součástí daňového dokladu – faktury musí být předávací protokol dle bodu 6.4.

VI.

Dodání předmětu koupě

- 6.1 Prodávající je povinen dodat předmět koupě do místa plnění uvedeného v odstavci 3.1, resp. v příloze č. 2 této smlouvy, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 2.1 této smlouvy. Prodávající je povinen zajistit na své náklady přepravu předmětu koupě do místa plnění a pojištění předmětu koupě po dobu přepravy.
- 6.2 Předmět koupě musí být dodán s požadovanými parametry a s požadovaným vybavením a příslušenstvím. Spolu s předmětem koupě musí být dodána veškerá související dokumentace včetně záručních listů, návodů k obsluze a ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu koupě, zejména pokud vyplývají z právních předpisů. Prodávající je povinen dodat kupujícímu vyplněný a oběma smluvními stranami potvrzený protokol o zaškolení a seznámení obsluhy s činností jednotlivých přístrojů. Veškeré dokumenty a doklady budou dodány v českém jazyce.
- 6.3 Kupující je povinen převzít řádně a včas dodaný předmět koupě, který bude bez vad. Převzetí předmětu koupě bude předcházet jeho detailní prohlídka. K prohlídce je kupující oprávněn určit svého zástupce a prodávající je povinen mu tuto prohlídku umožnit. Prodávající odpovídá za vady, které bude mít předmět koupě v době jeho předání kupujícímu.
- 6.4 O předání a převzetí předmětu koupě bude mezi zástupci smluvních stran sepsán písemný předávací protokol. Předávací protokol bude připraven prodávajícím a bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o účastnících přijímacího řízení s uvedením data a místa konání,
 - specifikaci předávaného předmětu koupě včetně příslušenství,
 - soupis případných vad předmětu koupě, pokud se kupující rozhodne převzít předmět koupě i s vadami či nedoděly, včetně termínu pro jejich odstranění,
 - soupis předávané dokumentace k předmětu koupě.
- 6.5 Kupující není povinen převzít předmět koupě, pokud bude vykazovat vady (včetně vad vzhledových). V případě sporu kupující rozhodne o tom, zda jde o vadu. V případě zjištění jakékoliv vady předmětu koupě se má za to, že byla tato smlouva porušena podstatným způsobem a kupující je oprávněn uplatnit některý z nároků uvedených v ustanovení § 2106 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění. V případě, že se kupující rozhodne předmět koupě převzít i s vadami, musí být tyto vady uvedeny v předávacím protokolu včetně uplatněného nároku kupujícího. Pokud bude kupující požadovat odstranění vady, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vady a způsob, jakým ho bude dosaženo. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění vad, určí je přiměřeným způsobem kupující. Prodávající je povinen ve stanoveném termínu bezplatně

odstranit vady předmětu koupě. O odstranění vad bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis.

- 6.6 Prodávající odpovídá za vady, které bude mít předmět koupě v okamžiku jeho převzetí, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po převzetí předmětu koupě, jestliže bude způsobena porušením jeho povinností.
- 6.7 Kupující není povinen převzít předmět koupě také v případě, že předmět koupě nebude splňovat specifikaci zdravotnického prostředku v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.

VII.

Vlastnické právo k předmětu koupě, nebezpečí škody

- 7.1 Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 7.2 Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího spolu s převodem vlastnického práva.

VIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, záruční a pozáruční servis

- 8.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.
- 8.2 Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami, případně dnem podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad a nedodělků, převzal-li kupující předmět koupě či jeho část s vadami či nedodělků.
- 8.3 Prodávající nebo jeho servisní organizace je povinen nastoupit k odstranění závady či poruchy neprodleně, nejpozději však v pracovní den následující po jejím nahlášení kupujícím. Prodávající je povinen postupovat tak, aby odstranil nahlášenou vadu či poruchu v co nejkratší době. Prodávající je rovněž povinen písemně informovat kupujícího, kdy předpokládá odstranění vady či poruchy.
- 8.4 Záruční servis předmětu koupě, specifikovaný v příloze č. 3 této smlouvy, bude zajištěn prostřednictvím společnosti HOSPIMED, spol. s r.o. Požadavky kupujícího na záruční opravy budou ohlášeny na kontaktní email: jana.simackova@hospimed.cz.
- 8.5 Prodávající se zavazuje během trvání záruční lhůty vady zboží bezplatně odstranit a poskytovat kupujícímu bezplatný servis zboží včetně dodání náhradních dílů.

IX.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1 Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením však prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 9.2 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost pro splnění předmětu této smlouvy. Bude-li kupující v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti, je prodávající povinen na tuto skutečnost kupujícího písemně upozornit a vyzvat jej k nápravě. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím řádné součinnosti není prodávající v prodlení s plněním dle této smlouvy. Prodávající je oprávněn prodloužit dobu plnění dle této smlouvy nejméně o dobu prodlení kupujícího s poskytnutím řádné součinnosti, k níž byl prodávajícím vyzván.

- 9.3 Prodávající je povinen zajistit, aby předmět koupě vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají kvality a parametrů předmětu koupě.
- 9.4 Prodávající je povinen při podpisu smlouvy předložit kupujícímu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím výkonem své činnosti třetím subjektům s limitem pojistného plnění ve výši 4 500 000,- Kč. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 9.5 V případě, že prodávající hodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, je povinen je uvést v Seznamu subdodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoli ze subdodavatelů či změnu v jejich subdodavatelské činnosti provede pouze s předchozím souhlasem kupujícího.

X. Smluvní pokuty

- 10.1 V případě prodlení s dodáním předmětu koupě oproti termínu stanovenému v odst. 2.1 s přihlédnutím k odst. 9.2 této smlouvy je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného předmětu koupě za každý den prodlení.
- 10.2 V případě, že předmět koupě nebude splňovat specifikaci zdravotnického prostředku dle přílohy č. 3 této smlouvy, kupující předmět koupě nepřevzme a prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.
- 10.3 V případě prodlení prodávajícího se započítáním odstranění vad a poruch reklamovaných v záruční době, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny předmětu koupě za každý den prodlení a za každý případ porušení této povinnosti.
- 10.4 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody do výše smluvní pokuty ani na odstoupení od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.
- 10.5 Smluvní pokuta je splatná deset dnů po doručení písemného oznámení o jejím uplatnění prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce prodávajícího na kupní cenu.
- 10.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter předmětu koupě a veřejný zájem na jeho řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

XI. Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nabývá účinnosti až po splnění odkládací podmínky, kterou je vydání kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu. Pokud kupující neobdrží dotaci z ROP, nenabude kupní smlouva účinnosti.
- 11.3 Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 11.4 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím.
- 11.5 Za závažné porušení smluvní povinnosti prodávajícím se považuje:

- a) skutečnost, že předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované uchazečem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části předmětu koupě či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než tři dny.
- 11.6 Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
- a) nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění,
 - b) v důsledku rozhodnutí orgánu státní správy, územní samosprávy či řídicího orgánu projektu kupující nebude mít dostatek finančních prostředků k úhradě kupní ceny,
 - c) prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
 - d) prodávající pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání veřejné zakázky,
 - e) bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího; prodávající je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu,
 - f) prodávající vstoupí do likvidace.
- 11.7 Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než devadesát dnů.
- 11.8 Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla.
- 11.9 Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.
- 11.10 V případě odstoupení od smlouvy kupující zůstává vlastníkem již předané části předmětu koupě a prodávajícímu náleží část kupní ceny připadající na tuto již předanou část předmětu koupě. Na již předanou část kupujícímu se vztahují veškerá ujednání uvedená v této smlouvě.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smluvní strany sjednávají, že ve věcech výslovně neupravených se tato smlouva bude podřídit ustanoveními občanského zákoníku v aktuálním znění.
- 12.2 Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v aktuálním znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Prodávající je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 12.4 Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.5 Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto

dohody. Prodávající bere na vědomí, že změny této smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

12.6 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka prodávajícího
- Příloha č. 2 Specifikace místa plnění – rozpis konkrétních nemocnic
- Příloha č. 3 Specifikace dodávky
- Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 5 Výkaz výměr

12.7 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři a prodávající dvě vyhotovení.

12.8 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Hradci Králové dne 15. 07. 2015

V Praze dne 07. 07. 2015

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00676853

.....
kupující

Královéhradecký kraj

Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

.....
prodávající

HOSPIMED, spol. s r.o.

Ing. Věra Svobodová
jednatelka

Cenová nabídka
Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – lůžka pro specializovanou lůžkovou pracoviště

Poř. číslo	Název zdravotnického přístroje	Počet	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
1	Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP, nemocnice DK	4	48 750,00 Kč	195 000,00 Kč	15%	29 250,00 Kč	224 250,00 Kč
2	Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu, nemocnice DK	4	3 870,00 Kč	15 480,00 Kč	15%	2 322,00 Kč	17 802,00 Kč
3	Resuscitační lůžko polohovací pro ARO, nemocnice RK	5	148 210,00 Kč	741 050,00 Kč	15%	111 157,50 Kč	852 207,50 Kč
4	Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro ARO, nemocnice RK	5	5 870,00 Kč	29 350,00 Kč	15%	4 402,50 Kč	33 752,50 Kč
5	Vyplachovače podložních mís pro JIP a ARO, nemocnice RK	2	148 830,00 Kč	297 660,00 Kč	21%	62 508,60 Kč	360 168,60 Kč
6	Polohovací lůžka pro JIP interního oddělení, nemocnice RK	7	48 640,00 Kč	340 480,00 Kč	15%	51 072,00 Kč	391 552,00 Kč
7	Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro JIP, nemocnice RK	7	3 860,00 Kč	27 020,00 Kč	15%	4 053,00 Kč	31 073,00 Kč
8	Lůžka pro LDN, nosnost 150 kg , nemocnice Jaroměř	18	19 820,00 Kč	356 760,00 Kč	15%	53 514,00 Kč	410 274,00 Kč
9	Lůžka pro LDN, nosnost 200 kg , nemocnice Jaroměř	2	19 820,00 Kč	39 640,00 Kč	15%	5 946,00 Kč	45 586,00 Kč
10	Noční stůlek pro LDN , nemocnice Jaroměř	20	6 050,00 Kč	121 000,00 Kč	21%	25 410,00 Kč	146 410,00 Kč
11	Lůžko pro standardní péči (21ks neurologie, 20ks onkologie, 10ks interna), nemocnice Trutnov	51	29 100,00 Kč	1 484 100,00 Kč	15%	222 615,00 Kč	1 706 715,00 Kč
12	Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu, nemocnice Trutnov	51	2160	110160	15%	16 524,00 Kč	126 684,00 Kč
13	Pacientský stůlek k lůžku s jídelní deskou, nemocnice Trutnov	51	6730	343230	21%	72 078,30 Kč	415 308,30 Kč
Celkem		227	x	4 100 930,00 Kč		660 852,90 Kč	4 761 782,90 Kč

Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – lůžka pro specializovaná lůžková pracoviště

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

	počet
Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP	4
Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu	4

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Resuscitační lůžko polohovací pro ARO	5
Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro ARO	5
Vyplachovače podložních mís pro JIP a ARO	2
Polohovací lůžka pro JIP interního oddělení	7
Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro JIP	7

Oblastní nemocnice Náchod a.s., lokalita Jaroměř

Lůžka pro LDN, nosnost 150 kg	18
Lůžka pro LDN, nosnost 200 kg	2
Noční stůlek pro LDN	20

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Lůžko pro standardní péči (21ks neurologie, 20ks onkologie, 10ks interna)	51
Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu	51
Pacientský stůlek k lůžku s jídelní deskou	51

Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP – Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem – 4 ks

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Velmi stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka, nejlépe sloupový.	ANO	Sloupový podvozek
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm,	ANO	40 – 78cm
Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200x85 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem,	ANO	200x85cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem,
Možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru,	ANO	16°/16°
Autoregrese zádového dílu minimálně 10 cm,	ANO	14cm, nožní autoregrese 7,5cm
Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR),	ANO	
Odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech,	ANO	Čela celoplastová
Integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému spuštění polohování, tvořící ochranou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než cca 60 mm,	ANO	
Nosník hlavového čela pevně spojen s podvozkem zajišťující stabilní umístění příslušenství,	ANO	
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha.	ANO	
Integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm,	ANO	Prodloužení o 20cm
Kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. nejlépe 150 mm,	ANO	Kolečka o prům. 150mm
Univerzální držáky na drobné příslušenství,	ANO	
Držáky na infuzní stojan, hrazdu a extenční systém,	ANO	
Ochranná kolečka v rozích lůžka,	ANO	
Zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti	ANO	
Potenciálové propojení,	ANO	
Polička na lůžkoviny s držákem na sesterský ovladač,	ANO	
Plastová polička na psaní,	ANO	
Úchyty pro fixační pásy,	ANO	
Nosnost minimálně 200 kg,	ANO	Nosnost 250kg
1 x infuzní tyč – teleskopická, s redukcí, upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky,	ANO	
1 x lakovaná hrazda + rukojeť na hrazdu,	ANO	
1 x držák sáčku na moč,	ANO	
1 x koš na bažanta,	ANO	

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 4 kusy

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m ³ zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách,	ANO	Studená pěna o hustotě 45kg / m3
Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m ³ ,	ANO	Visco pěna o hustotě 50kg / m3
zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m ³ ,	ANO	Pěna o hustotě 40kg / m3
Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované,	ANO	
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech,	ANO	
Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace,	ANO	II. – III. stupeň (Norton 20-13)
Rozměr dle lůžka, tl. nejlépe 12 cm	ANO	200x85x12cm

Polohovací lůžka, včetně příslušenství a nočních stolků - ON Trutnov a.s. – 51 ks

21 ks - neurologie, 20 ks onkologické oddělení, 10 ks interní oddělení
ON Trutnov a.s.

Minimální technické požadavky

Lůžko pro standardní péči

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
bezpečnost lůžka - bezvýhradná shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění	Ano	
stabilní konstrukce lůžka, ložná plocha minimálně 200x85cm	Ano	99 x 218 cm
nosnost minimálně 230kg	Ano	250 kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou mobilizaci pacienta	Ano	37 – 73,5 cm
čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	Ano	
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil (prevenci dekubitů)	Ano	
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, bezpečná a dobře dostupná aretace	Ano	15 cm
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta	Ano	+15°/-15°
mechanické rychlopuštění zádového dílu (KPR)	Ano	
kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámký) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů	Ano	
jednodílné nebo dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bezpečná a dobře dostupná aretace v horní části postranic	Ano	
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace (zámký) jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami, minimálně resuscitační poloha KPR, ortopnoické (kardiacké) křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další	Ano	
konektorem snadno odpojitelný patientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování	Ano	
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm	Ano	
oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka	Ano	
ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	Ano	
svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel	Ano	

Příloha č. 3

matrace:

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
pasivní antidekubitní matrace, jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě minimálně 40kg/m ³ , na povrchu jádra antidekubitní prořez v podélném i příčném směru, potah snímatelný se zipem s okapničkou, paropropustný, voděodolný, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška 14 cm	Ano	

příslušenství:

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí	Ano	
infuzní stojan výškově stavitelný - chrom (nerez)	Ano	

Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku	Ano	
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTDI)	Ano	
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů	Ano	
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání	Ano	
kolečka o průměru minimálně 70mm, minimálně dvě kolečka brzditelná	Ano	75 mm
provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole skříňka s dvířky	Ano	
stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky	Ano	
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku	Ano	
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky	Ano	

Polohovací lůžka pro ARO – Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 5ks**Technická specifikace lůžka pro Rychnov nad Kněžnou - ARO**

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52	Ano	
stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	Ano	
bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg	Ano	250 kg
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm	Ano	44 – 82 cm
čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů	Ano	
ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování	Ano	
integrovane prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru	Ano	22 cm
laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru,	Ano	±30°
Vážicí systém s uložením naměřených parametrů do paměti, měření absolutní hmotnosti a přírůstků či úbytků váhy pacienta na druhém displeji	Ano	
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru	Ano	13°/16°
snímání C ramenem	Ano	
mechanické spouštění zádového dílu (CPR)	Ano	
odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení	Ano	
integrovane dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici	Ano	
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou	Ano	
sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)	Ano	
v postranicích integrovane oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	Ano	
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, univerzální lišty a držáky na příslušenství	Ano	150 mm
držáky na infúzní stojan a hrazdu	Ano	
ochranná kolečka v rozích lůžka	Ano	
záloková baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	Ano	
potenciálové propojení	Ano	
příslušenství:	Ano	
sada fixačních klínů pro laterální náklon	Ano	
držák hadic ventilátoru pro laterální náklon	Ano	
infúzní stojan	Ano	
držák kyslíkové lahve	Ano	

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 5 kusů

Rychnov nad Kněžnou - ARO

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Jádru ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m ³ zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách,	Ano	
Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m ³ ,	Ano	
zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m ³ ,	Ano	
Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované,	Ano	
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech,	Ano	
Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace,	Ano	
Rozměr dle lůžka, tl.nejlépe 12 cm	Ano	14 cm

Polohovací lůžka s příslušenstvím, včetně nočních stolků, pro LDN Jaroměř – ON Náchod a.s. – 20 ks

Lůžka pro LDN Jaroměř 18 kusů

LDN Jaroměř

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Výškový zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozmezí 40 – 80 cm	ANO	38,5 – 80cm
Kolečka průměr min. 100 mm, brzděná, se směrovou aretací	ANO	Kolečka o pr. 100mm
Ložná plocha s výplní kovovými lamelami	ANO	
Dezén čel bude imitace dřeva, přesný odstín bude upřesněn před realizací	ANO	
Zádový díl bez polohování podhlavníku	ANO	
Polohování zádové části pomocí elektromotoru	ANO	
Polohování lýtkové části mechanicky	ANO	
Zábrany	ANO	
Barevný odstín kovové konstrukce bude upřesněn před výrobou	ANO	
Ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO	
Hrazda s brázdíčkou	ANO	
Držák na močovou láhev 10 kusů	ANO	
Rozměry lůžka 90 x 200 cm	ANO	90x200 cm
Nosnost lůžka min. 150 kg	ANO	Nosnost 220kg

Lůžka pro LDN Jaroměř 2 kusy

LDN Jaroměř

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Výškový zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozmezí 40 – 80 cm	ANO	38,5 – 80cm
Kolečka průměr min. 100 mm, brzděná, se směrovou aretací	ANO	Kolečka o pr. 100mm
Ložná plocha s výplní kovovými lamelami	ANO	
Dezén čel bude imitace dřeva, přesný odstín bude upřesněn před realizací	ANO	
Zádový díl bez polohování podhlavníku	ANO	
Polohování zádové části pomocí elektromotoru	ANO	
Polohování lýtkové části mechanicky	ANO	
Zábrany	ANO	
Barevný odstín kovové konstrukce bude upřesněn před výrobou	ANO	
Ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO	
Hrazda s brázdíčkou	ANO	
Držák na močovou láhev 10 kusů	ANO	
Rozměry lůžka 90 x 200 cm	ANO	90x200 cm
Nosnost lůžka min. 200 kg	ANO	Nosnost 220kg

Noční stolek pro LDN Jaroměř 20 kusů

LDN Jaroměř

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Jídelní deska bude z materiálu ABS s plynulým výškovým nastavením pomocí pístnice s náklonem a s aretací ve 3 pozicích	ANO	
Oboustranné dřevěné provedení	ANO	
Stolky budou vybaveny držákem na ručníky	ANO	
Kovové části stolu budou opatřeny práškovými vypalovacími barvami	ANO	
Ve spodní části stolu bude dřevěný nebo drátěný prostor na boty	ANO	
Zásuvky a dvířka budou opatřena madly	ANO	
Brzděná kolečka o průměru min 60 mm	ANO	Kolečka o pr. 65mm
Zásuvky budou mít plastovou vložku	ANO	
Dezén bude upřesněn před výrobou	ANO	

Vyplachovač podložních mís - 2 kusy

JIP interna Rychnov nad Kněžnou

1 kus

ARO Rychnov nad Kněžnou

1 kus

Podrobnější specifikace:

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Přístroje musí mít elektrický ohřev, připojitelný na síť 220 V,	Ano	220V, 50 Hz, 2,4 kW
Mycí komora musí mít velikost na min. 1 podložní mísu a 1 urinální láhev,	Ano	1 podložní mísa, 1 urinální lahev a víko
Podložní mísy a urinální láhve se musí vyprazdňovat automaticky,	Ano	automaticky
Přístroje musí mít vlastní vyvíječe páry,	Ano	Vlastní generátor
Umývané nádoby se musí umývat jak na vnitřních, tak na vnějších površích,	Ano	13 trysek + rotační tryska
Materiály použité na výrobu vyplachovače, příslušenství a nosičů mís musí být vyrobeny z materiálů, které snášejí chemické, mechanické a tepelné namáhání,	Ano	Celonerezové materiál A2
Všechny části, které přicházejí do styku s vodou, párou nebo chemií musí být vyrobeny ze antikoročních materiálů,	Ano	Celonerez, A2
Vnější povrchy musí být snadno čistitelné,	Ano	Celonerez
Mycí prostředek musí být dávkován automaticky,	Ano	Doyen
Ověření procesu prováděné tepelné desinfekce musí být provedeno jedním ze způsobu uvedeným v normě ČSN EN ISO 15883 – 1 bod.5.11.4,	Ano	ČSN EN ISO 15883 – 1
Indikace teploty v komoře musí být analogická nebo digitální,	Ano	Digitální
Přístroje musí vizuálně indikovat fázi procesu, která byla v provozním cyklu dosažena,	Ano	Na displeji
Přístroje musí mít programování cyklů,	Ano	64 pozic s možností pr. cyklů
Přístroje musí mít indikaci pro bezpečné otevření dvířek,	Ano	Automatické zamknutí dveří při daném cyklu
Možnost použití přístrojů i na mytí jiných nádob	Ano	Možnost síta a spec. držáku

Polohovací lůžka pro JIP interní - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - 7 ks

JIP v Rychnově nad Kněžnou

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
velmi stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka, nejlépe sloupový.	ANO	Sloupový podvozek
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm,	ANO	40 – 78cm
Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200x85 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem,	ANO	200x85cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem,
Možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru,	ANO	16°/16°
Autoregrese zádového dílu minimálně 10 cm,	ANO	14cm, nožní autoregrese 7,5cm
Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR),	ANO	
Odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech,	ANO	Čela celoplastová
Integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému spuštění polohování, tvořící ochranou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než cca 60 mm,	ANO	
Nosník hlavového čela pevně spojen s podvozkem zajišťující stabilní umístění příslušenství,	ANO	
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha.	ANO	
Integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm,	ANO	Prodloužení o 20cm
Kolečka s centrálním ovládním brzd prům. nejlépe 150 mm,	ANO	Kolečka o pr. 150mm
Univerzální držáky na drobné příslušenství,	ANO	
Držáky na infuzní stojan, hrazdu a extenční systém,	ANO	
Ochranná kolečka v rozích lůžka,	ANO	
Zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti	ANO	
Potenciálové propojení,	ANO	
Polička na lůžkoviny s držákem na sesterský ovladač,	ANO	
Plastová polička na psaní,	ANO	
Úchyty pro fixační pásy,	ANO	
Nosnost minimálně 200 kg,	ANO	Nosnost 250kg
1 x infuzní tyč – teleskopická, s redukcí, upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky,	ANO	
1 x lakovaná hrazda + rukojeť na hrazdu,	ANO	
1 x držák sáčku na moč,	ANO	
1 x koš na bažanta	ANO	

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 7 kusů

JIP v Rychnově nad Kněžnou

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota /popis
Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m ³ zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách,	ANO	Studená pěna o hustotě 45kg / m ³
Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m ³ ,	ANO	Visco pěna o hustotě 50kg / m ³
zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m ³ ,	ANO	Pěna o hustotě 40kg / m ³
Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované,	ANO	
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech,	ANO	
Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace,	ANO	II. – III. stupeň (Norton 20-13)
Rozměr dle lůžka, tl. nejlépe 12 cm	ANO	200x85x12cm

Specifikace dodávky

Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Lůžko INVENT

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění

Podvozek – stabilní 2 sloupová konstrukce, nosnost 250 kg, typ L, plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - kov, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál

Zádový díl, stehenní díl a lýtkový díl - polohování elektrické

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR - polohování elektrické

Autokontura – současné polohování zádového a stehenního dílu

Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm

CPR - zádový díl

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Záložní baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti

2x univerzální držák příslušenství - hlavová část

2x univerzální držák příslušenství - nožní část

Čtyřdílná ložná plocha o šíři 85 cm

Ložná plocha z kovových lamel

Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha)

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Prodloužení lýtkového dílu

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Úchyty pro fixační pásy

Eurolišta 2ks

Police na lůžkoviny

Čela plastová, typ R2

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Hlavové čelo připevněné k podvozku

Sklopné postranice plastové dělené ZPM3 (sada 4ks) s ochranou proti nechtěnému spuštění

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Maximální vnější rozměry lůžka:	222 x 100 cm
Rozměr ložné plochy:	200 x 85 cm
Výška ložné plochy bez matrace:	40 - 78 cm
Maximální úhel Trendelenburg:	16°
Maximální úhel Antitrendelenburg:	16°
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství:	250 kg

Příslušenství k lůžku: polička na psaní, infuzní stojan chromovaný se čtyřmi háčky, hrazda, hrazdička, držák sáček na moč, držák močové láhve

Příloha č. 3

Lůžko INVENT:



Příslušenství lůžka:


infuzní stojan chrom



hrazda, hrazdička s popruhem



polička na psaní

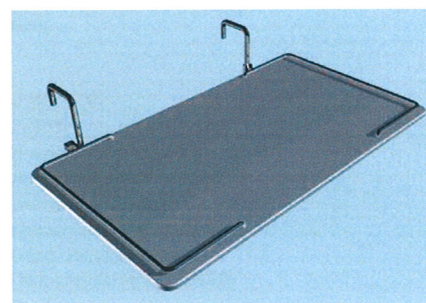

držák nádoby na moč



2x- držák sáčků na moč



Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Matrace Visco Lux

Jádro ze studené pěny 45 kg/m³

Po celém povrchu jádra viscoelastická pěna 50 kg/m³ v tl. 3 cm

Zpevněné okraje tužší pěnou 40 kg/m³

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (II.-III. stupně / Norton 20-13)


7 anatomických zón

Potah zelený SAFR, snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění

Paropropustný, voděodolný (2000mm vodního sloupce), antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, pratelný na 95°

Spoje potahu svařované

Rozměr matrace 200 x 85 x 14 cm

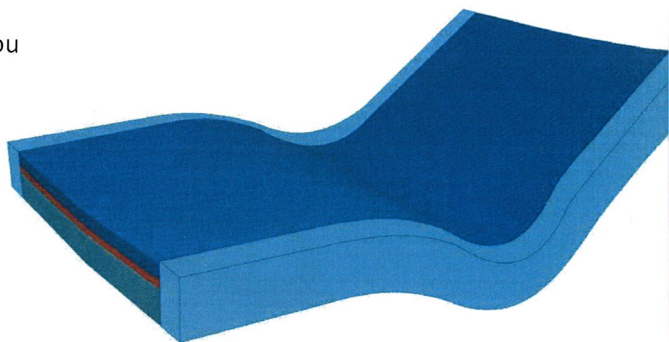


Resuscitační lůžko polohovací pro ARO

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Lůžko Multicare

Ucelený koncept bezpečnosti

Lůžko Multicare LE® slouží k hospitalizaci pacientů v kritickém stavu při současném zajištění bezpečnosti pacientů s různými riziky. Lůžko nabízí koncept ochrany pacienta, který eliminuje riziko pádu a jiných úrazů v souvislosti s lůžkem. Klíčovým prvkem bezpečnostního systému jsou postranice, které poskytují ochranu na základě individuálních potřeb každého pacienta. Bezpečí pacienta hlídají i další sofistikované prvky lůžka – automatická brzda Brake a multizónový Bed Exit Alarm.

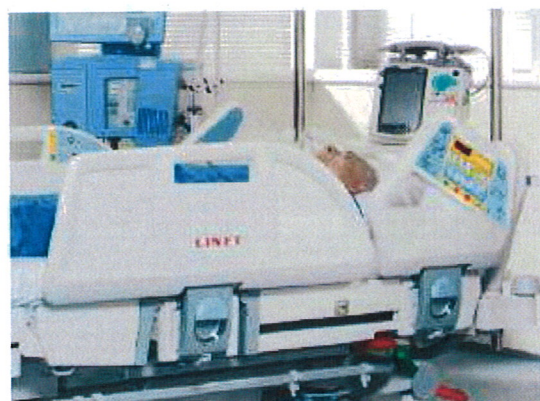

[01]

[01] VARIABILNÍ SYSTÉM POSTRANIC PRO INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ

Unikátní koncept postranic umožňuje optimalizovat péči a ochranu podle rizikovosti a aktuálního stavu pacienta. V případě, že je pacient indikován jako zmatený a vysoce rizikový z hlediska pádu, je možné použít třídičnou kombinaci postranic – standardní hlavovou a centrální postranici doplňuje Protector v nožní části lůžka. Tak je k dispozici lůžko s postranicemi po celé délce ložné plochy. Standardní ochranu pro většinu pacientů poskytuje lůžko vybavené dvojicí postranic bez Protectoru.

VÝŠKA POSTRANIC

Díky nadstandardním parametrům postranic (výška 45 cm) je lůžko kompatibilní s aktivními i pasivními antidekubitními systémy.



[02]

[02] MINIMÁLNÍ MEZERY – MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ

Koncept minimálních mezer snižuje riziko úrazu uvíznutí pacienta mezi jednotlivými částmi postranic a vyhovuje nejnovějším normám. Při pohybu zádového dílu zůstává velikost mezer mezi postranicemi konstantní. Velikost všech mezer odpovídá požadavkům přísně bezpečnostní normy ČSN EN 60601-2-62.

[03] BED EXIT ALARM


Multizónový Bed Exit Alarm je součástí systému prevence pádů na lůžku Multicare LE®. Senzor je spuštěn v okamžiku, když se pacient blíží k okraji lůžka a upozorňuje tak pacienta i personál na potenciální nebezpečí a možné riziko pádu.




[03]



[04]

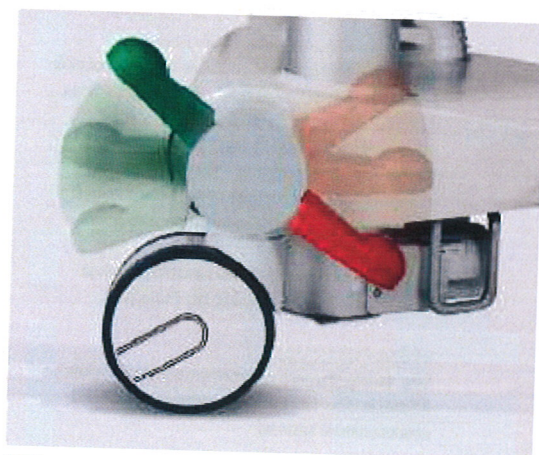

[05]

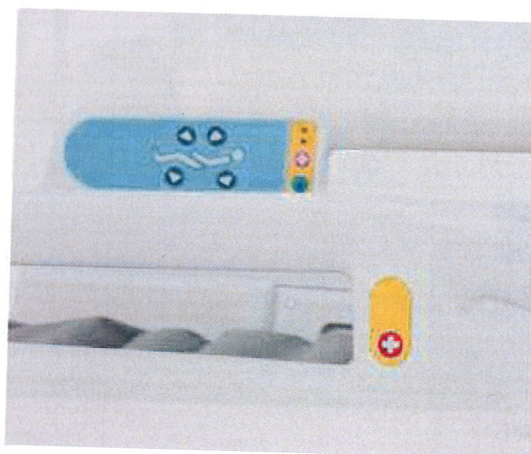

[06]

[04] PREVENCE PÁDU PŘI LATERÁLNÍM NAKLONU


Elektronické senzory zabrání spuštění laterálního polohování, pokud nejsou postranice v bezpečné poloze.

[05] I-BRAKE

Automatická brzda I-Brake minimalizuje rizika, která mohou vzniknout v případě nezabrzdného lůžka. Pokud lůžko zůstane nezabrzdnuté a je připojeno do elektrické sítě, automaticky se po 1 minutě aktivuje brzda I-Brake.

[06] NURSE CALL

Funkce nurse call umožňuje předcházet jakýmkoliv nebezpečným situacím včasnou asistencí sestry u pacienta v naléhavých případech.

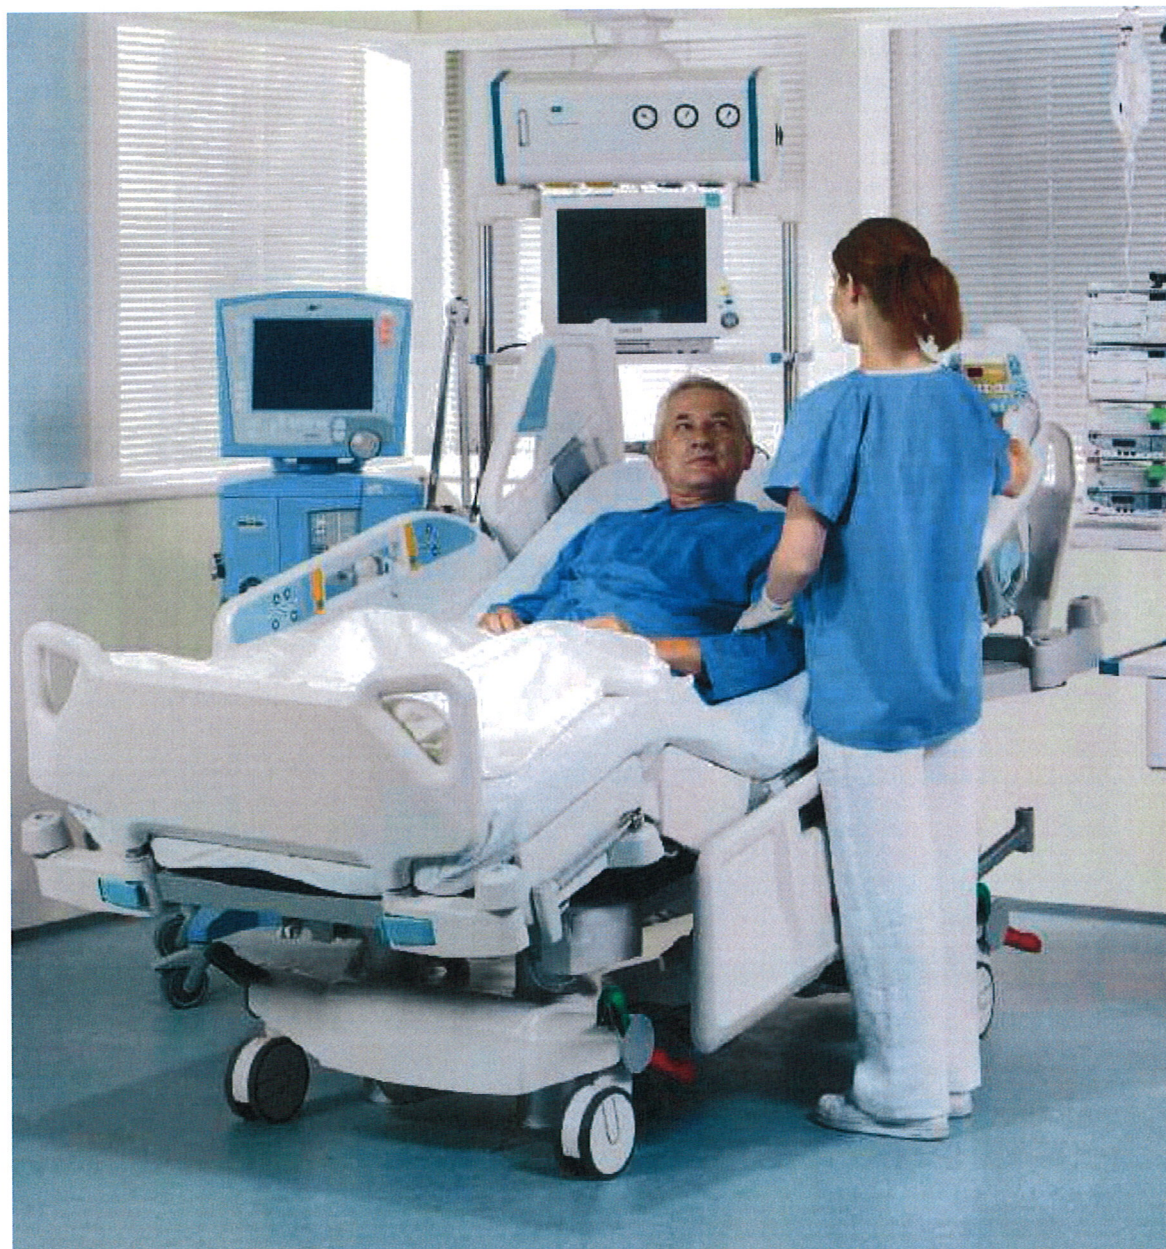

[01] LATERÁLNÍ NÁKLON

Laterální náklon umožňuje napolohovat pacienta do polohy na bok s vynaložením minimální fyzické námahy. Tato funkce výrazně snižuje fyzickou zátěž sester při manipulaci s pacientem a eliminuje riziko pracovního úrazu a bolesti zad. Šetří čas potřebný na vykonávání rutinních ošetrovateckých aktivit, zefektivňuje prevenci dekubitů a pomáhá předcházet komplikacím u pacientů s lymfedémy a usnadňuje provádění pooperační drenáže.

Nastavení laterálního náklonu je bezpečné pro pacienty a z hlediska sestry je snadné.



[01]

[02] SNADNÝ TRANSPORT

Páté kolečko výrazně usnadňuje jízdu s lůžkem, stabilizuje směr pohybu a usnadňuje zatáčení. Po skončení transportu lůžka se 5. kolečko zatahuje do podvozku. Nepřekáží podjezdovým zařízením, například použití C ramene, serveru nebo zvedáku, a nebrání při uklidu. Jednodušší manipulaci s lůžkem umožňují také ergonomická madla vestavěná v čelech lůžka.



[02]


Příloha č. 3

[01] LATERÁLNÍ NÁKLON PRO PREVENCI PLICNÍCH KOMPLIKACÍ

Mezi důležité úkoly JIP patří prevence VAP (Ventilator Associated Pneumonia). Důležitou roli v prevenci hraje polohování zejména pomocí laterálního náklonu. Pomocí náklonu zprava doleva dochází k migraci tekutin ze vzdálenějších oblastí plic do míst, kde je lze odsát.

[02] TLAČÍTKO 30° ZÁDOVÉHO DÍLU

Centrální ovládací panel Multiboard umístěný v hlavové postranici zřetelně indikuje nastavení zádového dílu do 30° – klinicky doporučené polohy pro prevenci respiračních komplikací. Tuto polohu lze nastavit pomocí jediné tlačítka na tomto panelu.

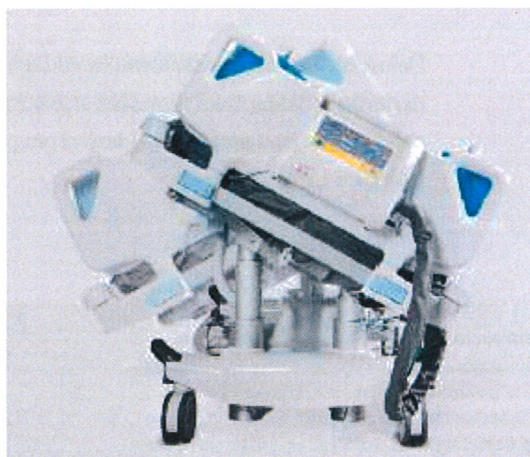

[01]

ORTOPNOICKÉ KŘESLO

- [a] Poloha vsedě
- [b] Opřené nohy
- [c] Opřené ruce
- [d] Snížený tlak v oblasti břišní krajiny

Poloha Ortopnoického křesla je určena především pro pacienty s křidovou dušností. Kombinuje vysokou Fowlerovu polohu (plics jsou ve vertikální poloze), redukci stlačení vnitřních orgánů pro snadnější bráněční dýchání a možnost lépe zapojit pomocné dýchací svaly.



[02]

Komplexní prevence dekubitů

Dekubitus je komplikace, které lze předejít. Možnost šetrného polohování pacienta, redukce tlaku na měkké tkáně a omezení smykových sil během změny polohy lůžka jsou prostředky, kterými pro prevenci dekubitů disponuje lůžko Multicare LE®.

[01] ERGOFRAME®

Lůžná plocha Multicare LE® je vybavena systémem ErgoFrame®, který respektuje přirozený pohyb lidského těla při polohování a zároveň působí preventivně proti vzniku dekubitů v pánevní oblasti. ErgoFrame® rozšiřuje prostor v rizikových partiích (pánevní oblast) při polohování lůžka a výrazně snižuje tlak na pokožku v této zóně. Právě v pánevní oblasti vzniká až 40 % dekubitů. Další významnou příčinou vzniku dekubitů je nadměrné tření mezi matrací a pokožkou a napínání pokožky pacienta v oblasti zad, zejména lopatek. Díky ErgoFrame® je výrazně potlačen vznik těchto nežádoucích smykových sil mezi matrací a pokožkou.



[01]

[02] LATERÁLNÍ NÁKLON

Preventivní pravidelné polohování je základní metodou prevence. Laterální náklon umožňuje přetočit pacienta na bok za použití minimální fyzické námahy. Tato funkce výrazně usnadňuje polohování a rozšiřuje spektrum polohovacích procedur.



[02]

OTEVŘENÁ ARCHITEKTURA KOMBINACE MATRACÍ

Koncept lůžka Multicare LE® umožňuje použití vhodného antidekubitního systému na základě aktuálního stavu i prognózy konkrétního pacienta. Aktivní matrace Virtouso se střídavým tlakem je určena pro vysoce rizikové pacienty. Pracuje na principu střídání tlaku ve vzduchových celách. V 7,5minutovém cyklu se snižuje tlak na nulu v jedné ze tří sousedících cel. Preventivní antidekubitní účinky nabízí pasivní pěnové matrace Ergomatt, s rovnoměrnou distribucí tlaku, nebo vzduchové matrace Symbioso 100, s konstantně nízkým tlakem. Všechny systémy jsou plně kompatibilní s lůžkem Multicare LE® a lze je podle potřeby libovolně střídát.

Efektivní řízení nákladů

Lůžko Multicare LE® poskytuje maximální funkčnost pro ošetrovatelskou praxi, ale také pomáhá zefektivnit náklady vynaložené na péči o pacienta a redukuje dodatečné investice do servisu a údržby.




[03]

[03] INTELIGENTNÍ LŮŽKO

Mozkem lůžka Multicare je mikroprocesory řízená elektronika. Hlídá bezpečnost provozu lůžka, vyhodnocuje provozní situace, zapojuje do činnosti automatické systémy a zajišťuje bezdrátovou komunikaci s informačním systémem LINIS.

LINIS

Lůžko dokáže komunikovat s okolím. Předává klinická, provozní a servisní data do informačního systému LINIS k následnému vyhodnocování. Takto lze sledovat průběh vybraných terapeutických funkcí a provádět servisní diagnostiku na dálku. To umožňuje rychlé servisní zásahy přímo u zákazníka.

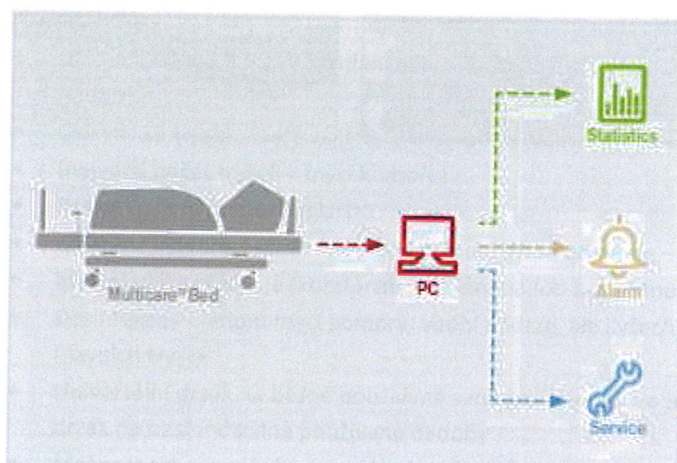

[04] KVALITA PROVEDENÍ A DOSTUPNÝ SERVIS

Kvalitní komponenty, přísné audity i vnitřní kontroly garantují při výrobě lůžek 100% kvalitu každého vyrobeného lůžka. Díky mezinárodní síti vlastních poboček i partnerských firem má LINET k dispozici servisní střediska, pokrývající veškeré dodané výrobky v celosvětovém měřítku.



Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro ARO

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Matrace ERGOMAT



- Prevence vzniku dekubitů a komfort pro pacienta jsou hlavní vlastnosti matrace Ergomatt.
- Matrace je speciálně navržena pro použití v kombinaci se systémem Ergoframe®. Výsledkem společného působení tohoto unikátního systému a matrace Ergomatt je potlačení negativního účinku polohování ložné plochy na pacienta a dosažení jeho maximálního pohodlí. Měření tlakových map ukázalo, že kombinace Ergoframe®-Ergomatt snižuje tlak v bederní oblasti o 25 % v porovnání se standardním lůžkem.
- Elastický potah a vrstva termoelastické pěny se adekvátně přizpůsobí poloze pacienta.
- Potah je voděodolný, paropropustný, jeho švy jsou vysokofrekvenčně svařované tak, aby efektivně zabránily proniknutí jakékoliv tekutiny.
- Riziko II, Norton 20-16, výška matrace 14 cm, hmotnost matrace 12,5 kg, maximální nosnost matrace 120 kg.

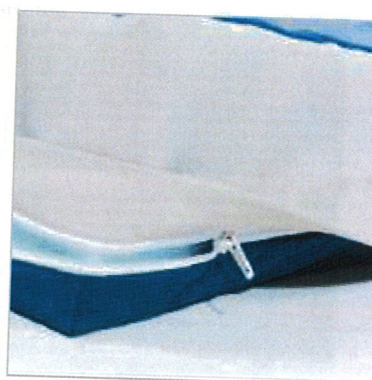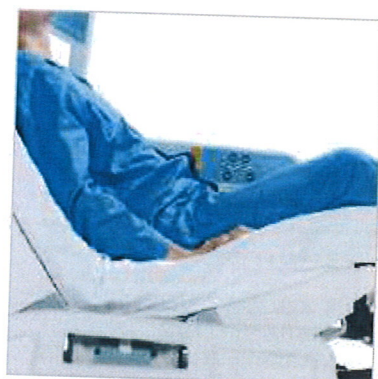

Příloha č. 3

Vyplachovače podložních mís pro JIP a ARO


Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

MEIKO TOPIC

- Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové lahve s termickou dezinfekcí
- Velká variabilita úpravy programů s možností nastavení teploty, času mytí a volby intenzity. Možnost nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody.
- Programy úsporný, normální a intenzivní. (speciální programy bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob.
- Parametr A0 = 60 včetně vyššího stupně dezinfekce – 600,
- V různých variantách provedení s možností zavěšení na zeď, nebo s možností stání,
- Mycí komora je z 1 ks hlubokotažné oceli (žádné sváry, snadnější samočištění
- Česky psaný alfabetský displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce
- Displej přístroje obsahuje 4 řady po 20 znacích.
- Kapacita mytí 3 ks močové lahve nebo 1ks močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí. Nebo nádoba do toaletního křesla.
- Vlastní vyvíječ páry
- Hlavní rotační rameno včetně ostatních trysek, která vyčistí i prostory, kam se běžné trysky nedostanou (u podložní mísy je to prostor např. pod lemem)
- Speciální dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory bez nutnosti zásahu a to nejméně na 10 000 cyklů
- Rozměry dezinfektoru: výška 1730 mm, šířka 500 mm, hloubka 450 mm
- Ideální výška přístroje (komfortní vkládání nádob bez nutnosti sklonění personálu)
- Konstrukce a opláštění čistícího a desinfekčního automat je zhotoveno z nerezového materiálu včetně mycí komory, která je 1 ks hlubokotažné oceli. Díky tomu dochází k snadnějšímu samočištění a zároveň udržování povrchu.
- Jednoduché komfortní ovládání díky automatickým programům bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob.
- Celkem 13 trysek, které zajišťují perfektní vyčištění sanitárních nádob.
- (největší počet trysek v mycí komoře)
- Pasivní sušení pomocí oplachu
- Možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele – celkem 64 programů
- Ideální výška přístroje (komfortní vkládání nádob bez nutnosti sklonění personálu)
- Dezinfekce nejenom mycí komory, vodní nádrže, ale i všech přívodních trubek, hadic a všech trysek, vč. hlavních trysek
- Universální držák na běžně používané sanitární nádoby ve zdravotnictví, je možné vyrobit speciální držák na nestandardně používané nádoby
- Možnost zakoupení síta pro vkládání různých nádob, pro které není místo v držáku.
- Firma MEIKO je certifikována podle normy EN 15883
- TOPIC je velice tichý přístroj, hlučnost cca 48 dB
- Automatické uzamčení dveří při mycím cyklu
- Zámek proti zneužití nepovolanými osobami
- Certifikát DIN EN 1717 – Ochrana pitné vody
- Automatické umytí mycí komory po každém dni užívání
- Objem mycí komory 64,5 litrů


Popis přístroje MEIKA TOPIC

Obrázek je pouze ilustrativní

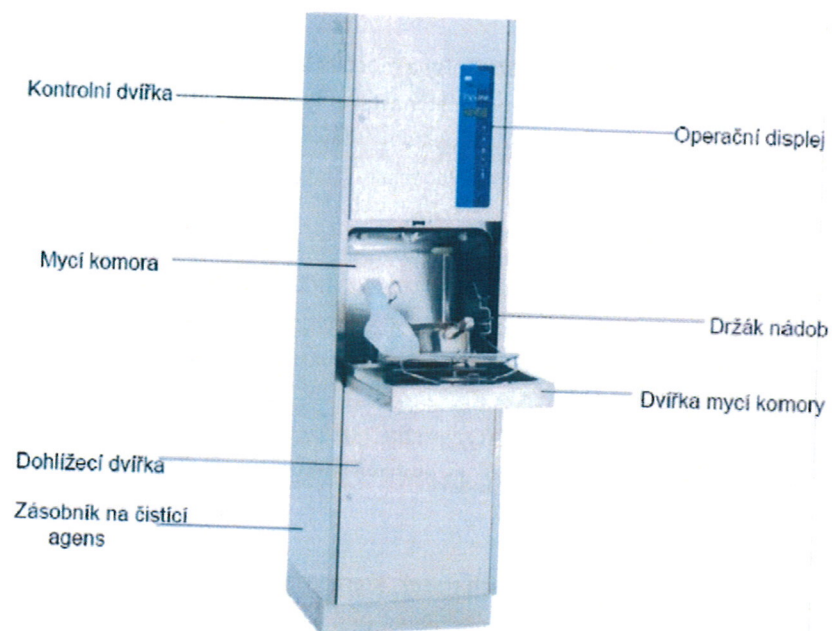

Kapacita 1 cyklu – 1 podložní mísa vč.víka + 1 močová lahev
nebo 3 močové lahve

Možnost zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob
viz foto

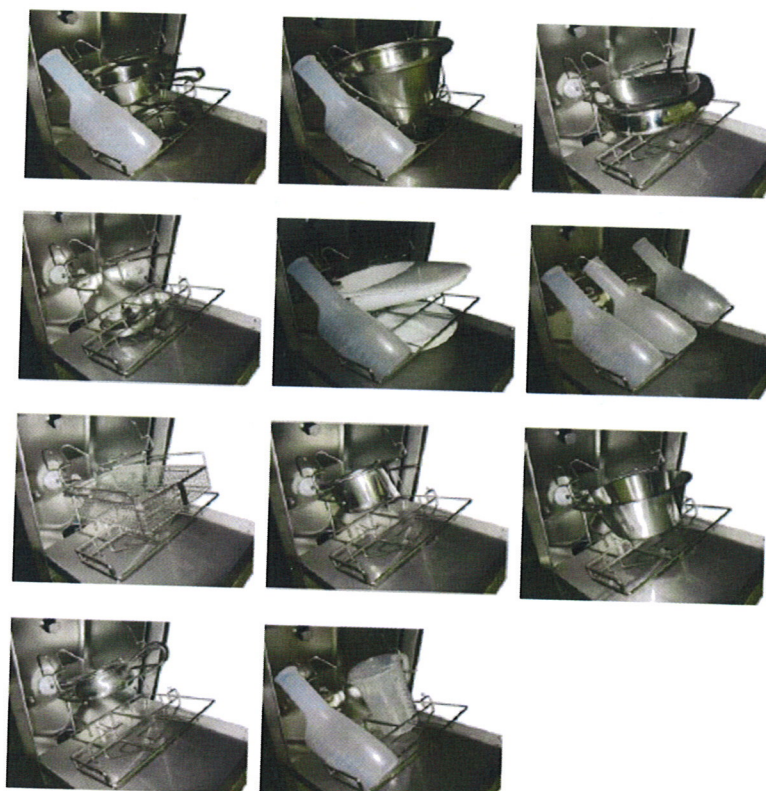

Příloha č. 3

Polohovací lůžka pro JIP interního oddělení

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Lůžko INVENT

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění
Podvozek – stabilní 2 sloupová konstrukce, nosnost 250 kg, typ L, plastový kryt podvozku
Kolečka 150 mm - kov, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál
Zádový díl, stehenní díl a lýtkový díl - polohování elektrické
Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR - polohování elektrické
Autokontura – současné polohování zádového a stehenního dílu
Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm
CPR - zádový díl
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm
Záložní baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti
2x univerzální držák příslušenství - hlavová část
2x univerzální držák příslušenství - nožní část
Čtyřdílná ložná plocha o šíři 85 cm
Ložná plocha z kovových lamel
Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha)
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová
Prodloužení lýtkového dílu
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
Úchyty pro fixační pásy
Eurolišta 2ks
Police na lůžkoviny
Čela plastová, typ R2
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel
Hlavové čelo připevněné k podvozku
Sklopné postranice plastové dělené ZPM3 (sada 4ks) s ochranou proti nechtěnému spuštění
Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany
Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Maximální vnější rozměry lůžka:	222 x 100 cm
Rozměr ložné plochy:	200 x 85 cm
Výška ložné plochy bez matrace:	40 - 78 cm
Maximální úhel Trendelenburg:	16°
Maximální úhel Antitrendelenburg:	16°
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství:	250 kg

Příslušenství k lůžku: polička na psaní, infuzní stojan chromovaný se čtyřmi háčky, hrazda, hrazdička, držák sáčků na moč, držák močové láhve

Příloha č. 3

Lůžko INVENT:



Příslušenství lůžka:

infuzní stojan chrom




hrazda, hrazdička s popruhem



držák nádoby na moč



polička na psaní

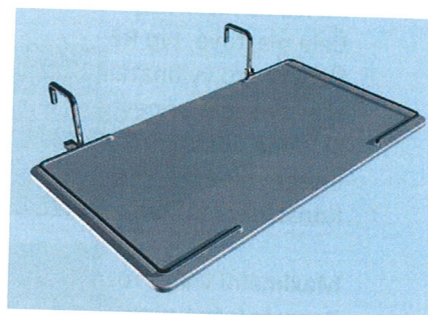

2x- držák sáčků na moč



Příloha č. 3

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro JIP

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Matrace Visco Lux

Jádro ze studené pěny 45 kg/m³

Po celém povrchu jádra viscoelastická pěna 50 kg/m³ v tl. 3 cm

Zpevněné okraje tužší pěnou 40 kg/m³

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (II.-III. stupně / Norton 20-13)


7 anatomických zón

Potah zelený SAFR, snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění

Paropropustný, voděodolný (2000mm vodního sloupce), antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, prateľný na 95°

Spoje potahu svařované

Rozměr matrace 200 x 85 x 14 cm

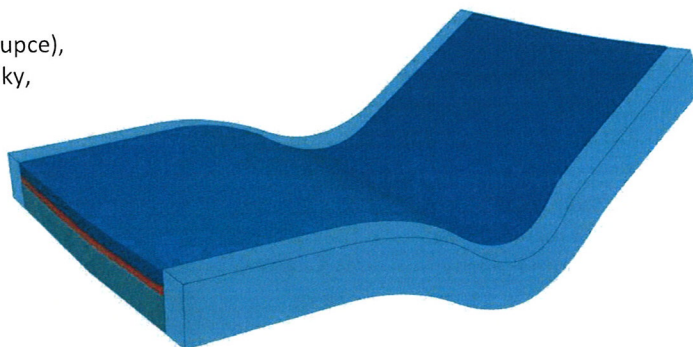

Příloha č. 3

Lůžka pro LDN, nosnost 150 kg

Oblastní nemocnice Náchod a.s., lokalita Jaroměř

Lůžko PLE-P90-0

Kolečka 100 mm - kov, 3x brzda, 1x směrová aretace
Zádový díl, stehenní díl, zdvih ložné plochy - polohování elektrické
Lýtkový díl - polohování hřeben
Autoregrese - zádový díl, stehenní díl
Ruční (pacientský) ovladač
2x univerzální držák příslušenství - hlavová část
Ložná plocha - kovové lamely
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová
Čela lůžka UNI, typ P
Postranice integrované s Al lištou (4 ks)
Desén lůžka imitace dřeva, lamino - Buk rustikal PR 1796
Odstín konstrukce RAL 9016 - bílá

Rozměr ložné plochy: 90 x 200 cm
Vnější rozměr lůžka: 106x 206 cm
Zdvih ložné plochy: 38,5 - 80 cm
Nosnost: 220 kg

Příslušenství k lůžku:
hrazda, hrazdička, držák močové láhve



Příslušenství lůžka:

hrazda, hrazdička s popruhem



držák nádoby na moč



Příloha č. 3

Lůžka pro LDN, nosnost 200 kg

Oblastní nemocnice Náchod a.s., lokalita Jaroměř

Lůžko PLE-P90-0

Kolečka 100 mm - kov, 3x brzda, 1x směrová aretace
Zádový díl, stehenní díl, zdvih ložné plochy - polohování elektrické
Lýtkový díl - polohování hřeben
Autoregrese - zádový díl, stehenní díl
Ruční (patientský) ovladač
2x univerzální držák příslušenství - hlavová část
Ložná plocha - kovové lamely
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová
Čela lůžka UNI, typ P
Postranice integrované s AI lištou (4 ks)
Desén lůžka imitace dřeva, lamino - Buk rustikal PR 1796
Odstín konstrukce RAL 9016 - bílá

Rozměr ložné plochy: 90 x 200 cm
Vnější rozměr lůžka: 106x 206 cm
Zdvih ložné plochy: 38,5 - 80 cm
Nosnost: 220 kg

Příslušenství k lůžku:
hrazda, hrazdička, držák močové láhve



Příslušenství lůžka:

hrazda, hrazdička s popruhem



držák nádoby na moč



Příloha č. 3

Noční stolek pro LDN

Oblastní nemocnice Náchod a.s., lokalita Jaroměř

Noční stolek NS-1-O

Jídelní deska s plynulým výškovým nastavením pomocí plynové pístnice a náklonem s aretací ve 3 pozicích
Oboustranné dřevěné provedení s kovovým mechanismem jídelního stolku

Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu

Horní zásuvka, nika, skříňka

Uvnitř stolku prostor pro nápojové PET lahve

Prostor pro obuv ve spodní části stolku

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65mm

Materiál lamino, hrany z ABS plastu

Držák ručníků, plastová vložka zásuvky

Zásuvka a dvířka opatřeny madly

Bednění stolku v provedení z dekoru 1796 PR - buk rustikal

Barevné provedení konstrukce RAL 9016 - bílá

Š x H x V: 52 x 45 x 84 cm

Rozměr jídelní desky: 66 x 43 cm

Zdvih jídelní desky: 80 – 110 cm



Příloha č. 3

Lůžko pro standardní péči (21ks neurologie, 20ks onkologie, 10ks interna)

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.


Lůžko ELEGANZA 1



Nadstandardní funkčnost překoná Vaše očekávání

Lůžko může být vybaveno řadou volitelných funkcí a praktických vlastností. Díky této variabilitě lůžko uspokojí specifické potřeby všech standardních nemocničních oddělení.

1. HORIZONTÁLNÍ OCHRANNA KOLEČKA
2. POLZDÍKA PRO HRAZDU A INFUZNÍ STOLANY
3. CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÁ KOLEČKA 150 mm
4. OCHRANNÉ POSTRANICE (str. 10-11)
5. BAREVNÉ DEKORY POSTRANIC A ČEL (str. 15)
6. BRAKE A LARM

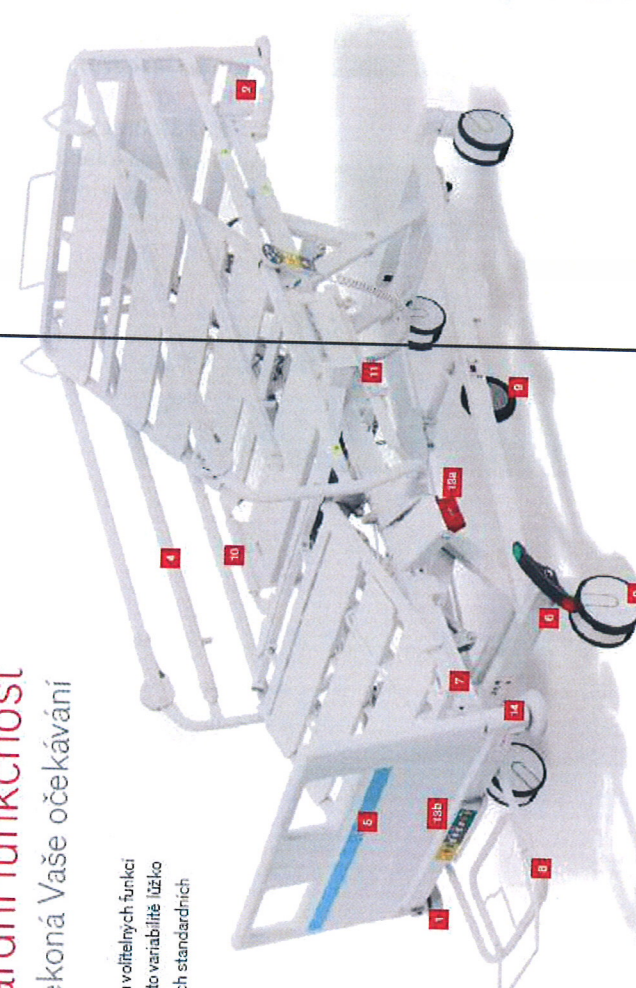

10. ANTIDEKUBITNÍ LŮŽNÍ PLOCHA



Ergoframe 16cm
Antidekubitní elstku je docíleno díky autormatickému rozšíření lůžné plochy o 16 cm. Při polohování zádového a stěnného dílu Ergoframe minimalizuje tlak a třecí síly v pánevní oblasti pacienta. Tím je docíleno snížení rizika vzniku problémů v těcno křicových oblastech.

11. OPTIMÁLNÍ PROSTOR PRO PRSLUŠENSTVÍ

Lakované listy mohou být odšarvany v délce 500 nebo 750 mm. Listy jsou umístěny na dvou stranách lůžka a jsou vždy výškově 2 nebo 4 posuvnými plastovými háčky. Na listu lze zavěsit celou řadu zdravotního příslušenství (koš na baňatka, sáčky na moč, držák recitových atv, držák kanyl...).

12. JEDNODUŠÍ MOBILIZACE

Lůžná plocha může být vybavena pouzdrém pro vsazení madla. Všechny madla respektují rovnou výšku pacientů a ne je nastavit do dvou úrovní výšky. Vždy tak ocitíte vytvoření optimálního optického bodu pro vsazení. Madlo vlnodně doplňuje celý koncept nezavislé mobilizace.



7. KOMFORT I PRO VYŠŠÍ PACIENTY

Demografická tendy jasně ukazují rost populace a předešlým zvyšující se počet obyvatel s nadřahou. Pro vyšší komfort těchto pacientů je lůžko standardně vyráběno a 90 cm širokou lůžnou plochu. Ode může být vycaveno 15 cm prodloužení lžné plochy.



8. PRAKTICKÝ PROSTOR PRO LŮŽKOVINY

Praktická policka na lůžkoviny je umístěna v prostoru pod nožním čelem. Při výměně lůžkovin tak zůstává čistě a použité prádlo vždy oddělené. Policku lze využít i pro uložení hlavy nebo sesterského ovládače.



9. SVAZKÍ TRANSPORT

Aktivovaná 5. kolečko usnadňuje jdu na dlouhých chodbách (lůžko drží přímý směr). Vyrábí se stědu lůžka oběhový bod, díky kterému dochází k usnadnění odtáčení na malém prostoru (vyžad dovyřazení, odtáčení) a vyzázení snižení síly potřebné k odtáčení lůžka.



13. RYCHLÉ ŘEŠENÍ RESUSCITACE

13a. Mechanické CPR
CPR lžho pro mechanické skopertizaceho dílu bylo umístěno v nožní části lůžka. Je tak vždy velmi snadno dosažitelné a to ve všech policích lůžka i posttranc.

14. ZÁMKY ČEL

Čela lůžka mohou být fixována k rámu lžné plochy prostřednictvím jednoduchých zámků. Pokud jsou zámkovy horní polosa a je viditelný zelený symbol odemčovacího zámku lze čela z lůžka odjmut. V dom po loze jsou pak čela fixována k rámu lžka.



Příloha č. 3

PLASTOVÁ LOŽNÁ PLOCHA

Montáž, demontáž i samotné čištění ložné plochy je nyní výrazně snadnější a účinnější díky výjimečnému řešení vytvořenému z 8 samostatných odnímatelných plastových dílů. Ty jsou podobné jako čela či postranice vyrobeny bezspárovou technologií vyfukování. Díky své minimální hmotnosti (každý díl váží pouhých 700 gr) i rozměrům je toto řešení velmi praktické. Piktogram postavy vylisovaný na každém díle slouží pro rychlou identifikaci správné polohy dílu na lůžku.

1. PIKTOGRAM PACIENTA
2. VÁHA POUHÝCH 700 gr
3. BEZSPÁROVÁ KONSTRUKCE
4. PLASTOVÁ LOŽNÁ PLOCHA
TVOŘENÁ 8 SAMOSTATNÝMI DÍLY



MINIMALIZACE INFEKCE



Při výrobě jednotlivých dílů je využíváno nejmodernějších bezspárových technologií, které minimalizují prostor pro nežádoucí infekce. Lůžko je tak z pohledu čistitelnosti velmi bezpečné a uživatelsky jednoduché.

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE



Pro dosažení snadné čistitelnosti bylo lůžko Eleganza 1 od počátku navrhováno tak, aby bylo dosaženo maximálního zjednodušení celé konstrukce i jednotlivých dílů a ploch.

VŠECHNY SPOJE KRYTÉ



Čištění šroubových spojů je velmi problematické, až nemožné. Proto jsou všechny šroubové spoje na lůžku Eleganza 1 opatřeny krytkou.

Příloha č. 3

Pro zvyšování bezpečnosti zdravotnických lůžek je stanovena řada předpisů a norem. Jednou z hlavních priorit produktů společnosti LINET je řešení všech technických uzlů se zaměřením na absolutní bezpečnost. Lůžko Eleganza 1 splňuje veškeré požadavky nejnovějšího standardu IEC 60601-2-52:2010, který (dle harmonizace legislativy jednotlivých států) vstupuje závazně v platnost od 1. 12. 2012 do 1. 4. 2013.




BEZPEČNÉ MEZERY – Všechny mezery na lůžku Eleganza 1 jsou navrženy s ohledem na bezpečnost:

PRSTY: Mezery mezi pohyblivými díly jsou větší než 2,5 cm. Prostor pro ruce je dostatečný a v žádné pozici lůžka nehrozí při pohybu skřípnutí prstů.


KRKE: Nadstandardně pevné řešení postranic zaručuje velikost mezer mezi postranicemi menší než 8 cm. Je tak naprosto eliminováno skřípnutí, či zapadnutí měkkých tkání pacienta (především pak oblasti krku).

HLAVA: Všechna místa mezi pohyblivými částmi prošla a vyhověla důkladnému testování, které simulovalo snahu zmateného pacienta prostrčit hlavu těmito mezerami.

1	Mezery v postranicích	✓
2	Prostor mezi postranicí a ložnou plochou	✓
3	Prostor mezi postranicí, ložnou plochou a čelem lůžka	✓
4	Mezera mezi postranicemi	✓
5	Mezera mezi postranicemi a nožním čelem	✓
6	Mezera mezi postranicí a hlavovým čelem	✓

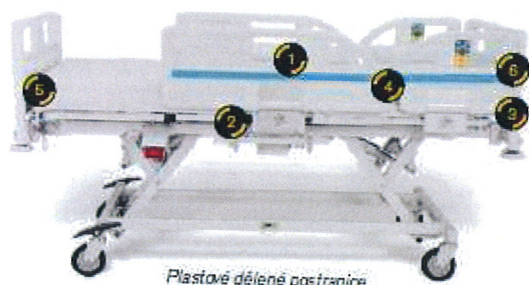

Plastové dělené postranice

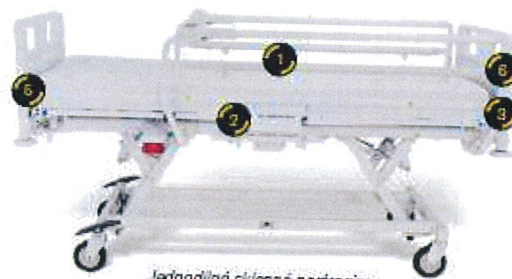

Jednodílné sklápěcí postranice



Bezpečnost lůžka byla potvrzena nejprestižnější a nejpřísnější nezávislou zkušebnou – německou společností TÜV. Ta provedla jednorázové i dlouhodobé zátěžové testy, které potvrdily absolutní bezpečnost a kvalitu modelu Eleganza 1 a vydala certifikát kompatibility lůžka s normou IEC 60601-2-52:2010.



ELEKTRICKÁ OCHRANA

DELŠÍ ŽIVOTNOST BATERIE

Nabíjení baterie je řízeno optimálním způsobem, čím dochází k prodloužení její životnosti až o 2 roky. Baterie je neustále dostupná – baterie nemusí být aktivována.

OCHRANA MOTORŮ – SNIŽUJE SERVISNÍ NÁKLADY

Jedna z nejčastějších poruch motorů nemocničních lůžek je způsobována zaseknutím lůžka pod překážkou (parapet, ...) či jeho přetížením. Následné opravy jsou časově i finančně nákladné. Lůžko Eleganza 1 má samostatnou proudovou ochranu pro každý motor. Ta v případě přetížení motoru zamezí možnému poškození. Ochrana je elektronická a po odstranění přetížení je lůžko bez jakéhokoliv zásahu připraveno k použití.

INTELEKTUÁLNÍ SERVIS – MINIMALIZACE PORUCH

Koncept prevence poškození je založen na chytré řídicí jednotce lůžka, která na základě namáhání, zatěžování či opotřebení lůžka predikuje potenciální poruchu a servisnímu pracovníkovi doporučuje dle kontroly či servisního zákroku ještě před tím, než dojde k poruše. Lůžko je tak stále v provozu a je méně poruchové.

GARANCE VODOROVNÉ LOŽNÉ PLOCHY

Při nerovnoměrném zatížení lůžka dochází k javu, kdy ložná plocha není v rovině a pacient je v nepříjemném náklonu. Díky funkci Synchronizace motorů, je na lůžku Eleganza 1 vždy zaručena vodorovnost ložné plochy (s výjimkou žádaného náklonu u předprogramovaných funkcí)

ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PANEL

Základní ovládací a blokační panel je umístěn pod nožním čelem a je pevně spojený s rámem lůžka. Na tomto ovladači jsou umístěny základní předprogramované funkce (CPR, Protiskoková poloha, naklon lůžka) a možnost deaktivace (uzamčení) jednotlivých funkcí na ručním ovladači.

SESTERSKÝ OVLÁDACÍ PANEL

Lůžko může být vybaveno hlavním ovládacím panelem. Díky dostatečně dlouhému kroucenému kabelu má vysokou flexibilitu při ovládání. Sestra má na hlavním ovladači možnost kompletního ovládání včetně funkce Kardiackého křesla. Hlavní panel je volitelnou výbavou a nahrazuje základní ovládací panel.

PACIENTSKÝ SATELIT

Ovladač umístěný na pružném rameni je vždy dostupný a dobře dosažitelný. Ovladač je určen zejména starším pacientům, proto jsou symboly k ovládání jednotlivých funkcí velké a dobře čitelné. Tlačítka jsou odlišena různými barvami a pro pacienty se zrakovým postižením jsou provedena také jako reliéf.

RUČNÍ OVLADAČ

Ergonomický ruční ovladač pro pacienta a sestru umožňuje ovládání základních poloh lůžka (naklonu zádového a stehenního dílu, nastavení výšky ložné plochy a kombinovanou funkci Autokontura – společné polohování zádového a stehenního dílu). Ovladač je vybaven vyšetřovacím světlem. Noční obsluhu lůžka usnadní ovladač v provedení s podsvětlenou klávesnicí.

OVLADAČ V POSTRANICI

Klinickými průzkumy bylo zjištěno, že ovladače umístěné v hlavových postranicích jsou výrazně lépe dostupné a umožňují pacientovi snazší obsluhu při nastavení základních poloh lůžka.

PLUG & PLAY

V případě některých diagnóz a stavů pacientů (např. při zmatení pacienta) je vhodné ruční ovladač zcela odejmout. Se zásuvkou Plug and Play umístěnou na lůžce příslušenství lze ovladač z lůžka odejmout během několika vteřin.

Příloha č. 3

Postranice s novou odklopnou mechanikou vyniká vysokou bezpečností, snadnou obsluhou a velmi příznivou cenou. Sklápění postranic je řešeno otáčením okolo spodní osy postranice. Díky nízké hmotnosti, dokonalému vyvážení a dobře přístupnému odjišťovací madlu je k odjištění postranice potřeba minimální síla. Bezpečnost je garantována dvěma nezávislými pohyby nutnými pro odjištění.

1. PLASTOVÉ DĚLENÉ POSTRANICE

Ideální rozložení délky dělených plastových postranic mezi hlavovou a střední postranicí poskytuje pacientům dokonalou ochranu a vysoký standard bezpečnosti. Hlavové postranice mohou být vybaveny integrovanými ovladači. Tyto ovladače jsou pacientům vždy dokonale dostupné a zvyšují tak komfort ovládání lůžka.

2. BEZPEČNĚJŠÍ POSTRANICE

Všechny postranice jsou vybaveny dvoustupňovým bezpečnostním mechanismem.



*Plastové postranice
ve zdvižené poloze*



*Sklápěné plastové
postranice*

Příloha č. 3

Ergonomicky umístěné ovládání jednodílných sklopných postranic, bylo poprvé umístěno v horní části postranice. Obsluha postranice je tak velmi ergonomická. Ke sklopení postranice poprvé stačí pouze jedna ruka. Postranice umožňuje samostatným pacientům, kteří nejsou zmatení ani ovlivnění medikací možnost získání větší nezávislosti.



1. ODĚRUVZDORNÁ LIŠTA


umístěná po celé délce prostřední tyče chrání postranici i celé lůžko před poškozením při transportu lůžka.

2. LIŠTA PŘÍSLUŠENSTVÍ

je s novou postranicí vždy výborně dostupná. Postranice ve sklopené poloze má výšku pouhých 23 cm a je sklopená podél matrace. Drobné příslušenství (báčkory, bažant, sáčky na moč, ...) je tak vždy dobře a jednoduše dostupné.

3. JEŠTĚ VYŠŠÍ OCHRANA | 10 cm nástavec

V některých případech je vhodné poskytnout pacientovi zvýšenou ochranu. Jednoduše demontovatelný nástavec zvýší postranici o 10 cm a na lůžko tak lze umístit i vyšší typy aktivních matrací (až do výšky 26,5 cm).

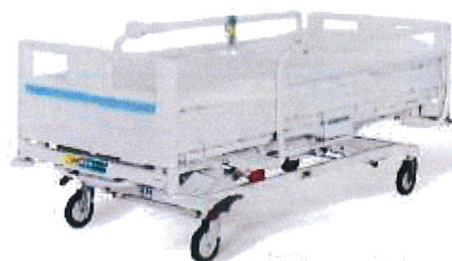

Postranice nahore




Postranice dole

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Matrace EFECTA

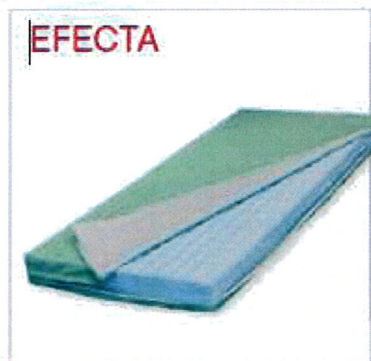


- Standardní matrace určená pro použití ve zdravotnictví a pečovatelské péči. Navržena pro pacienty s velmi nízkým rizikem vzniku dekubitů.
- Matrace Efecta je vyrobena ze studené polyuretanové pěny s prátelným, voděodolným potahem.
- Jádro matrace je ve střední části příčně přežaté pro dobré rozložení tlaku. Matrace se tak lépe přizpůsobuje tělu pacienta.
- Potah matrace je ušitý z pružné paropropustné textilie.
- Riziko I, výška matrace 14 cm, hmotnost 7,5 kg, maximální nosnost 100 kg.

Speciální profilace nařezání jádra zvyšuje užité vlastnosti matrace a komfort pacienta.

OPTIMÁLNÍ DISTRIBUCI TLAKU URČUJE X-Sensor

Pasivní matrace LINET jsou vyvíjeny na základě měření rozložení tlaků pomocí přístroje X-Sensor. Zařízení snímá míru rozložení tlaku, a to navíc v čase, takže je možné měřit matraci, na které pacient mění polohu během ležení, a lépe vyhodnotit její parametry. Výsledkem jsou tlakové mapy s rozlišením až 7 000 bodů, znázorňující schopnost matrace rozložit tlak, pro statistické vyhodnocení pak jsou k dispozici histogramy a trendové křivky.

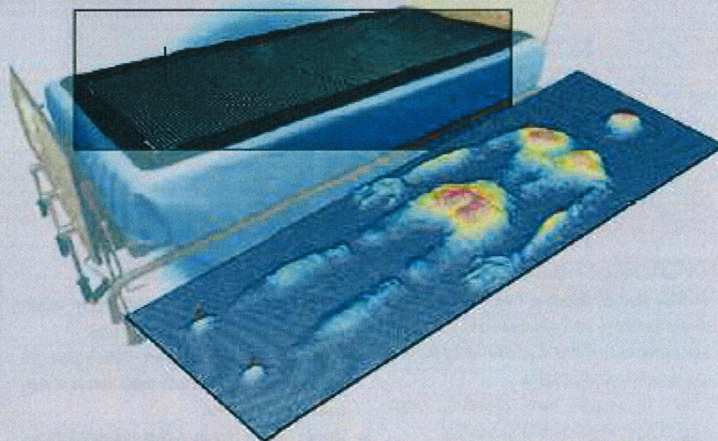

Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Stolek Eleganza Classic



- VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ A NÁKLON JÍDELNÍ DESKY
- SNADNÁ MANIPULACE
- DVOJITÁ KOLEČKA
- SNADNÁ ÚDRŽBA

Oboustranný patientský stolek Eleganza Classic v provedení s nebo bez výklopné jídelní desky umožňuje umístění na levé nebo pravé straně lůžka při zachování všech funkcí.



UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

- Skříňky jsou přístupné z čela i zadní strany stolku a zásuvky jsou výsuvné oběma směry.
- Mechanismus výklopné jídelní desky je integrován do korpusu stolku.
- Stolek je vybaven horní zásuvkou, nízkou a spodní skříňkou s poličkou a dvířky.
- Modely bez jídelní desky mají v korpusu umístěn integrovaný držák na plastové láhve a přihrádku na časopisy.
- Stolky jsou vybaveny čtyřmi dvojitými kolečky (2 jsou vybavena brzdou).

KOMFORTNÍ PROVEDENÍ

- Mechanismus výklopné jídelní desky umožňuje snadnou manipulaci a nastavení.
- Práškové lakování kovových částí stolku zaručuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému oděru.
- Vrchní i jídelní deska a čela zásuvek jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu, odolného proti mechanickému poškození.
- Vrchní deska stolku je opatřena galerií, sloužící také jako madlo pro manipulaci se stolkem.
- Vrchní i jídelní deska jsou opatřeny zvýšenými hranami.



Integrovaný plastový držák pro tři láhve u modelu bez jídelní desky.



Plastové voděodolné vložky do zásuvek je snadno vyjmoutelné a čistitelné.



Vrchní deska stolku s galerií a zvýšenými hranami. Držák ručníku na boku stolku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry (bez jídelní desky)	80 x 51,5 cm
Rozměry jídelní desky (mezi hranami)	60 x 34,5 cm
Výška stolku (horní desky)	86,5 cm
Výška jídelní desky (kolečka prům. 7,5 cm)	72 – 108 cm
Max. zatížení jídelní desky (ve středu desky)	9 kg
Kolečka	7,5 cm
Hmotnost	35 kg

Příloha č. 3



Seznam subdodavatelů

vyhotovený dle požadavků zadavatele v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem:

Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – lůžka pro specializovaná lůžková pracoviště

Identifikační údaje subdodavatele	
obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení	LINET spol. s r.o.
sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu	Želevčice čp. 5, 274 01 Slaný
IČO	00507814
osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele	Ing. Filip Těšitel
telefon	724 050 701
e-mail:	filip.tesitel@linet.cz
Části veřejné zakázky, kterou má uchazeč v úmyslu zadat subdodavateli	
Resuscitační lůžko polohovací pro ARO, nemocnice Rychnov nad Kněžnou Lůžko pro standardní péči, Oblastní nemocnice Trutnov Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitů, Oblastní nemocnice Trutnov Patientský stolek k lůžku, Oblastní nemocnice Trutnov	

Příloha č. 4

Identifikační údaje subdodavatele	
obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení	PROMA REHA, s.r.o.
sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu	Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
IČO	63219107
osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele	Pavel Matouš
telefon	775 776 066
e-mail:	Obchod2@promareha.cz
Části veřejné zakázky, kterou má uchazeč v úmyslu zadat subdodavateli	
Polohovací lůžko pro chirurgickou JIP, Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu, Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem Polohovací lůžka pro JIP interního oddělení, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Matrace antidekubitní pasivní pro JIP, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Lůžka pro LDN, nemocnice Jaroměř, Noční stolek pro LDN, nemocnice Jaroměř	

Poznámka: Tabulku uchazeč použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

Výkaz výměr
Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – lůžka pro specializovanou lůžkovou pracoviště

Poř. číslo	Název zdravotnického přístroje	Specifikace	Počet	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem
1	Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP, nemocnice DK	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	4	48750	195000	29250	224250
2	Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu, nemocnice DK	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	4	3870	15480	2322	17802
3	Resuscitační lůžko polohovací pro ARO, nemocnice RK	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	5	148210	741050	111157,5	852207,5
4	Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro ARO, nemocnice RK	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	5	5870	29350	4402,5	33752,5
5	Vyplachovače podložních mís pro JIP a ARO, nemocnice RK	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	2	148830	297660	62508,6	360168,6
6	Polohovací lůžka pro JIP interního oddělení, nemocnice RK	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	7	48640	340480	51072	391552
7	Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro JIP, nemocnice RK	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	7	3860	27020	4053	31073
8	Lůžka pro LDN, nosnost 150 kg, nemocnice Jaroměř	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	18	19820	356760	53514	410274
9	Lůžka pro LDN, nosnost 200 kg, nemocnice Jaroměř	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	2	19820	39640	5946	45586
10	Noční stolek pro LDN, nemocnice Jaroměř	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	20	6050	121000	25410	146410
11	Lůžko pro standardní péči (21ks neurologie, 20ks onkologie, 10ks interna), nemocnice Trutnov	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	51	29100	1484100	222615	1706715
12	Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu, nemocnice Trutnov	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	51	2160	110160	16524	126684
13	Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou, nemocnice Trutnov	viz. příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky	51	6730	343230	72078,3	415308,3
Celkem			227	x	4 100 930,00	660 852,90	4 761 782,90

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 3 - Technická specifikace dodávky, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.